



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.626.812/0001-21 DUNS®: 925801258
Razão Social: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/03/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/08/2026
Receita Municipal	Validade:	09/07/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.626.812/0001-21 DUNS®: 925801258
Razão Social: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257054 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS
Data Aplicação: 06/05/2021
Número do Processo: 25066000292201965 Número do Contrato: Ata nº 12/2020
Descrição/Justificativa: Em face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da ocorrência.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
Data Aplicação: 31/12/2021
Número do Processo: 64668003122202120 Número do Contrato: 2021NE000005
Descrição/Justificativa: Por deixar de entregar material contratado, apresentando justificativa que foram consideradas e após análise conclui-se pela aplicação de advertência.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Advertência
Órgão Sancionador: Prefeitura Municipal de Criciúma (SC)
Abrangência: No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 605752 / 026/FMS/2020
Data Inicial: 02/07/2021
Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87, I



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 35.626.812/0001-21

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:28:09 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: raBgwnjFvyNb7MCIVn0W

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GISLAINE MEDIANEIRA RIZZI DALLA PORTA**

CPF/CNPJ: **559.554.600-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:28:38 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: GgzmjI8sZREhdJBprP5l

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

PROPONENTE

Razão Social: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Logradouro: AVENIDA CENTRAL

Nº 784

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-670

Tel: (47) 3056-5712

CNPJ: 35.626.812/0001-21

Inscrição Estadual: 26.033.241-0

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	PCT	100	ABAIXADOR DE LÍNGUA: 14cm x 1,50cm Em madeira; descartável; não estéril; formato convencional liso com pontas arredondadas; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão. PACOTE C/ 100	MEDIX	4,20	R\$ 420,00
12	RL	100	ALGODÃO HIDRÓFILO Algodão para uso hospitalar, hidrófilo, inodoro e insípido de alta absorção. Confeccionado em fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Rolo 500g.	MELHORMED	12,60	R\$ 1.260,00

Av. Central, 784 entrada pela rua 801 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88.330-670 - Fone (47) 3056.5712

CNPJ 35.626.812/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260/332410

E-mail: atlantico.bc@hotmail.com

14	RL	30	ATADURA DE RAYON Material 100% poliéster, estéril, dimensões 7,5cm x 5m, embalagem individual	POLARFIX	4,50	R\$ 135,00
23	UND	250	CAIXA COLETORA 20L Caixa coletora de materiais perfurocortantes para descarte seguro de materiais que podem cortar ou perfurar, como agulhas, lâminas, seringas e outros objetos contaminados. Contendo uma sacola plástica para impermeabilização interna, possui alças que facilitam o manuseio e ajudam na segurança no processo de descarte; Com bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança, garantindo a integridade até o destino final; Confeccionada a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja) e papelão couro (cinta lateral e fundo rígido). Descartável e de uso único	DESCARBOX	5,56	R\$ 1.390,00
28	UND	150	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS Uso adulto, extensão em PVC e cânula em silicone; Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Especificações: Adulto: - Medida interna do prong.: 2,77mm, - Medida interna da conexão: 5,79mm, - Medida externa do prong.: 4,52mm, - Medida externa da conexão: 11,42mm.	BIOSANI	0,99	R\$ 148,50
30	UND	200	CATETER PERIFÉRICO SCALP 19 Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e stéril,	MEDIX	0,18	R\$ 36,00

			assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS.			
31	UND	6000	CATETER PERIFÉRICO SCALP 23 Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e stéril, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS.	MEDIX	0,18	R\$ 1.080,00
36	ENV	50000	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5cm x 7,5cm Gaze 13 fios/cm², 8 camadas, 7,5cm x 7,5cm, confeccionada a partir de fio 100% algodão hidrófilo, alvejado, isento de impureza, alvejante óptico e resíduo de amido, tecido neutro, macio, altamente absorvente e inodoro, ESTÉRIL. Envelope com 10 unidades.	ERIMAR	0,38	R\$ 19.000,00
40	UND	20000	CURATIVO CIRÚRGICO (CHUMAÇO) Curativo cirúrgico algodonado, constituído de manta de algodão hidrófilo, envolto de tecido de gaze hidrófila. Utilizado em procedimentos cirúrgicos e curativos que necessitam de absorção de sangue e secreções. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Dimensões: 15 x 30 cm aberto	AMED	0,93	R\$ 18.600,00

41	CX	70	CURATIVO PÓS PUNÇÃO Estéril, para procedimento pós punção, redondo 25mm de diâmetro. Caixa c/ 500unidades.	CIEX	10,20	R\$ 714,00
46	PCT	60	ELETRODO AUTO ADESIVO ADULTO DESCARTÁVEL ESPUMA Utilizado na realização de eletrocardiogramas, para a verificação das ondas elétricas do coração. Pode ser utilizado em repouso ou em movimento como meio condutivo em curta ou longa duração. Descartável; não estéril; Aderência de curta e longa duração (até 72 horas); Pino e contra-pino; Gel médico sólido condutor na quantidade ideal para stérile; Fita plástica rígida que protege o gel e o adesivo; Hipoalergênico. Pacote com 50 unidades.	MEDIX	10,20	R\$ 612,00
47	UND	15000	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS Equipo para infusão de soro; somente para infusão por gravidade; esterilizado por óxido de etileno; atóxico e apirogênico; Ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico; Dispositivo para entrada de ar; Câmara gotejadora flexível; Filtro de partículas de 15µ; Regulador de fluxo; Conector luer slip; Tubo flexível de 150cm; injetor lateral – Y auto cicatrizante; Descartável.	M2LIFE	0,55	R\$ 8.250,00
48	UND	7000	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP Equipo com 2 vias de infusão com clamp corta- fluxo; Tubo transparente de 18 cm em PVC; Conector slip com o paciente; 2 conectores fêmeas com tampas protetoras.	M2LIFE	0,39	R\$ 2.730,00
54	RL	50	ESPARADRAPO 50mmX4,5m Impermeável composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento. Aplicada massa adesiva à base	CRAL	4,14	R\$ 207,00

			de borracha natural, óxido de zinco e resina. Com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade.			
55	RL	20	ESPARADRAPO 100mmX4,5m Impermeável composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento. Aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade.	WILTEX	6,78	R\$ 135,60
57	UND	5000	ESPÉCULO M Espéculo vaginal, descartável, lubrificado, embalado individualmente, com borboleta lateral para abertura.	CRAL	1,33	R\$ 6.650,00
62	CX	10	FIO SUTURA Nylon monofilamento, preto 5-0 c/ agulha 3/8, circular, triangular 3,0cm. Caixa com 24 unidades	MEDIX	28,44	R\$ 284,40
63	RL	100	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 10cmx 10m	WILTEX	6,02	R\$ 602,00
64	RL	1200	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 2,5cm x 10m	WILTEX	1,98	R\$ 2.376,00
65	RL	1000	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA Fita microporosa para uso hospitalar composta por tecido-não-tecido à base de poliéster e celulose, com uma das faces tratadas e a outra recoberta com adesivo acrílico hipoalérgico. Rolo 5cm x 10m	CRAL	3,26	R\$ 3.260,00

66	RL	1000	FITA CREPE HOSPITALAR Fita em papel crepado saturado e envernizado, recoberto com adesivo a base de borracha natural. Rolo 16mm X 50m	MAXICOR	2,50	R\$ 2.500,00
70	FR	250	GEL PARA USO CLÍNICO Gel condutor para ultrassom e ECG, inodoro e hipoalérgico, livre de álcool e de sais, consistência firme e de fácil remoção. Embalagem com bico. Frasco 250 g	MULTIGEL	3,17	R\$ 792,50
73	CX	20	HASTES FLEXÍVEIS Haste em polietileno flexível com extremidades revestidas de algodão 100% puro. Cx c/ 75 unidades.	PROHIGI	1,52	R\$ 30,40
74	CX	15	LÂMINA DE BISTURI N 11 Lâmina em aço inox ou aço carbono; estéril, embalada individualmente em embalagem laminada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	22,68	R\$ 340,20
75	CX	10	LÂMINA DE BISTURI N 12 Lâmina em aço inox ou aço carbono; estéril, embalada individualmente em embalagem laminada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	22,68	R\$ 226,80
77	CX	800	LANCETAS Atende a NR 32; penetração consistente; estéril; Automática: Acionamento por Contato; espessura ultrafina para punção indolor; que não permite reutilização; descarte seguro; espessura 28G	WILTEX	9,60	R\$ 7.680,00
78	RL	600	LENÇOL HOSPITALAR Lençol descartável em papel, branco não reciclado, rolo de 70cm x 50m; descartável; 100% celulose com fibras naturais; não estéril, uso único.	DESCARBOX	7,69	R\$ 4.614,00
79	PCT	20	LUVA TOQUE PLÁSTICA ESTÉRIL Luva plástica estéril descartável para procedimento não cirúrgico, tamanho e uso único, ambidestra, sem	MEDIX	8,52	R\$ 170,40

			pó. Pacote c/ 100 unidades			
86	CX	200	LUVA PROCEDIMENTO G Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	17,00	R\$ 3.400,00
87	CX	500	LUVA PROCEDIMENTO M Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	17,00	R\$ 8.500,00
88	CX	400	LUVA PROCEDIMENTO P Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	17,00	R\$ 6.800,00
89	CX	200	LUVA PROCEDIMENTO PP Luva de látex de borracha 100% natural com pó, lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P bioabsorvível para facilitar os processos de colocação e retirada. Caixa com 100 unidades	MEDIX	17,00	R\$ 3.400,00
90	CX	70	LUVA VINÍLICA G Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades	MEDIX	11,40	R\$ 798,00

91	CX	150	LUVA VINÍLICA M Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades	MEDIX	11,40	R\$ 1.710,00
92	CX	50	LUVA VINÍLICA P Composta em PVC incolor; Isenta de pó; Lisas; Ambidestra aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Caixa com 100 unidades	MEDIX	11,40	R\$ 570,00
106	PCT	200	PAPEL GRAU CIRURGICO 240mmx380mm Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes	HOSPLEX	100,00	R\$ 20.000,00
107	PCT	50	PAPEL GRAU CIRURGICO 300mmx365mm Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes	VITALPACK	106,14	R\$ 5.307,00
108	PCT	150	PAPEL GRAU CIRURGICO 90mmx260mm Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos estéreis. Pacote c/ 200 envelopes	VITALPACK	23,98	R\$ 3.597,00
110	RL	50	PAPEL GRAU CIRURGICO 15x30cm Envelope autosselante, utilizado para esterilização em autoclave. Tem como objetivo prover barreira contra penetração de microrganismos durante o armazenamento, manuseio e transportes dos produtos	HOSPFLEX	50,00	R\$ 2500,00

			estéreis. Pacote c/ 200 envelopes			
114	CX	3	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO Produto de alta performance para uso médico em exames ultra-sonografia; alta transparência. Permite maior nitidez na captação das imagens. Composição látex de borracha natural. Ponta com reservatório; Lados paralelos; Liso; Opaco; Produto com validade; Não possui lubrificante. Cx c/ 144 unidades	PRELUDE	58,76	R\$ 176,28
115	CX	20	PROTETOR OCULAR ADULTO Protetor ocular estéril descartável adulto indicado para proporcionar barreira mecânica na região ocular, bem como bloqueio de luminosidade em casos em que se faça necessário, como no tratamento do estrabismo. Com formato anatômico. Material adesivo de fácil aderência e remoção, poroso que permite a transpiração da pele. Hipoalergênico; Tamanho aproximado: 58mm x 82mm. Caixa com 20 unidades. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	CRAL	15,00	R\$ 300,00
116	UND	5000	RECIPIENTE PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Frasco graduado fracionador para soluções enterais; Livre de bisfenol; Radiação ionizante; Atóxico; Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo; Permite tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais; Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento; Etiqueta autoadesiva para identificação do paciente. Volume 300ml	BIOMEDICA	0,83	R\$ 4.150,00
125	FR	2000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 1000ml	BASAL	6,50	R\$ 13.000,00

126	FR	1000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 100ml	BASAL	2,30	R\$ 2.300,00
127	FR	5000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 250ml	FRESENIUS	3,00	R\$ 15.000,00
128	FR	5000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% Solução de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso. 500ml	BASAL	3,35	R\$ 16.750,00

VALOR TOTAL: R\$ 192.491,08 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

DADOS DA PROPOSTA	
A validade da presente proposta é cfe edital	
O prazo de entrega dos produtos é cfe edital	
O prazo para pagamentos dos produtos: cfe edital.	
E-mail para remessa de pedido > atlantico.bc@hotmail.com	
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL	
Local: Balneário Camboriú (SC)	Data: 15/06/2026

DECLARAMOS:

Conhecer os termos do instrumento convocatório, bem assim, estar ciente de que deverá estar regular com todas as exigências de habilitação que rege a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o término do futuro contrato.

No preço de nossa proposta estão incluso todos os custos e tributos como transportes, prêmios de seguros, assistências, IPI, ICMS, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e leis sociais, administração, lucros.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

Agência: 7641-4 **Conta Corrente: 243-7**

Nome: Gislaine Medianeira Rizzi Dalla Porta

Cargo: Proprietário


Identidade: 9029160811

CPF: 559.554.600-04

CARIMBO DO CNPJ

35.626.812/0001-21
ATLANTICO BC
PRODUTOS PARA SAUDE-EIRELI
Av. Central, 784 - Centro
CEP 88330-670
BALNEÁRIO CAMBORIU - SC



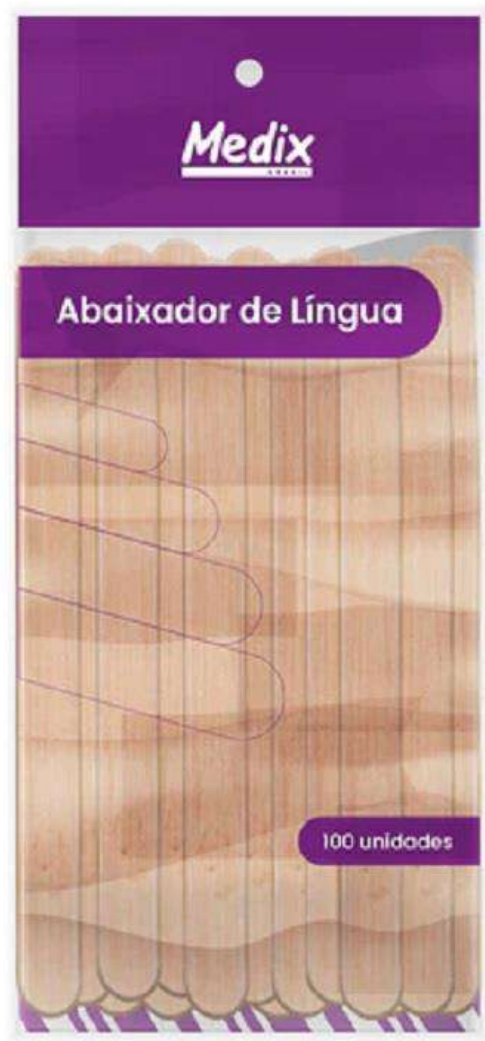

ABAIXADOR DE LÍNGUA - MEDIX

Descrição

Apresentação:

É indicado para facilitar o exame de boca, garganta e órgãos circunvizinhos, permitindo melhor visualização dessas regiões.

Benefícios:

- Confeccionado em madeira;
- Sem odor;
- Descartável;

Modo de Uso:

1. Sempre utilizar luvas para a manipulação do produto;
2. Antes da utilização, verifique a integridade da embalagem e do produto;
3. Realize o procedimento conforme orientações adequadas;
4. Após o uso, descartar em local apropriado;

Precauções:

Este produto não pode ser aquecido, descartar o produto caso o mesmo apresente alguma fissura. O manuseio deve ser realizado de forma suave, evitando lesões ao paciente;

Especificações técnicas:

- Confeccionado em madeira;
- Formato convencional: superfície e bordas sem rebarbas;
- Sem odor;

- Descartável;
- Não estéril;
- Validade 5 anos;
- Embalagem: Caixa c/ 100 unidades

Algodão Hidrófilo 500g Rolo - MELHORMED

ITEM 12



Algodão Hidrófilo Rolo 500g MelhorMed

Produzido a partir de rigorosa seleção de fibras naturais, o **Algodão Melhormed 500g** é feito de puro algodão hidrófilo. Um produto de qualidade, maciez e alto poder de absorção.

O **algodão em rolo** é ideal e prático para realização de diversos procedimentos médicos, pois é fácil de armazenar, separar e utilizar apenas o necessário, no formato escolhido, moldado pelo profissional. Este produto também pode ser usado como algodão hospitalar não esteril.

Especificações Técnicas do Algodão Hidrófilo MelhorMed

- Marca: MELHORMED;
- **Algodão Hidrófilo;**
- Algodão de alta qualidade;

- Altamente absorvente, macio e isento de impurezas;
- 100% Algodão;
- Não Estéril;
- Formato: Rolo de Algodão;
- Cor: Branco;
- Peso: 500g;
- Produto com validade;
- Produto de uso único;
- Registro na ANVISA: [80384550001](#);

ATADURA DE RAYON POLAR FIX

ITEM 14

Modelo Comercial: Comprimento: 1; 3; 5; 8; 10; 20; 25m Largura: 5; 7,5; 10; 15; 20; 25cm

Indicação de uso: Usado em curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorção e baixa aderência.

Instrução de uso: Abrir a embalagem somente no momento do uso; aplicar a atadura no local necessitado; O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Descarta-se em recipientes apropriados com identificação de lixo hospitalar.

Composição: 100% Rayon

Advertências / Precauções: Armazenar o produto em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta. Produto não estéril. O fabricante recomenda uso único

Validade: 05 anos.

Produto não estéril

Número Anvisa: 8003400025

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br



Linha Ecologic (Tamanhos: 3;7;13 e 20 litros);

O coletor Descarbox tem como finalidade de uso o desprezo por materiais Perfuro cortantes provenientes de hospitais, laboratórios, consultórios médicos, farmácia, consultórios odontológicos e veterinários, ou seja, resíduos perfurante, cortante, e infectante. Confeccionado a partir de : papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papel rígido (cinta interna e fundo rígido) e saco plástico impermeável.

CATETER TIPO OCULOS - BIOSANI



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Modelo Adulto: produto fabricado com duas peças de tubo extrusado á partir do composto de policloreto de vinila – PVC atóxico, uma das peças possui uma ponta fechada e na outra a montagem de um conector, as duas partes são unidas por um introdutor nasal do mesmo material conforme desenho anexo para o modelo adulto e com dois furos paralelos .

Modelo Infantil : produto fabricado com tubo extrusado á partir do composto de policloreto de vinila – PVC atóxico, com uma ponta fechada, com dois furos proximais, e na outra a montagem de um conector. Para esse tipo de modelo não se insere o introdutor nasal.

Comprimento total: 1.500 mm

Parte 1: 1.000 mm

Parte 2: 500mm

2. FINALIDADE:

O Cateter de Oxigênio é um artigo médico hospitalar estéril, apirogênico, atóxico e de uso único, indicado para administração de Oxigênio com finalidade terapêutica.

3. PRECAUÇÕES ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS:

O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria à ser utilizada.

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

A conexão entre os componentes do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto.

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.

Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.

Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso.

REGISTRO NA ANVISA

8.02860.0.0007

Informativo – Ficha Técnica

No que tange a RDC nº 431/2020, que dispõe sobre o carregamento de instruções de uso no portal eletrônico da Anvisa, vinculado aos processos de notificação ou de registro de dispositivos médicos, a empresa Medix Brasil legalmente constituída no País e devidamente regularizada no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) informa que para acesso à Fichas técnicas, Catálogos, Imagens de comercialização e demais informações a cerca de nossos produtos disponíveis e em linha, o usuário poderá acessar o link:

<https://linktr.ee/medixbrasilfv>

Caso ainda possuam alguma dúvida ou necessidade de maiores informações, gentileza enviar email para sac@medixbrasil.com.br

Detentor da Notificação

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Resp. Técnica: Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01





ITEM 36

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril – Erimax

A Compressa de Gaze Hidrófila Estéril ERIMAX é indicada para procedimentos que exigem máxima segurança e controle microbiológico. Fabricada dentro das normas da ABNT, com tramas bem definidas e excelente absorção, é ideal para uso em centros cirúrgicos, clínicas, consultórios e ambientes hospitalares em geral.

- **Marca:** ERIMAX
- **Fios disponíveis:** 13 fios
- **Medidas (fechada):** 7,5 x 7,5 cm
- **Medidas (aberta):** 15 x 30 cm
- **Quantidade:** Embalagem com 10 unidades
- **Produto estéril**
- **Esterilizado por óxido de etileno**
- **Uso indicado:** procedimentos invasivos, curativos estéreis, centros cirúrgicos e ambientes que exigem barreira microbiológica
- **Fabricado conforme normas da ABNT**

Produto de alta qualidade, pronto para uso imediato em ambientes que exigem segurança, confiabilidade e excelência técnica.

 [Comprar agora](#)





ITEM 40

[Página inicial](#)[Sobre a AMED](#)[Produtos](#)[Vendas](#)[Trabalhe conosco](#)[Contato](#)[Início / LUIZA - Compressa para curativo cirúrgico](#)

LUIZA - Compressa para curativo cirúrgico

Linha Premium

Confeccionada por uma manta de algodão hidrófila envolta por um tecido de gaze.

Produto estéril

Dimensões

- 10cm x 15cm
- 10cm x 50cm
- 10cm x 60cm
- 15cm x 30cm
- 15cm x 60cm
- 30cm x 60cm

Pacote com

- 01 unidades

Indicação de uso

A Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Luiza é utilizada principalmente como curativo de diversas cirurgias com objetivo de proteger as cavidades cirúrgicas. É usado com êxito nas úlceras de pernas e escaras de decúbito, assim como, em curativos de queimaduras, amputação de membros e cirurgias plásticas.

Validade

Validade de 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.



AMED S/A
CNPJ: 10.403.238/0001-11

Endereço

Rodovia BR 135 Km 628 + 930m – S/N.
Curvelo/MG. Brasil.
CEP: 35797-899. Caixa Postal 139

Empresa

Quem somos
Trabalhe conosco

Contato

Contato
SAC
Ouvidoria

Legal

Relatório de Transparência
Política de Privacidade
Política de Qualidade

SAC

0800 606 8149
+55 38 99178-0379



AMED S/A - Todos os direitos reservados 2025



Indicação

Indicado como curativo após punção venosa (coleta de sangue) e injeção. O Adesivo Pós Coleta possui propriedades hipoalergênicas, além de ser fino e extremamente confortável para a pele.

Anvisa: 10332829011

Apresentação: Caixas com 100 ou 500 unidades. Disponível nas cores branca, bege ou infantil.

Composição: Tecido-não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico, TNT absorvente de poliéster e filme siliconado.

Indicação de Uso:

- Antes da aplicação do produto, realizar assepsia da pele. A oleosidade, uso de cremes e/ou pomadas podem prejudicar a fixação do produto.
- Para o correto uso, exercer moderada pressão sobre o produto no momento da aplicação.
- Em caso de irritação, suspender o uso.
- Produto não-reutilizável. Descartar após o uso.

Armazenar em local fresco e seco ao abrigo do sol e umidade; A exposição ao calor e a radiação UV podem causar alteração ou degradação do produto;

Validade de 24 meses após a fabricação.



ELETRODO DESCARTÁVEL

Indicação de uso

Os eletrodos de uso exclusivo para ECG são usados para o registro de superfície da atividade cardíaca mediante ao emprego de um eletrocardiógrafo.

Orientações de Uso

1. Verificar a integridade da embalagem dos eletrodos e do gel em caso de danos ou defeitos visíveis não utilizar o produto.
2. Escolher uma zona desprovida de pelos, feridas cutâneas e cicatrizes ou protuberâncias ósseas.
3. Depilar, limpar e secar a superfície de aplicação, evitar o uso de solvente, eles podem causar irritação a pele e limitar a adesão à pele.
4. Se usar álcool, assegure-se de que evaporou todo o produto antes de colocar os eletrodos.
5. Se necessário, massagear delicadamente a pele para melhorar a aderência do produto.
6. Conectar o eletrodo ao cabo paciente antes de seu posicionamento na pele do paciente.
7. Remover o suporte de proteção e aplicar o eletrodo na superfície cutânea.
8. Uma vez terminado o procedimento, desconectar o eletrodo e removê-lo delicadamente evitando ferimentos à pele.
9. Descartar os eletrodos depois de toda aplicação.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 02 de maio de 2022

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil





Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 00 de 14/07/2022



Matriz

+55 45 3039 4242
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br [medixbrasil](https://www.facebook.com/medixbrasil)

M

EQUIPO GRAVITACIONAL PARA INFUSÃO (MACROGOTAS) – M2LIFE

ANVISA Notificação N°: 81911939001

Nome Técnico: Equipo

ITEM 47

Imagens do Produto



Equipo Macrogotas M2 (Luer Slip)

NOTA: Imagem meramente ilustrativa.

Modelo: Equipo Macrogotas M2 (Luer Slip)

Formas de apresentação

O Equipo Gravitacional para Infusão (Macrogotas) M2LIFE é apresentado embalados de forma individuais (1 unidade), podendo ser:

- Embalagem 1º primária - Embalagens de Polietileno de Alta Densidade (HDPE);
- Embalagem 2º secundária – Acondicionado em caixa de papelão (caixa comum), contendo 500 embalagens primárias, com objetivo de acondicionar o produto acabado e expedição destes aos clientes.

Indicação de Uso/Finalidade

O Equipo Gravitacional para Infusão (Macrogotas) M2LIFE destina-se à administração de soluções parenterais, acondicionadas em sistemas fechados.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (EO).

Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

O princípio de funcionamento baseia-se em permitir o fluxo através do diferencial de pressão oriunda da diferença de altura entre o frasco de solução parenteral e o ponto de aplicação no paciente

Instruções de Uso

- 1 - Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do produto, utilizar somente se a embalagem estiver intacta.
- 2 - Abrir a embalagem conforme técnica asséptica.
- 3 - Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.
- 4 - Retirar a tampa protetora da ponta perfurante e conectar o equipo ao frasco de solução.
- 5 - Realizar a punção do scalp no paciente e conectar o equipo ao scalp ou cateter.
- 6 - Não utilizar caso os protetores da ponta perfurante e do conector macho estejam desconectados.
- 7 - Caso seja necessário introduza medicação pelo injetor lateral.
- 8 - Após o uso, descartar o produto conforme normas da autoridade sanitária vigente.

Equipo Macrogotas M2 (Luer Slip)

- Ponta perfurante – produzida de Acrilonitrila-Butadieno Estireno (ABS), usado principalmente para perfurações.
- Tampa da ponta perfurante - feita de Polietileno (PE) e o principal uso é para proteção da ponta perfurante.
- Câmara - feita de material de PVC transparente e a câmara é para armazenamento de líquidos.
- Tubulação - feita de material de PVC transparente e a principal utilização é para o transporte de líquidos, com extensão de 1,5m.
- Regulador - feito de Acrilonitrila-Butadieno Estireno (ABS) ou Polietileno (PE), o principal uso é para a regulação de líquido.
- Conector Luer Slip - feito de material Acrilonitrila-Butadieno Estireno (ABS) / PVC / Polipropileno (PP), e o principal uso é para conectar as agulhas ou o conjunto de veias do couro cabeludo.
- Conector Y - feito de Acrilonitrila-Butadieno Estireno (ABS) e borracha sem látex, e o principal uso é para injeção de líquido.
- Ventilação e filtro de ar - feita de fibra de vidro e o principal uso é tirar o ar do conjunto de infusão. Prazo de Validade - 3 Anos

Condições de armazenamento, transporte e manipulação do produto Armazenamento

- 1 - Armazenar o produto em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz;
- 2 - Manter conduta padrão de cuidados para estocagem, respeitar limite de empilhamento para garantir a integridade do produto.

Transporte

Modo de transporte através de caixas de papelão lacradas pelo fabricante. O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens, não dever ser arremessado de forma bruta para manter sua integridade.

Manipulação

- 1 - A manipulação deve ser feita somente por profissionais da área da saúde, habilitados e capacitados;
- 2 - O produto deve ser sempre manipulado mantendo a técnica asséptica adequada.

Advertências, Precauções e Cuidados Especiais

- 1 - Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do produto, utilizar o equipo somente se a embalagem estiver intacta e dentro do prazo de validade;
- 2 - É proibido usar o equipo caso seja encontrado um corpo estranho dentro da embalagem;
- 3- Não dobrar, não amassar a embalagem do equipo, sob o risco de romper a embalagem estéril e/ou danificar o equipo.

Importado e Distribuído por:

M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ 30.820.069/0002-03

Rua Manoel Vieira Garção, nº 77. Térreo, Sala 503. Itajaí
– SC. Fone: +55 45 3065-0828 sac@m2life.com.br

Responsável Técnico: Marcelo Galindo Lahoud / CRQ/SC Nº 09203411

INSTRUÇÕES DE USO – Tubo de Extensão Multivias M2LIFE

Nº Registro ANVISA: 81911939005

Nome Técnico: Tubos

ITEM 48

Imagens do Produto



Indicação de Uso

O Tubo de Extensão Multivias M2LIFE são dispositivos de infusão endovenosa, descartáveis, estéreis, de uso único, apirogênico, são utilizados como complemento de equipos, com função de alongar as vias de infusão, como complemento de equipos de administração intravenosa, cateteres, seringas, ou para a administração de múltiplas soluções endovenosas pelos profissionais da área médica hospitalar.

Apresentação

O Tubo de Extensão Multivias M2LIFE é comercializado de acordo com a seguinte apresentação comercial:

Embalagem primária – Embalados unitariamente em blister de polietileno.

Embalagem secundária – Embalagens de polietileno contendo 40 unidades.

Embalagem terciária - Caixa de papelão (caixa comum), contendo 800 unidades, o qual tem como objetivo de garantir a integridade do produto.

Composição / Dimensões

Todos os materiais utilizados na fabricação do Tubo de Extensão Multivia (Conector 2 vias) estão em conformidade com a especificação técnica, conforme descrição abaixo:

Nome do Componente	Material
Tampa protetora	PE
Conector Luer Slip	ABS

Braçadeira deslizante	PE
Conector de duas vias	PVC
Tubo de PVC	PVC
Luer Lock Fêmea	ABS
Tampa protetora	PE

Produto esterilizado por processo de óxido de etileno;

Fabricante recomenda uso único.

Proibido reprocessar.

Produto descartável.

Validade: 5 anos

Instruções de uso

- 1 - Selecionar o tubo de extensão multivia de acordo com os requisitos do procedimento médico;
- 2 - Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do produto, utilizar somente se a embalagem estiver intacta/integra;
- 3 - Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
- 4 - Retirar o dispositivo médico do invólucro protetor;
- 5 - Retirar a tampa protetora do conector luer fêmea e realizar o prime do produto;
- 6 - Fechar as pinças clamp;
- 7 - Retirar a tampa protetora do adaptador;
- 8 - Conectar o tubo extensor no cateter venoso, equipo de infusão ou outro dispositivo;
- 9 - Em caso de infusão simultânea, conectar as linhas venosas nos conectores luer fêmea;
- 10 - Certificar-se de que as conexões estão perfeitamente acopladas para evitar vazamentos;
- 11 - Abrir as pinças clamp;
- 12 - Regular o fluxo conforme a prescrição médica;
- 13 - Ao final do procedimento, descartar o produto conforme normas da autoridade sanitária vigente.

Advertências, Precauções e Cuidados Especiais

- 1 - Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados;
- 2 - Não utilizar produtos fora do prazo de validade e caso a embalagem estiver violada. Não usar o dispositivo se os componentes mostram sinais de danos;
- 3 - Atentar para as instruções de uso antes de proceder as utilizações do material, evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares;
- 4 - Certifique-se que todas as conexões são compatíveis e adequadas ao uso;
- 5 - Produto descartável, estéril e de uso único, não reutilizar;
- 6 - Proibido reprocessar;
- 7 - Reutilização ou reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e / ou levar a falha do dispositivo, o qual, por sua vez, pode resultar em paciente lesão, doença ou morte. A contaminação do dispositivo pode levar a lesão, doença ou morte do paciente;

- 8 - O produto deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem;
- 9 - Descartar em recipiente apropriado conforme legislação vigente.

Contraindicações

- 1 - Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos;
- 2 - Este produto não é adequado para infusão de líquidos solúveis em gordura e medicamentos, como leite gordo;
- 3 - É proibido infundir medicamentos incompatíveis com PVC;
- 4 - Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

Efeitos Adversos

O Tubo de Extensão Multivia M2LIFE não apresentará efeitos adversos, desde que, seja utilizado corretamente, de acordo com a instrução de uso e princípio tecnológico. Sugerimos que seja utilizado por pessoal treinado e qualificado, bem como, médico (a) e/ou enfermeiro (a).

Validade, Cuidados no Armazenamento e Transporte

- 1 - Armazenar o produto em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz;
- 2 - Armazenar o produto em local fechado com umidade não superior a 80%;
- 3 - Manter conduta padrão de cuidados para estocagem, respeitar limite de empilhamento para garantir a integridade do produto;
- 4 - Modo de transporte através de caixas de papelão lacradas pelo fabricante;
- 5 - O produto não deve ser arremessado de forma bruta para manter sua integridade.

Validade – 5 anos.

Fabricado

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.
No. 98, Baiyang Bridge, Zheng Town, Tianning, Changzhou, Jiangsu, China.

Importado e Distribuído por:

M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ 30.820.069/0002-03
Rua Manoel Vieira Garção, nº 77. Térreo, Sala 503. Itajaí – SC.
Fone: +55 45 3065-0828
sac@m2life.com.br

Responsável Técnico: Marcelo Galindo Lahoud / CRQ/SC Nº 09203411



INSTRUÇÃO DE USO

NOME DO PRODUTO: ESPARADRAPO - WILTEX

ITEM 55

Registro MS: 10150470704

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Matéria Prima: 40% algodão, 18% poliéster, 42% adesivo médico sensível à pressão de óxido de zinco

Método de Esterilização: **N/A**

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Esparadrapo Wiltex em rolo com carretel é indicado para fixação de todos os tipos de curativos, seringas, agulhas, cateteres etc.

INDICAÇÃO DE USO

O Esparadrapo Wiltex em rolo com carretel é indicado para fixação de todos os tipos de curativos, seringas, agulhas, cateteres etc.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Selecione o tipo e tamanho de fita correta para a aplicação.
2. Corte o pelo, se necessário.
3. Aplicar a fita com a pele completamente seca.
4. Minimize o toque do adesivo.
5. Aplique a fita sem tensão à pele limpa e seca.

6. Alise a fita adesiva no lugar com pressão suave, delicada. Evite aberturas e enrugamentos.

Em geral não circule completamente um membro com a fita.

7. Esfregue o local para conseguir boa adesão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Esparadrapo: 40% algodão, 18% poliéster, 42% adesivo médico sensível à pressão de óxido de zinco

Suporte interno: PVC

Carretel: polipropileno

Capa do carretel: polipropileno

Largura (mm)	Comprimento (m)	Cor
12,5	4,5	Branco
25	4,5	Branco
50	4,5	Branco
75	4,5	Branco
100	4,5	Branco

FOTO



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ZOTBP001	ESPARADRAPO 12,5mmX4,5- WILTEX
ZOTBP002	ESPARADRAPO 25mmX4,5 - WILTEX
ZOTBP003	ESPARADRAPO 50mmX4,5 - WILTEX
ZOTBP004	ESPARADRAPO 75mmX4,5- WILTEX
ZOTBP005	ESPARADRAPO 100mmX4,5 - WILTEX

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O produto é fornecido embalado unitariamente em carretéis de polipropileno com tampa em polipropileno.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em ambiente cuja umidade relativa não seja superior a 80%, temperatura entre (-5 e +40) °C.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Deve ser manuseado de acordo com o protocolo de instituição.

Fabricante recomenda o uso único.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259

INSTRUÇÕES DE USO

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL

DESCRIÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL** é composto por duas espátulas anatômicas dispostas paralelamente, unidas em suas extremidades distais por um parafuso. Este, ao ser rosqueado, possui a função de promover gradualmente a abertura das espátulas.

COMPOSIÇÃO

Espéculo: Poliestireno (PS), Polietileno (PE) e Lubrificante.

Lote/Partida: vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL** tem validade de 24 meses.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL** é apresentado em 4 diferentes tamanhos, sendo eles: Virgem, Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G).

Podem ser dispostos em caixas com 50, 100, 125, 200 e 250 unidades, e embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

FINALIDADE

O **ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL LUBRIFICADO ESTÉRIL** é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.
2. Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
3. Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.
4. Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Transportar o produto em sua embalagem original e armazenar em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

DESCARTE

Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

**ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.
DESCARTAR APÓS O USO.**

PRODUTO ESTERILIZADO POR: RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO

Fabricado por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 361 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

BRASIL

CNPJ. 48.740.849/0004-70

☎ SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7000
e-mail: sac@cralplast.com.br

Distribuído por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

BRASIL

CNPJ. 48.740.849/0001-28

Responsável Técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN-SP 151479



Revisão 00 de 27/08/2021



INSTRUÇÃO DE USO

NOME DO PRODUTO: FITA MICROPOROSA - WILTEX

Registro MS: 10150470343

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Matéria Prima: Uma fita auto-aderente que tem como suporte papel hipoalergênico permeável ao ar e vapor. É recoberto de massa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea.

Método de Esterilização: **N/A**

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Fita Adesiva Cirúrgica Microporosa Wiltex é uma fita auto-aderente que tem como suporte papel hipoalergênico permeável ao ar e vapor. É recoberto de massa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea, e que não deixa resíduos. Devido à sua maleabilidade, adapta-se bem às áreas de contorno do corpo, tais como proeminências ósseas. Sua flexibilidade permite liberdade de movimentos.

INDICAÇÃO DE USO

As Fitas Adesivas Médicas Wiltex são indicada para ferimentos superficiais e para a fixação de curativos em pacientes.

INSTRUÇÃO DE USO**A- Aplicação da Fita**

1. Selecione o tipo e tamanho de fita correta para a aplicação.
2. Corte o pelo, se necessário.
3. Aplicar a fita com a pele completamente seca.
4. Minimize o toque do adesivo.
5. Aplique a fita sem tensão à pele limpa e seca.
6. Alise a fita adesiva no lugar com pressão suave, delicada. Evite aberturas e enrugamentos.

Em geral não circule completamente um membro com a fita.

7. Esfregue o local para conseguir boa adesão.

Colocação geral da fita

Aplique a fita sem tensão, gentilmente mas firmemente alisando a superfície para maximizar a adesão. A fita deve se estender pelo menos 1.25 cm além do curativo. A fita adesiva não deve ser puxada ou esticada quando aplicada. Se o inchaço ocorrer, afrouxar e re-fixar ou substituir a fita adesiva para aliviar a tensão.

B - Remoção da Fita

1. Soltar a borda da fita.
2. Estabilize a pele com um dedo. Remova a fita lentamente na direção do crescimento do pelo, mantendo perto da superfície da pele e puxando para trás sobre ela mesma.
3. Para fita que está fortemente aderida à pele ou cabelo, você pode considerar o uso de um removedor de adesivo médico ou umedecer para amolecer o adesivo ao longo da borda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura (mm)	Comprimento (m)	Comprimento (m)	Comprimento (m)
12	4,5	9	10
12,5	4,5	9	10
24	4,5	9	10
25	4,5	9	10
48	4,5	9	10
50	4,5	9	10
75	4,5	9	10
100	4,5	9	10

FOTO**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25101W	FITA MICROP. 12,5X10 C/CARR. WILTEX
25111W	FITA MICROP. 25X10 C/CARR. WILTEX
25121W	FITA MICROP. 50X10 C/CARR. WILTEX
25141W	FITA MICROP. 100X10 C/CARR. WILTEX
25221W	FITA MICROP. 50X4,5 C/CARR. WILTEX



INSTRUÇÃO DE USO

25241W	FITA MICROP.100X4,5 C/CARR.WILTEX

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Fita Adesiva Médica Wiltex é fornecida em carretel não estéril.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Remova cuidadosamente fita, elevando uma das pontas e retirando sem puxá-la para cima. Se houver pêlos no local de aplicação, a fita deve ser removida na direção de crescimento dos mesmos.

Produto de uso único.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259

FICHA TÉCNICA



- **Produto:** Fita microporosa branca 5cm x 10m
- **Código:** FT510
- **Marca:** COPERTINA
- **Cadastro Anvisa:** Produto com registro na ANVISA

Características Técnicas:

Uso pretendido: Indicada para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres e dispositivos médico-hospitalares em geral.

Características:

- Suporte (Falso Tecido): Fibra de viscose
- Adesivo: Resina acrílica
- Acondicionado em carretel plástico (polipropileno) com tampa vedante, garantindo proteção e conservação do produto.
- Microporoso: Permite a troca gasosa, contribuindo para o conforto da pele.
- Hipoalergênico: Reduz riscos de reações alérgicas.

Modo de Uso:

- Destacar o comprimento desejado.
- Fixar diretamente sobre o curativo ou dispositivo a ser imobilizado.

Advertências e Precauções:

- Em caso de irritação ou umidade na pele, descontinuar o uso.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada ou vencida. Manter em temperatura ambiente, na embalagem original, em local seco, arejado e protegido do sol.
- Não utilizar álcool, éter, benzina ou outros solventes para remover o esparadrapo.

ITEM 66

**Fita Adesiva Hospitalar de Papel Crepado – MAXICOR**

Confeccionada em dorso de papel crepado, adesivo a base de borracha natural (látex) e tubo de papelão.

Os mais comuns modos de uso no meio hospitalar são: identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras entre outros. Possui inúmeras utilidades dentro de hospitais, clínicas e laboratórios. Não deve ser aplicada sobre a pele.

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

ULTRA GEL

Gel para Ultra-som

DESCRIÇÃO

O produto consiste em um gel, a base de água, indicado para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, usado entre a área a ser examinada e o aparelho de ultrassonografia utilizado pelo médico, impedindo a presença de ar entre as partes e facilitando o deslizamento sobre a área a ser examinada, proporcionando um ideal contato pele-transdutor.

O produto é utilizado apenas como meio de contato entre a área examinada e o transdutor do aparelho de ultrassonografia utilizado pelo médico.

CARACTERÍSTICAS

Consistência adequada

Componentes de alta pureza

Hidrossolúvel, facilmente removível.

Hipoalergênico

Acusticamente correto para as gamas de frequência comumente empregadas

Alto rendimento

COMPOSIÇÃO:

Água purificada

Carbômero

EDTA

Trolamina

Glicerol

Nipagim

Essência

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

Indicado como meio de contato entre a pele do paciente e o transdutor do aparelho de ultrassonografia

MODO DE USAR:

Aplicar sobre a área a ser examinada ou diretamente no transdutor.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS

O produto é de uso exclusivamente externo, é atóxico e hipoalergênico, não oferecendo em geral nenhum risco ao usuário.

Na hipótese de alguma reação adversa, suspender o uso e procurar orientação médica.

APRESENTAÇÃO

O produto será comercializado em frasco plástico contendo 100, 250 ou 300 gramas, garrafa plástica contendo 1 ou 2 kg ou ainda em bombonas contendo 5 kg, nas apresentações: ULTRA, FISIO, OSTEO E ESTÉTICA

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em local seco, ao abrigo da luz, em temperatura ambiente.

DESCRIÇÃO PARA A EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO

O produto apresenta-se eficaz e seguro para a finalidade a que se destina, desde que sejam seguidos as orientações, suas advertências e seu modo de uso.

Resp. Técnico: Nivia Freitas do Nascimento

CRF/MG 26042

Fabricado por:

MULTIGEL IND. COM. DE PROD. GELATINOSOS LTDA

Rua Francisco Andrade, 111, Faixa Verde.

CEP. 37560-000 – Silvianópolis - MG

CNPJ 49.604.226/0001-90.

Ind. Brasileira.

Notificação ANVISA N °:

Responsável Técnico

Nivia Freitas do Nascimento

CRF/MG 26042

Representante Legal

Valmir Castillo Sanches





ITEM 77

NOME DO PRODUTO: LANCETA SEGURANÇA WILTEX

Número ANVISA: 10150470467

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Lancetas

Nome Comercial: Lancetas de Segurança Wiltex

Matéria Prima:

Componente	Matéria Prima
Agulha	AISI 304
Capa protetora	Polietileno

Método de Esterilização: Feixe de Eletrons

Produto Estéril: sim

Validade: 05 Anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

As Lancetas Wiltex são descartáveis com dispositivo de segurança, usadas principalmente para coletar sangue capilar para testes de glicemia.

INDICAÇÃO DE USO

As Lancetas de Segurança Wiltex são indicadas para obter as amostras de sangue capilar para testes de monitoramento de glicose no sangue.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Remova a tampa protetora;
2. Realizar antissepsia local;
3. Pressione a Lanceta de segurança no local escolhido para disparar;
4. Após o uso descartar a Lanceta de Segurança no recipiente adequado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A lanceta possui mola interna para que seja ativada a agulha. Após punção a agulha retrai-se automaticamente.



*Isento de látex e DEHP

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	GAUGE	PROFUNDIDADE	COR
04-2122	21G	2,2MM	AMARELO
04-2618	26G	1,8MM	AZUL
04-2818	28G	1,8MM	LILÁS
12-2118	21G	1,8MM	AMARELO
12-2318	23G	1,8MM	VERDE
12-2818	28G	1,8MM	LILÁS

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Caixa com 100 unidades

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

A Lanceta de Segurança deve ser armazenada em local limpo, seco e ventilado. Manter a temperatura de 0-40 °C, umidade de 0-80% RH e Pressão de 1 KPA.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

PROIBIDO REPROCESSAR

Produto de uso único, descartar após o uso;

Não reutilizar o produto;

Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado;

Não utilizar o produto fora da data de validade.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Lençol de Papel Descartável 70x50 – Descarbox

O **lençol descartável de papel** para maca da Descarbox, foi desenvolvido para auxiliar os profissionais de saúde, na agilidade do atendimento dos pacientes, da forma mais higiênica possível.

É um **lençol ecológico**, que é possível trocar a cobertura da maca a cada novo atendimento de forma rápida e segura para o paciente. O **lençol descartável** é uma medida de higiene, segurança e responsabilidade no atendimento ao cliente.

Pode ser usado como roupa de cama hospitalar, para cobertura de maca, mesa de exames em ambientes médicos hospitalares, em consultórios médicos, espaços estéticos e afins.

Um produto de excelente qualidade, macio, feito de fibras celulósicas brancas, o que confere ao produto a coloração branca com pequenos pontinhos mais escuros.

Características do Lençol Descartável de Papel

- Item básico no cumprimento dos protocolos de higienização no atendimento de saúde;
- Econômico e acessível;
- Prático, rápido e fácil para realizar a troca entre um paciente e outro;
- Possui uma textura macia, flexível e resistente;
- Fabricado com material atóxico e hipoalergênico;
- Atende os protocolos dos órgãos governamentais que exigem o uso de lençóis de papel descartáveis;
- Fabricado a partir de fibras celulósicas;
- Lençol não estéril;
- Embalagem: 1 Rolo com 50 Metros;
- Medida: 70 cm de Largura;
- Fácil e Prático;
- Validade 5 Anos;
- Rolo de Papel (Não é TNT).

Indicação de uso do Lençol de Papel 70x50

- Uso Profissional;
- Ideal para a ser utilizado em hospitais e clínicas médicas especializadas que necessitem de lençol descartável para cama ou maca;
- Reservar em local seco, arejado e protegido de grandes variações de temperatura.



Produto: Medix Brasil - Luva para Procedimento Não Cirúrgico em Látex de Borracha Natural, com pó.

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE:

Ficha Técnica

IMAGEM DO PRODUTO	
DESCRIÇÃO	Luva para procedimento não cirúrgico em látex de borracha natural, com pó - Medix Brasil, foram desenvolvidas para a proteção dos pacientes e dos profissionais da saúde, em procedimentos não cirúrgicos contra riscos biológicos.
INDICAÇÃO DE USO	As Luvas para procedimento não cirúrgico em látex de borracha natural, com pó - Medix Brasil, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	✓ Fabricada em 100% látex de borracha natural ✓ Não estéril ✓ Com pó (amido de milho) ✓ Ambidestra ✓ Superfície lisa ✓ Punho com bainha ✓ Espessura mínima: 0,08mm ✓ Cor: natural ✓ Disponível nos tamanhos: PP/ P/ M/ G ✓ Comprimento: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G) ✓ Certificada pelo INMETRO ✓ Validade 5 anos ✓ Descartável e de uso único
APRESENTAÇÃO	Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos.
ORIENTAÇÕES DE USO	Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas e após o descarte das luvas. Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas. Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

	Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.
PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS	<i>“ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX”; “PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”</i> Ler atentamente as Instruções de Uso; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas; Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas; Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	As Luvas para procedimento não cirúrgico em látex de borracha natural, com pó - Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242
SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini
CRF-PR Nº 25368
Louise Marine Wittlich Succo
CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br





ITEM 91, 92



Luva de Vinil Sem Pó

A Luva de Vinil sem Pó da Medix Profissional é fabricada em PVC (cloreto de polivinila), oferecendo uma barreira eficaz contra contaminantes em atividades de uso geral. Livre de látex e de pó, é ideal para pessoas com sensibilidade a proteínas do látex ou ao amido de milho. Lisa, ambidestra, não esterilizada e com excelente maleabilidade, proporciona conforto e proteção em tarefas que exigem troca frequente de luvas e baixo risco de exposição a agentes biológicos. Uma escolha econômica e prática para diferentes setores.

Cores: ☐

Modelos:

SKU: 6170 G	SKU: 9548 GG	SKU: 6168 M	SKU: 6156 P



Compre Online
Consumidor



Diferenciais



Hipoalergênica: livre de látex e pó



Boa maleabilidade e conforto no uso prolongado



Ideal para manipulação de alimentos e processos industriais leves

Ficha Técnica

Indicação

Fabricada em 100% Policloreto de vinila (PVC)
Sem pó
Superfície lisa
Ambidestra
Não estéril
Espessura: 0,08mm (mínimo)
Cor: transparente
Disponível nos tamanhos: 06 (P), 07 (M), 08 (G), 09(GG)
Comprimento mínimo: 6 ? 220mm; 7 ? 230mm; 8 ? 240mm; 9 ?250mm
Validade 5 anos
Descartável e de uso único



Compre Online
Consumidor



Luva Plástica HDPE

Luvras Plásticas de Polietileno de Alta Densidade (HDPE) são soluções práticas e ...



Ambisafe – Luva de Nitrilo Reutilizável

A Luva Ambisafe Medix Profissional é produzida em borracha nitrílica ultraflexível...



Multiuso Plus – Luva de Látex Reforçada

A Luva Multiuso Plus da Medix Profissional garante proteção, resistência e aderên...

novidades por e-mail

Seu nome

Seu e-mail

Enviar



© 2026 Medix

[Canal de Ética](#)

[Política de Privacidade](#)

[Medix Online](#)

Ouvidoria

sac@medixbrasil.com.br
Sac: 0800 006 3036
Atendimento das 9h às 18h (dias úteis)

Matriz

10.268.780/0001-09
Rua Paraná, 1791
Cascavel, PR – 85812-010

Filial


10.268.780/0002-90
Rod. SC 417, 10535 (Barracão 1 a 4)
Garuva/SC – 89248-000

Envelope Autosselante 240x380mm E 150X300mm– HospFlex - Embalagem com 200 unidades.

- * Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco.
- * Atóxico.
- * Resistência Mecânica.

Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam passar por processo de esterilização.

- MarcaHOSPFLEX
- Área ProfissionalUso Clínico - Odontológico
- TipoEnvelope de Esterilização

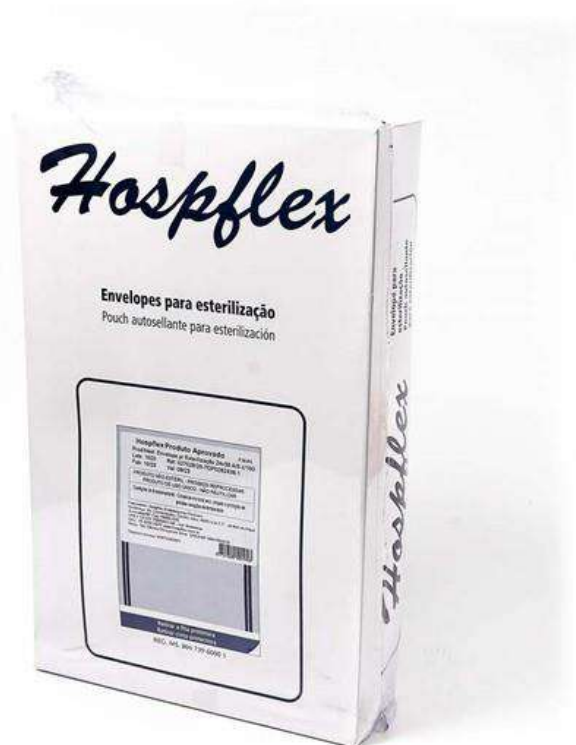

Envelope p/ Esterilização Vital Pack

Tamanhos: 300x365, 90x260



Descrição do produto:
A **Embalagem para Esterilização Vitalpack** é ideal para **garantir a esterilização segura de instrumentos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais**.

Seu design permite acondicionar materiais de forma prática, assegurando que fiquem protegidos durante o processo de esterilização por **vapor saturado ou óxido de etileno**, reduzindo riscos para pacientes e profissionais. O indicador químico impresso nas laterais muda de cor, comprovando a eficácia do processo de esterilização.

Compatível:

- Esterilização por vapor saturado
- Esterilização com óxido de etileno (400mg/L – 800mg/L a 130°F)

Características:

- Material: filme termoplástico 54 g/m² + papel grau cirúrgico branqueado 60 g/m² ±5%
- Porosidade controlada para passagem de vapor ou gás
- Indicadores químicos impressos:
 - Vapor: azul → preto
 - Óxido de etileno: rosa → amarelo
- Uso único – **não reprocessar**
- Embalagem resistente e segura para transporte e armazenamento de instrumentos

Apresentação:

- Kit com 200 unidades, prontas para esterilização

Benefícios:

- Garantia de **esterilização eficaz**
- Protege instrumentos de contaminação
- Ideal para **hospitais, clínicas e laboratórios veterinários e humanos**
- Fácil manuseio e armazenamento seguro

FICHA TÉCNICA



- **Produto:** Curativo adesivo ocular adulto 58mm x 82mm
- **Código:** COPE20AO
- **Marca:** COPERTINA
- **Cadastro Anvisa:** Produto com registro na ANVISA

Características Técnicas:

Uso pretendido: curativo aplicado topicamente na região ocular para fornecer proteção mecânica à superfície da pele e estruturas subjacentes. Promove a cobertura da área ocular em diversas situações clínicas, como pós-operatório oftalmológico, proteção contra agentes externos (poeira, vento, luz intensa) e como barreira em tratamentos dermatológicos locais.

Características:

- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)
- Design e materiais que permitem a permeabilidade ao ar e à umidade,
- Apresentação individual e formato anatômico;
- Constituída por fibras de viscose e polietileno, oferecendo capacidade de absorção de fluidos (exsudato) e proteção contra impactos leves.
- A camada de polietileno em contato com a pele impede a aderência ao ferimento ou à superfície ocular, facilitando a remoção atraumática.
- Falso tecido entrelaçado revestido com massa adesiva hipoalergênica, proporcionando fixação segura sem irritar a pele circundante.
- Camada de papel siliconado ou com filme plástico que protege a superfície adesiva até o momento da aplicação.
- Dimensões: 58 mm x 82 mm (tamanho nominal).

Instruções de Uso:

1. Realizar a limpeza adequada da área ocular conforme protocolo médico.
2. Secar cuidadosamente a pele ao redor da área a ser protegida, removendo o excesso de umidade.
3. Remover o curativo da embalagem individual, manipulando-o pelas bordas para manter a esterilidade da área de contato.
4. Posicionar a parte central da almofada absorvente sobre a área a ser protegida.
5. Aplicar as extremidades adesivas sobre a pele adjacente, fixando o curativo de forma suave, sem exercer tensão excessiva.

Notas importantes:

- Em alguns indivíduos com sensibilidade cutânea, pode ocorrer desconforto transitório na área de aplicação. Caso ocorra

irritação persistente ou sinais de hipersensibilidade (erupção cutânea, prurido), interromper o uso e consultar um profissional de saúde.

- Não utilizar o produto caso a embalagem individual esteja danificada ou violada, comprometendo a esterilidade do conteúdo.
- Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz solar direta e umidade excessiva.

Biofrasco Nutri Enteral 500ml - Biomédica

Biofrasco para Nutrição enteral Biomédica Produto higiênico não estéril, embalado individualmente em saco de polietileno.

Para quem é indicado?

É um artigo médico-hospitalar de uso único indicado para alimentação enteral.

Apresentação/Rendimento:

Apresentação: Frasco 500ml.

Rendimento: 1 unidade.

Características:

Os frascos para nutrição enteral ficam pendurados em um suporte através de sua alça acima do paciente, para que através da força da gravidade a nutrição enteral desça até o paciente. A alça tem resistência de suportar a nutrição enteral que será administrada. A tampa veda o bico do frasco, não deixando que a nutrição vaze pelo mesmo. A conexão da tampa se encaixa perfeitamente no equipo por onde passará a nutrição.





ITEM 125,126,128

CLORETO DE SÓDIO 0,9% (Solução Fisiológica)

BASAL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Solução Injetável



SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 %

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA

Cloreto de sódio 0,9%

APRESENTAÇÃO

Solução injetável, límpida, estéril e apirrogênica.

Caixa contendo 50 frascos de polipropileno com 125 mL em sistema fechado.

Caixa contendo 40 frascos de polipropileno com 250 mL em sistema fechado.

Caixa contendo 24 frascos de polipropileno com 500 mL em sistema fechado.

Caixa contendo 16 frascos de polipropileno com 1000 mL em sistema fechado.

USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL da solução contém:

Cloreto de sódio- NaCl.....9 mg

Água para injeção q.s.p. 1 mL

Conteúdo eletrolítico

Sódio (Na⁺).....154 mEq/L

Cloreto (Cl) 154 mEq/L

OSMOLARIDADE: 308 mOsm/L

pH.....4,5 – 7,0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular.

Os níveis de sódio normalmente determinam o volume do fluido extracelular e ele é um importante regulador da osmolaridade, do equilíbrio ácido-base e auxilia na estabilização do potencial de membrana das células.

Os íons de sódio circulam através da membrana celular por meio de vários mecanismos de transporte, dentre eles a bomba de sódio (Na⁺ - K⁺ - ATPase). O sódio também desempenha importante papel na neurotransmissão, na eletrofisiologia cardíaca e no metabolismo renal.

O excesso de sódio é excretado principalmente pelo rim, pequenas porções pelas fezes e através da sudorese. O cloreto de sódio 0,9% é fundamental para manter o equilíbrio sódio potássio e contribuir para a recuperação da manutenção da volemia.

3. CONTRAINDICAÇÕES

A solução de cloreto de sódio 0,9% é contraindicada em casos de hipernatremia, retenção hídrica e hiperclorêmia.



4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% deve ser usada com cautela em pacientes hipertensos, com insuficiência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia, insuficiência renal grave, edema pulmonar, e obstrução do trato urinário.

Avaliações clínicas e determinações laboratoriais periódicas são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações eletrolíticas e balanço ácido-base durante a terapia parenteral prolongada, ou sempre que a condição do paciente demonstrar necessidade de tais avaliações.

Devem ser tomados cuidados na administração de solução injetável de cloreto de sódio em pacientes recebendo corticosteroides, corticotropina ou medicamentos que possam causar retenção de sódio.

Gravidez: Categoria C. Estudos da reprodução animal não demonstram que as soluções injetáveis de cloreto de sódio 0,9% possam interferir no desenvolvimento fetal, durante a lactação e amamentação.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.

Uso pediátrico, geriátrico e em outros grupos de risco.

No caso da administração de soluções parenterais de grande volume, em pacientes idosos, pode ser necessário reduzir volume e a velocidade de infusão, para evitar a sobrecarga circulatória, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca e renal.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na solução de cloreto de sódio 0,9%. Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Não armazenar as soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Solução injetável, límpida, estéril e apirrogênica.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.



Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

Apenas para Soluções Parenterais de Grande Volume

A solução é acondicionada em frascos em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipo estéril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

Para abrir:

Verificar se existem vazamentos mínimos comprimindo a embalagem primária com firmeza. Se for observado vazamento de solução, descartar a embalagem, pois a sua esterilidade pode estar comprometida.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar a solução para administração.

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:

- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs e
- desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.

- 1- Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool 70%;
- 2- Suspender a embalagem pela alça de sustentação;
- 3- Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;
- 4- Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.

Para adição de medicamentos:

Atenção: verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução e, quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.

Apenas as embalagens que possuem dois sítios, um para o equipo e outro para a administração de medicamentos, poderão permitir a adição de medicamentos nas soluções parenterais.


Para administração de medicamentos antes da administração da solução parenteral:

- 1- Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;
- 2- Utilizar uma seringa com agulha estéril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral.
- 3- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral.
- 4- Pós liofilizados devem ser reconstituídos/suspendidos no diluente estéril e apirogênico adequado antes de ser adicionados à solução parenteral.

Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:

- 1- Fechar a pinça do equipo de infusão;
- 2- Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;
- 3- Utilizar seringa com agulha estéril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;
- 4- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;

5- Prosseguir a administração.

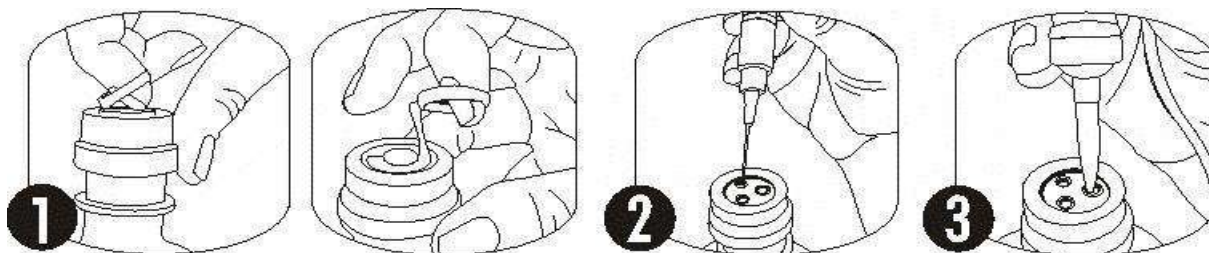

Posologia

O preparo e administração da Solução Parenteral devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.

A dosagem deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, reações adversas podem ocorrer e incluem resposta febril, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite estendida no local de injeção, extravasamento e hipervolemia.

As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução da lacrimação, taquicardia, hipertensão, falência renal e edema pulmonar.

Em pacientes com ingestão inadequada de água a hipernatremia pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. SUPERDOSE

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (hipernatremia, hiperclôremia, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e promover a interrupção da administração da solução parenteral, podendo haver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

**DIZERES LEGAIS**

M.S. nº: 1.1120.0005

Farm. Resp.: Carolina Buzelato Orlandi – CRF/RS nº 8615

Fabricado e registrador por:

BASAL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Av.: Rossetti, 695 – Caxias do Sul – RS

CNPJ: 36.526.169/0001-27

Indústria Brasileira

SAC: (54) 3205-2127

Uso restrito a hospitais.

Venda sob prescrição médica.

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 12/07/2024.



HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA A BULA – CLORETO DE SÓDIO 0,9%

[illegible]

ITEM 127

Cloreto de sódio 0,9%

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

**Solução injetável
0,9g / 100 mL**

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
Cloreto de sódio 0,9%

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÃO

Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.

Apresentações: frascos de plástico transparente com 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL

USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL da solução contém:

cloreto de sódio.....9 mg.

água para injetáveis q.s.p.....1 mL

Conteúdo eletrolítico:

Sódio (Na⁺) 154 mEq/L

Cloreto (Cl⁻) 154 mEq/L

OSMOLARIDADE: 308 mOsm/L

pH 4,5 – 7,0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular.

Os níveis de sódio normalmente determinam o volume do fluido extracelular e ele é um importante regulador da osmolaridade, do equilíbrio ácido-base e auxilia na estabilização do potencial de membrana das células.

Os íons de sódio circulam através da membrana celular por meio de vários mecanismos de transporte, dentre eles a bomba de sódio (Na – K – ATPase). O sódio também desempenha importante papel na neurotransmissão, na eletrofisiologia cardíaca e no metabolismo renal.

O excesso de sódio é excretado principalmente pelo rim, pequenas porções pelas fezes e através da sudorese. O cloreto de sódio 0,9% é fundamental para manter o equilíbrio sódio potássio e contribuir para a recuperação da manutenção da volemia.

3. CONTRAINDICAÇÕES

A solução de cloreto de sódio 0,9% é contraindicada em casos de hipernatremia, retenção hídrica e hiperclorêmia.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% deve ser usada com cautela em pacientes hipertensos, com insuficiência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia, insuficiência renal grave, edema pulmonar e obstrução do trato urinário.

Avaliações clínicas e determinações laboratoriais periódicas são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações eletrolíticas e balanço ácido-base durante a terapia parenteral prolongada, ou sempre que a condição do paciente demonstrar necessidade de tais avaliações.

Devem ser tomados cuidados na administração de solução injetável de cloreto de sódio em pacientes recebendo corticosteroides, corticotropina ou medicamentos que possam causar retenção de sódio.

Gravidez: Categoria C. Estudos da reprodução animal não demonstram que as soluções injetáveis de cloreto de sódio 0,9% possam interferir no desenvolvimento fetal, durante a lactação e amamentação.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.

Uso pediátrico, geriátrico e em outros grupos de risco

No caso da administração de soluções parenterais de grande volume, em pacientes idosos, pode ser necessário reduzir volume e a velocidade de infusão, para evitar a sobrecarga circulatória, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca e renal.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na solução de cloreto de sódio 0,9%. Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Não armazenar as soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Solução injetável, límpida, estéril e apirrogênica.

Isento de PVC e látex.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.

Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

A solução é acondicionada em frascos em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipo estéril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

Para abrir:


Verificar se existem vazamentos mínimos comprimindo a embalagem primária com firmeza. Se for observado vazamento de solução, descartar a embalagem, pois a sua esterilidade pode estar comprometida.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar a solução Cloreto de Sódio 0,9% para administração.

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:

- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs e
- desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.

1. Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool a 70%;
2. Identificar e remover o lacre do sítio de conexão do equipo. Nos frascos, este sítio está protegido pelo lacre de maior diâmetro. (figura 1);
3. Suspender a embalagem pela alça de sustentação;
4. Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;
5. Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.

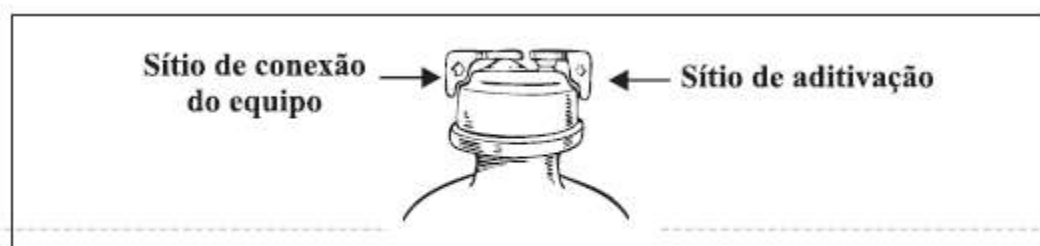

(Figura 1)

Para adição de medicamentos:

Atenção: Verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução e, quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.

Apenas as embalagens que possuem dois sítios, um sítio para o equipo e outro para a administração de medicamentos, poderão permitir a adição de medicamentos nas soluções parenterais.

Para administração de medicamentos antes da administração da solução parenteral:

1. Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;
2. Identificar o lacre do sítio de aditivação: ele está protegido pelo lacre de menor diâmetro (figura 1);
3. Quebrar o lacre do sítio de aditivação;
4. Utilizar uma seringa com agulha estéril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral;
5. Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
6. Pós liofilizados devem ser reconstituídos / suspensos no diluente estéril e apirogênico adequado antes de serem adicionados à solução parenteral.

Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:

1. Fechar a pinça do equipo de infusão;
2. Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;
3. Utilizar seringa com agulha estéril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;
4. Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
5. Prosseguir a administração.

Posologia

O preparo e administração da Solução Parenteral devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.

A dosagem deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, reações adversas podem ocorrer e incluem resposta febril, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite estendida no local de injeção, extravasamento e hipervolemia.

As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução da lacrimação, taquicardia, hipertensão, falência renal e edema pulmonar.

Em pacientes com ingestão inadequada de água a hipernatremia pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

9. SUPERDOSE

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (hipernatremia, hipercloremia, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e promover a interrupção da administração da solução parenteral, podendo haver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. 1.0041.0098

Farmacêutica Responsável: Cíntia M. P. Garcia **CRF-SP** 34871

Fabricado por:

Fresenius Kabi Brasil Ltda

Aquiraz - CE

Registrado por:

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP

C.N.P.J. 49.324.221/0001-04 – Indústria Brasileira

SAC 0800 7073855

USO RESTRITO A HOSPITAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 23/04/2021.



Histórico de Alteração da Bula

Dados da Submissão Eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das Alterações de Bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações Relacionadas
12/03/2014	0177562/14-6	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Todos	VP e VPS	Todas
27/05/2014	0415039/14-2	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	VP e VPS	Todas
01/03/2019	0196308/19-2	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 1. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER	VP	9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1000 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 80 FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 48 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 30 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML 9 MG/ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML

							DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?		
							IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 4.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 7.POSOLOGIA E MODO DE USAR 8. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	

23/04/2021	----	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	----	----	----	----	8. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	Todas

Informativo – Ficha Técnica

No que tange a RDC nº 431/2020, que dispõe sobre o carregamento de instruções de uso no portal eletrônico da Anvisa, vinculado aos processos de notificação ou de registro de dispositivos médicos, a empresa Medix Brasil legalmente constituída no País e devidamente regularizada no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) informa que para acesso à Fichas técnicas, Catálogos, Imagens de comercialização e demais informações a cerca de nossos produtos disponíveis e em linha, o usuário poderá acessar o link:

<https://linktr.ee/medixbrasilfv>

Caso ainda possuam alguma dúvida ou necessidade de maiores informações, gentileza enviar email para sac@medixbrasil.com.br

Detentor da Notificação

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Resp. Técnica: Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01





Esparadrapo impermeável branco – Copertina®

Finalidade: Os esparadrapos são indicados para fixação de curativos e produtos médico-hospitalares.

Versões:

- 1,2cm x 4,5m – Caixa máster: 144 unidades
- 2,5cm x 0,9m – Caixa máster: 192 unidades
- 2,5cm x 4,5m – Caixa máster: 96 unidades
- 5 cm x 4,5m – Caixa máster: 96 unidades
- 10 cm x 4,5m – Caixa máster: 24 unidades

Características:

- Hipoalergênico
- Não estéril.

Informativo – Ficha Técnica

No que tange a RDC nº 431/2020, que dispõe sobre o carregamento de instruções de uso no portal eletrônico da Anvisa, vinculado aos processos de notificação ou de registro de dispositivos médicos, a empresa Medix Brasil legalmente constituída no País e devidamente regularizada no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) informa que para acesso às Fichas técnicas, Catálogos, Imagens de comercialização e demais informações a cerca de nossos produtos disponíveis e em linha, o usuário poderá acessar o link:

<https://linktr.ee/medixbrasilfv>

Caso ainda possuam alguma dúvida ou necessidade de maiores informações, gentileza enviar email para sac@medixbrasil.com.br

Detentor da Notificação

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Resp. Técnica: Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01





INSTRUÇÃO DE USO

NOME DO PRODUTO: FITA MICROPOROSA - WILTEX

Registro MS: 10150470343

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas

Matéria Prima: Uma fita auto-aderente que tem como suporte papel hipoalergênico permeável ao ar e vapor. É recoberto de massa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea.

Método de Esterilização: **N/A**

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Fita Adesiva Cirúrgica Microporosa Wiltex é uma fita auto-aderente que tem como suporte papel hipoalergênico permeável ao ar e vapor. É recoberto de massa adesiva acrílica de alta tolerância cutânea, e que não deixa resíduos. Devido à sua maleabilidade, adapta-se bem às áreas de contorno do corpo, tais como proeminências ósseas. Sua flexibilidade permite liberdade de movimentos.

INDICAÇÃO DE USO

As Fitas Adesivas Médicas Wiltex são indicada para ferimentos superficiais e para a fixação de curativos em pacientes.

INSTRUÇÃO DE USO**A- Aplicação da Fita**

1. Selecione o tipo e tamanho de fita correta para a aplicação.
2. Corte o pelo, se necessário.
3. Aplicar a fita com a pele completamente seca.
4. Minimize o toque do adesivo.
5. Aplique a fita sem tensão à pele limpa e seca.
6. Alise a fita adesiva no lugar com pressão suave, delicada. Evite aberturas e enrugamentos.

Em geral não circule completamente um membro com a fita.

7. Esfregue o local para conseguir boa adesão.

Colocação geral da fita

Aplique a fita sem tensão, gentilmente mas firmemente alisando a superfície para maximizar a adesão. A fita deve se estender pelo menos 1.25 cm além do curativo. A fita adesiva não deve ser puxada ou esticada quando aplicada. Se o inchaço ocorrer, afrouxar e re-fixar ou substituir a fita adesiva para aliviar a tensão.

B - Remoção da Fita

1. Soltar a borda da fita.
2. Estabilize a pele com um dedo. Remova a fita lentamente na direção do crescimento do pelo, mantendo perto da superfície da pele e puxando para trás sobre ela mesma.
3. Para fita que está fortemente aderida à pele ou cabelo, você pode considerar o uso de um removedor de adesivo médico ou umedecer para amolecer o adesivo ao longo da borda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura (mm)	Comprimento (m)	Comprimento (m)	Comprimento (m)
12	4,5	9	10
12,5	4,5	9	10
24	4,5	9	10
25	4,5	9	10
48	4,5	9	10
50	4,5	9	10
75	4,5	9	10
100	4,5	9	10

FOTO**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25101W	FITA MICROP. 12,5X10 C/CARR. WILTEX
25111W	FITA MICROP. 25X10 C/CARR. WILTEX
25121W	FITA MICROP. 50X10 C/CARR. WILTEX
25141W	FITA MICROP. 100X10 C/CARR. WILTEX
25221W	FITA MICROP. 50X4,5 C/CARR. WILTEX



INSTRUÇÃO DE USO

25241W	FITA MICROP.100X4,5 C/CARR.WILTEX

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

A Fita Adesiva Médica Wiltex é fornecida em carretel não estéril.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Remova cuidadosamente fita, elevando uma das pontas e retirando sem puxá-la para cima. Se houver pêlos no local de aplicação, a fita deve ser removida na direção de crescimento dos mesmos.

Produto de uso único.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259



LÂMINAS DE BISTURI AÇO CARBONO / AÇO INOXIDÁVEL

Cadastro / Registro M.S.:

80495510026

Modelos

10, 11, 12, 15, 15C, 20, 21, 22, 23 e 24.

Indicação de uso

Trata-se de um instrumento cirúrgico, fabricado em aço inoxidável ou carbono, esse instrumental possui diversos tipos de comprimento e formatos em sua extremidade para atender a vários procedimentos cirúrgicos, são utilizadas para cortar, raspar e /ou remover estruturas em procedimentos.

Especificação técnica

Composição: aço cirúrgico ou aço inoxidável

Estéril, descartável e de uso único

Atóxico e apirogênico

Validade 5 anos após data de esterilização

Modelos:

Tamanho	Medida	Figura
10	Comprimento: 43mm Altura: 8mm	
11	Comprimento: 43mm Altura: 6,5mm	
12	Comprimento: 36mm Altura: 10mm	
15	Comprimento: 40mm Altura: 4mm	
15C	Comprimento: 35mm Altura: 6,5mm	
20	Comprimento: 46mm Altura: 9mm	
21	Comprimento: 54mm Altura: 11mm	
22	Comprimento: 59mm Altura: 11,5mm	
23	Comprimento: 51mm Altura: 10mm	
24	Comprimento: 55mm Altura: 11mm	

*imagens meramente ilustrativas.

Apresentação

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária: Caixas de Papelão contendo 5000 unidades (10 caixas com 50 unidades cada)

Matriz

+55 45 3039 4242
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br | medixbrasil



Orientações de Uso

Retirar a lâmina com o auxílio de uma pinça estéril, de acordo com a técnica asséptica adequada;
Encaixar a lâmina no cabo de bisturi adequado; A Lâmina deverá ser manuseada por profissional especializado da área médica.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Esterilizado por Raio Gama

Atenção ao fazer o acoplamento da lâmina no cabo de bisturi a fim de evitar a possibilidade de cortes acidentais;

Não esterilizar o cabo de bisturi com a lâmina acoplada;

Não utilizar a lâmina sem o cabo de bisturi a fim de evitar riscos desnecessários

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
AÇO CARBONO	
7898652371417	17898652371414
7898652370762	17898652370769
7898652371424	17898652371421
7898652370779	17898652370776
7898652370526	17898652370523
7898652371431	17898652371438
7898652370786	17898652370783
7898652370519	17898652370516
7898652370793	17898652370790
7898652370809	17898652370806

Matriz

+55 45 3039 4242
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil





AÇO INOXIDÁVEL

7898652372346	17898652372343
7898652370489	17898652370486
7898652372353	17898652372350
7898652370496	17898652370493
7898652372360	17898652372367
7898652372377	17898652372374
7898652370502	17898652370509
7898652372384	17898652372381
7898652372391	17898652372398
7898652372407	17898652372404

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR N° 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR N° 34371


Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022

Imagens meramente ilustrativas:

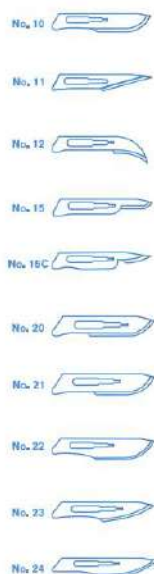

Matriz

- +55 45 3039 4242
- Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

- +55 47 3439 2114
- BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- medixbrasil.com.br | [medixbrasil](https://www.facebook.com/medixbrasil)





ITEM 79



Luva Plástica Estéril Descartável

A Luva Plástica Estéril da Medix Brasil oferece uma solução prática e segura para procedimentos que exigem barreira protetora com alto padrão de higiene. Fabricada em polietileno de alta densidade, é resistente, ambidestra e possui superfície rugosa que proporciona maior aderência no manuseio de instrumentos. Indicada para procedimentos rápidos e de baixa complexidade, é também amplamente utilizada como sobreluva, aumentando a durabilidade das luvas de procedimento. Sua embalagem individual (1 luva por polybag) facilita o uso pontual, enquanto a caixa com 100 unidades é ideal para alto consumo.

Cores:
Modelos:







Compre Online
Consumidor

Ambidestra

Varejo



Diferenciais



Ambidestra



Embalagem individual prática



Custo-benefício (sobreluva)

Ficha Técnica

Indicação

- Fabricada em 100% polietileno de alta densidade (HDPE)
- Estéril por Raio Gama
- Sem pó
- Superfície rugosa
- Ambidestra
- Descartável e de uso único
- Tamanho único (26.5 x 25.5cm±0.2cm)
- Validade 5 anos após a data de fabricação



Compre Online
Consumidor



Fio de Sutura Não Absorvível – Nylon

O Fio de Sutura Não Absorvível Nylon da Medix Brasil é um material cirúrgico esse...



Saco para Enjoo

O Saco para Enjoo da Medix Brasil é ideal para a coleta e contenção segura de vômito...



Envelope Autosselante para Esterilização

O Envelope Autosselante para Esterilização da Medix Brasil é indicado para acondic...

novidades por e-mail

Seu nome

Seu e-mail

Enviar



© 2026 Medix

[Canal de Ética](#)

[Política de Privacidade](#)

[Medix Online](#)

Ouvidoria

sac@medixbrasil.com.br
Sac: 0800 006 3036
Atendimento das 9h às 18h (dias úteis)

Matriz

10.268.780/0001-09
Rua Paraná, 1791
Cascavel, PR – 85812-010

Filial

10.268.780/0002-90
Rod. SC 417, 10535 (Barracão 1 a 4)
Garuva/SC – 89248-000



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.278.264/0001-21
Razão Social: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	08/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/10/2026
Receita Municipal	Validade:	10/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **63.278.264/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:29:56 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: PRoRLG5X459mbuLTm9iH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GENI DE SA SCHAFFER**

CPF/CNPJ: **818.653.509-82**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:30:17 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: zNkmLjKI8vC1xEubevEP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900332026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
38	CONJUNTO FILTRAGEM - CONJUNTO FILTRAGEM - CONJUNTO FILTRAGEM COMPONENTES: 1 FILTRO, MOTO-BOMBA 5 CV, CAPACIDADE VAZÃO: 13 M3/H, TENSÃO: TRIFÁSICO/220 V, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA EM CAMPANHA MARCA: VITAL GOLD MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	5,00	250,00
39	CONJUNTO FILTRAGEM - CONJUNTO FILTRAGEM - CONJUNTO FILTRAGEM COMPONENTES: 1 FILTRO, MOTO-BOMBA 5 CV, CAPACIDADE VAZÃO: 13 M3/H, TENSÃO: TRIFÁSICO/220 V, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA EM CAMPANHA MARCA: VITAL GOLD MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	5,00	250,00
56	ESPÉCULO USO MÉDICO - ESPÉCULO USO MÉDICO - ESPÉCULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: CRAL PLAST MODELO/VERSÃO: X	Unidade	1.000,00	1,61	1.610,00
80	LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA MISTA - LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO: ANATÔMICO, PÔ: SEM PÔ, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: INJEX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	400,00	0,71	284,00
81	LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA MISTA - LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO: ANATÔMICO, PÔ: SEM PÔ, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: INJEX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	400,00	0,71	284,00
82	LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: ANATÔMICO, PÔ: COM PÔ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 7,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: INJEX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	600,00	0,71	426,00
84	LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA - LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA MISTA - LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO: ANATÔMICO, PÔ: SEM PÔ, COR: C/ COR, TAMANHO: Nº 8,5, APRESENTAÇÃO: EM PAR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: BECARE MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	1,14	57,00
96	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: PVC, TAMANHO*: Nº 1, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
97	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 2, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
98	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 2,5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
99	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
100	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: PVC, TAMANHO*: Nº 4, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
101	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: PVC, TAMANHO*: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
102	TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO - TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL*: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO*: Nº 1,5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE*: REUTILIZÁVEL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	5,00	12,72	63,60
112	PÁ PARA DESFIBRILADOR - PÁ PARA DESFIBRILADOR - PÁ PARA DESFIBRILADOR TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO: INFANTIL, APRESENTAÇÃO*: PAR, COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL MARCA: DBI MODELO/VERSÃO: X	Par	5,00	238,16	1.190,80
113	PÁ PARA DESFIBRILADOR - PÁ PARA DESFIBRILADOR - PÁ PARA DESFIBRILADOR TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO: ADULTO, APRESENTAÇÃO*: PAR, COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL MARCA: DBI MODELO/VERSÃO: X	Par	10,00	238,16	2.381,60
135	SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE:	Unidade	20,00	0,50	10,00

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X				
138	SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	0,49	9,80
139	SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	0,49	9,80
140	SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	0,49	9,80
145	SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	1,15	57,50
146	SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 18, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	1,19	59,50
147	SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 20, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	1,34	67,00
148	SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE,	Unidade	50,00	1,37	68,50

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 22, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X				
150	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL APLICAÇÃO: P/ TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO: 8 FR, TIPO Sonda: Sonda GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, VÁLVULA SUÇÃO: VÁLVULA SUÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	0,59	29,50
155	SONDA TRATO URINÁRIO - Sonda TRATO URINÁRIO - Sonda TRATO URINÁRIO MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 3 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	2,16	43,20
156	SONDA TRATO URINÁRIO - Sonda TRATO URINÁRIO - Sonda TRATO URINÁRIO MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	2,16	43,20
164	SONDA TRATO DIGESTIVO - Sonda TRATO DIGESTIVO - Sonda TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	2,16	108,00
165	SONDA TRATO DIGESTIVO - Sonda TRATO DIGESTIVO - Sonda TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	2,16	108,00

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
166	SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO - SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 8, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	50,00	2,16	108,00
167	SUPOORTE - SUPORTE - SUPORTE TIPO: DE BANCADA, ARTICULADO E REGULÁVEL PARA MANUTENÇÃO, FORMATO: RETANGULAR COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, MATERIAL: METAL (BASE) E ALUMÍNIO OU AÇO (BRAÇOS), APLICAÇÃO: IMOBILIZAÇÃO, NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DE, ALTURA: 300 MM, LARGURA: 400 MM, COMPRIMENTO: 600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, ACABAMENTO: RESISTENTE A ÓLEO, SOLVENTES E PRODUTOS QUÍMICOS D MARCA: DESCARBOX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	20,76	415,20
168	SUPOORTE - SUPORTE - SUPORTE TIPO: DE BANCADA, ARTICULADO E REGULÁVEL PARA MANUTENÇÃO, FORMATO: RETANGULAR COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, MATERIAL: METAL (BASE) E ALUMÍNIO OU AÇO (BRAÇOS), APLICAÇÃO: IMOBILIZAÇÃO, NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DE, ALTURA: 300 MM, LARGURA: 400 MM, COMPRIMENTO: 600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, ACABAMENTO: RESISTENTE A ÓLEO, SOLVENTES E PRODUTOS QUÍMICOS D MARCA: DESCARBOX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	20,00	17,88	357,60
				Valor total da proposta:	8.683,20

O valor total dessa proposta é de R\$8.683,20 (oito mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos)

Dados Comerciais:

Razão Social: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 63.278.264/0001-21
Rua Odílio Antônio Link, 1899 - Sala - Loteamento
Jaboticabal - São José do Cedro - SC - CEP: 89.930-000
E-mail departamento comercial e de licitações: licitacoes@dsmed.med.br
Telefone/Whatsapp: 49 99142-0099

Dados Bancários:

Banco: Cresol Fronteiras ou Confederações (133)
Agência: 1658 Conta: 104.807-4
Chave PIX: 63278264000121

Observações:

Validade da proposta: 90 Dias
O prazo para entrega será conforme o edital

Declaramos:

1. Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Que não possuímos fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
4. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, contendo todos os tributos, encargos e custos de logística ou outro qualquer, ofertando valor final ao município sem qualquer acréscimo.
6. Que estamos em conformidade com todas as exigências do edital e da legislação aplicável.
7. (X) Declara que se enquadra como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte.
() Não se enquadra.
8. Cumprimos todas as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados, conforme legislação aplicável.
9. Que não mantemos qualquer vínculo com servidor público ou dirigente do órgão contratante que configure conflito de interesses.
10. Que estamos cientes e concordamos com todas as condições contidas no edital e seus anexos.
11. Assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

São José do Cedro - SC, 15 de Junho de 2026

Representante Legal

Geni de Sá Schfer

RG: 6045825475 SSP/RS

CPF: 818.653.509-82



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.id.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 15/06/2026 08:52:29 é(são):

Nome: **GENI DE SA SCHAFER**

CPF: 818.653.509-82

Data: 15/06/2026 08:52:29

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900332026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
59	FIO DE SUTURA AGULHADO - FIO DE SUTURA AGULHADO - FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: TECHNOFIO MODELO/VERSÃO: X	Unidade	8,00	28,80	230,40
61	FIO DE SUTURA AGULHADO - FIO DE SUTURA AGULHADO - FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA INCOLOR, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: TECHNOFIO MODELO/VERSÃO: X	Unidade	15,00	28,80	432,00
Valor total da proposta:					662,40

O valor total dessa proposta é de R\$662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

Dados Comerciais:

Razão Social: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 63.278.264/0001-21
Rua Odílio Antônio Link, 1899 - Sala - Loteamento
Jaboticabal - São José do Cedro - SC - CEP: 89.930-000
E-mail departamento comercial e de licitações: licitacoes@dsmed.med.br
Telefone/Whatsapp: 49 99142-0099

Dados Bancários:

Banco: Cresol Fronteiras ou Confederações (133)
Agência: 1658 Conta: 104.807-4
Chave PIX: 63278264000121

Observações:

Validade da proposta: 90 Dias
O prazo para entrega será conforme o edital

Declaramos:

1. Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Que não possuímos fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
4. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, contendo todos os tributos, encargos e custos de logística ou outro qualquer, ofertando valor final ao município sem qualquer acréscimo.
6. Que estamos em conformidade com todas as exigências do edital e da legislação aplicável.
7. (X) Declara que se enquadra como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte.
() Não se enquadra.
8. Cumprimos todas as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados, conforme legislação aplicável.
9. Que não mantemos qualquer vínculo com servidor público ou dirigente do órgão contratante que configure conflito de interesses.
10. Que estamos cientes e concordamos com todas as condições contidas no edital e seus anexos.
11. Assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

São José do Cedro - SC, 16 de Junho de 2026

Representante Legal

Geni de Sá Schfer

RG: 6045825475 SSP/RS

CPF: 818.653.509-82



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.id.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/06/2026 10:11:52 é(são):

Nome: **GENI DE SA SCHAFER**

CPF: 818.653.509-82

Data: 16/06/2026 10:11:52

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900332026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
49	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL MATERIAL: PVC SEM DEHP, C/ CÔR, TIPO: P/ BOMBA INFUSÃO, SEM SEGMENTO DE SILICONE, 2 VIAS, CÂMARA GOTEJAMENTO: MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL: PINÇA ROLETE, CONECTOR DIETA: PONTA EM CRUZ, CONECTOR VIA ADICIONAL: PONTA PERFURANTE, CONECTOR PACIENTE: COMPATÍVEL, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO: ACIMA DE 181 CM, ADICIONAL: C/ CLAMP, COMPATIBILIDADE: C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM: INDIVIDUAL MARCA: INJEX MODELO/VERSÃO: X	Unidade	3.000,00	0,82	2.460,00
Valor total da proposta:					2.460,00

O valor total dessa proposta é de R\$2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais)

Dados Comerciais:

Razão Social: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 63.278.264/0001-21
Rua Odílio Antônio Link, 1899 - Sala - Loteamento
Jaboticabal - São José do Cedro - SC - CEP: 89.930-000
E-mail departamento comercial e de licitações: licitacoes@dsmed.med.br
Telefone/Whatsapp: 49 99142-0099

Dados Bancários:

Banco: Cresol Fronteiras ou Confederações (133)
Agência: 1658 Conta: 104.807-4
Chave PIX: 63278264000121

Observações:

Validade da proposta: 90 Dias
O prazo para entrega será conforme o edital

Declaramos:

1. Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Que não possuímos fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
4. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, contendo todos os tributos, encargos e custos de logística ou outro qualquer, ofertando valor final ao município sem qualquer acréscimo.
6. Que estamos em conformidade com todas as exigências do edital e da legislação aplicável.
7. (X) Declara que se enquadra como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte.
() Não se enquadra.
8. Cumprimos todas as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados, conforme legislação aplicável.
9. Que não mantemos qualquer vínculo com servidor público ou dirigente do órgão contratante que configure conflito de interesses.
10. Que estamos cientes e concordamos com todas as condições contidas no edital e seus anexos.
11. Assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

São José do Cedro - SC, 16 de Junho de 2026

Representante Legal

Geni de Sá Schfer

RG: 6045825475 SSP/RS

CPF: 818.653.509-82



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.id.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/06/2026 14:21:35 é(são):

Nome: **GENI DE SA SCHAFER**

CPF: 818.653.509-82

Data: 16/06/2026 14:21:35

Ficha Técnica

Luva Cirúrgica Estéril sem pó BC 40

Luva cirúrgica de látex natural, anatômica, estéril, sem pó, BC 40.

Anvisa nº 80808480005 – CA 35618



Introdução:

A BeCare valoriza os profissionais de saúde e entende que os cuidados assistenciais envolvem, não só ações biológicas, compreendemos a assistência em saúde como prática humanizada. Composto uma linha de cuidados assistenciais, desenvolvemos produtos que atendam a demanda de nossos clientes, de modo a construir um espaço concreto nas instituições de saúde. Pensando na segurança, qualidade e praticidade de seus clientes, desenvolvemos uma linha de luvas de látex, que funcionam como barreira, atuando no controle da disseminação de microrganismos.

Aplicação:

Instituições de saúde que adotam o uso de luvas como parte da rotina assistencial, seja para procedimentos invasivos ou não invasivos. As Luvas Cirúrgicas Estéreis sem pó BC 40, são destinadas à profissionais que possuam predisposição a reações alérgicas oriundas de produtos químicos ou ao pó lubrificante, normalmente utilizado nas luvas comuns e para procedimentos cirúrgicos ou manipulações que exijam esterilidade, assepsia e ausência de pó lubrificante.

Benefícios:

- As Luvas Cirúrgicas Estéreis sem pó BC 40 possuem controle de qualidade extremamente rigoroso;

- Ótima sensibilidade Tátil e Proteção;
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico;
- Formato anatômico;
- Disponível em vários tamanhos;
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho;
- Certificado de Conformidade Inmetro;

Orientações de Uso:

Desenvolvida para manipulação em procedimentos estéreis e/ou invasivos.

Características do Produto:

As Luvas Cirúrgicas Estéreis sem pó BC 40, são desenvolvidas em látex natural, possuem comprimento de 290 mm e uma espessura média de 0.22 mm, seu punho possui bainha enrolada que permite melhor calçamento e retirada da luva. Produto esterilizado por radiação Gama. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Acondicionado em caixas com 50 unidades e posteriormente em caixa master com 400 pares.

Instruções de uso:

1. Retirar adornos - anéis, relógio, pulseiras;
2. Escolher a luva compatível ao tamanho da sua mão;
3. Após, realizar a lavagem correta das mãos;
4. Abra a embalagem externa das luvas, ou peça para alguém abrir e expor o embrulho para você ou deixa-lo sobre superfície plana, sem contaminar o pacote;
5. Abra o embrulho em uma superfície limpa e em uma altura confortável para sua manipulação, em seguida, tocando apenas na face externa do embrulho, abra ambas as dobras para os lados, expondo as luvas;
6. As luvas estão dispostas corretamente a sua frente, onde a luva da mão direita está a sua direita e a luva da mão esquerda a sua esquerda;
7. Com sua mão não dominante, retire a primeira luva do pacote, pegando-a pela dobra do punho. Levante – a longe do corpo, manter a palma da mão voltada para cima, neste momento, introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os dedos internamente e com cuidado para não contaminar a parte estéril;
8. Não se preocupe se os dedos ficarem mal posicionados, continue o procedimento, você poderá ajustá-los quando estiver com as luvas colocadas em ambas as mãos;
9. Retirar a segunda luva do pacote colocando três dedos da primeira mão, já enluvada, por dentro da dobra do punho da segunda luva. Levante - a longe do corpo, com a palma da mão voltada para cima e introduza os dedos da segunda mão;
10. Ajustar os dedos externamente de ambas as mãos já enluvadas;
11. Se ocorrer contaminação em qualquer momento, descartar as luvas e começar de novo com luvas novas;
12. Mantenha as mãos voltadas para cima, sem encostar-se em nada;

13. Após o uso, retire a luva de uma das mãos puxando-a externamente sobre a mão, virando-a pelo avesso. Com a outra mão enluvada, segure a luva que foi retirada, e pela parte interna da luva que ainda está na mão, puxe-a externamente, virando pelo avesso.

Composição:

Látex 100% natural.

Informações Adicionais:

- Produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Em casos de irritação, descontinuar o uso e procure orientação médica;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Uso único;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;
- Estéril
- Apirogênico;
- Atóxico.

Tamanhos disponíveis:

Comercializada nos tamanhos

- ✓ 6.5
- ✓ 7.0
- ✓ 7.5
- ✓ 8.0
- ✓ 8.5



V. 09/2020

Hospitalar
Farmacêutico
Odontológico
Diabetes
Diagnóstico

2798

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

NOSSA QUALIDADE, NOSSO COMPROMISSO

Catálogo

Linha de Produtos



“No ano de 1984 em uma viagem aos Estados Unidos nosso fundador Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues iniciou um estudo de pesquisa de mercado e em 1988 a INJEX foi fundada.

Instalada na cidade de Ourinhos nossa empresa é genuinamente brasileira, está presente em todo mercado nacional e nas principais capitais da América Latina por meio de seus representantes, que atuam dinamicamente na pré e pós-venda assegurando a rapidez na entrega de seus produtos, os quais possuem qualidade assegurada pelas normas de Boas Práticas de Fabricação, NBR ISO 9001 e NBR ISO 13485.

Com uma infraestrutura moderna e segura a INJEX oferece aos seus funcionários um excelente ambiente de trabalho, com treinamentos específicos direcionados a todas as áreas (Cursos de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Boas Práticas de Fabricação, Capacitação para Operadores de Máquinas, etc.), além de uma ampla área de lazer.

Visando contribuir para a melhoria no setor de atendimento da empresa, assim como no aperfeiçoamento das áreas que possibilitem esta transformação, temos o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.

Contando com o que há de mais moderno em tecnologia, processos produtivos dinâmicos, modernas técnicas gerenciais, a INJEX Indústrias Cirúrgicas tem como missão melhorar cada vez mais a qualidade de seus produtos, minimizando os custos, partindo da premissa de que “o sucesso de hoje não garante o de amanhã”.

www.injex.com.br
injex@injex.com.br

**LINHAS
HOSPITALAR**

Seringa Hipodérmica.....	05
Tampa Protetora Luer - Injex Cap	05
Seringa 1 ml Tuberculina	06
Seringa com Dispositivo de Segurança (Safety)	06
Seringa Dosadora Oral - Linha Hospitalar	07
Agulha para Aspiração	07
Agulha Hipodérmica	08
Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança (Safety).....	08
Cateter Intravenoso com Dispositivo de Segurança Injex Cath.....	09
Cateter Intravenoso Injex Cath.....	09
Luva Cirúrgica.....	10
Luva de Procedimento.....	11
Torneira de Três Vias	12
Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções	12
Equipo de Infusão Gravitacional.....	13
Equipo Enteral.....	13
Scalp com Dispositivo de Segurança.....	14
Scalp Intravenoso Periférico Injex	14
Embalagem para Esterilização	15
Eletrodo ECG Descartável.....	15
Esparadrapo Impermeável Injex	16
Máscara Tripla Camada.....	17
Touca Descartável	17
Sonda Foley Injex.....	18
Bolsa Coletora de Urina.....	18

FARMACÊUTICA

Seringa Dosadora Oral - Linha Farmacêutica	19
Adaptador Farmacêutico	20

ODONTOLÓGICA

Agulha Gengival.....	21
Agulha de Irrigação	21

DIABETES

Glicosímetro Injex Sens II Plus	23
Tira de Teste de Glicose no Sangue Injex Sens.....	24
Lancetador.....	24
Lanceta Hipodérmica	25
Lanceta com Dispositivo de Segurança	25
Agulha para Caneta de Aplicação de Insulina.....	26
Seringa 1ml para Insulina U-100 Com ou Sem Agulha Acoplada	26
Seringa para Insulina U-100 (0,5ml e 1ml Com Agulha Fixa Stilly Line).....	27

DIAGNÓSTICO

Adaptador para Agulha de Coleta Múltipla.....	28
Scalp para Coleta Injex.....	28
Agulha de Coleta Múltipla	29
Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo.....	30

ATENDIMENTO

Representantes Comerciais	31
Representantes Comerciais	32



Linha de Seringas- Injex

Seringa Hipodérmica

Estéreis, atóxicas e apirogênicas. Cilindro altamente transparente permitindo total visualização do fluido aspirado.

Êmbolo látex free, graduação com alto grau de precisão.

Embaladas individualmente. Esterilizadas a Óxido de Etileno, com validade de 5 anos em embalagem intacta. Todas, com exceção das seringas de 1 ml e 60 ml, possuem o BREAK OFF SYSTEM, sistema de quebra da haste que inutiliza a seringa.

Tamanhos: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip e 60 ml Sonda.


Jeringa Hipodérmica

Esteriles, atoxicas y apirogenicas. Cilindro altamente transparente, permitiendo una total visualización del fluido aspirado.

Êmbolo de látex libre, graduación con alto grado de precisión.

Empaquetado individualmente. Esterilizadas a Oxido de Etileno, con validez de 5 años en embalaje intacta. Todos, a excepciones de las jeringas de 1 ml y 60 ml, tienen el BREAK OFF SYSTEM, sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa.

Tamaños: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip y 60 ml Boquilla Sonda.

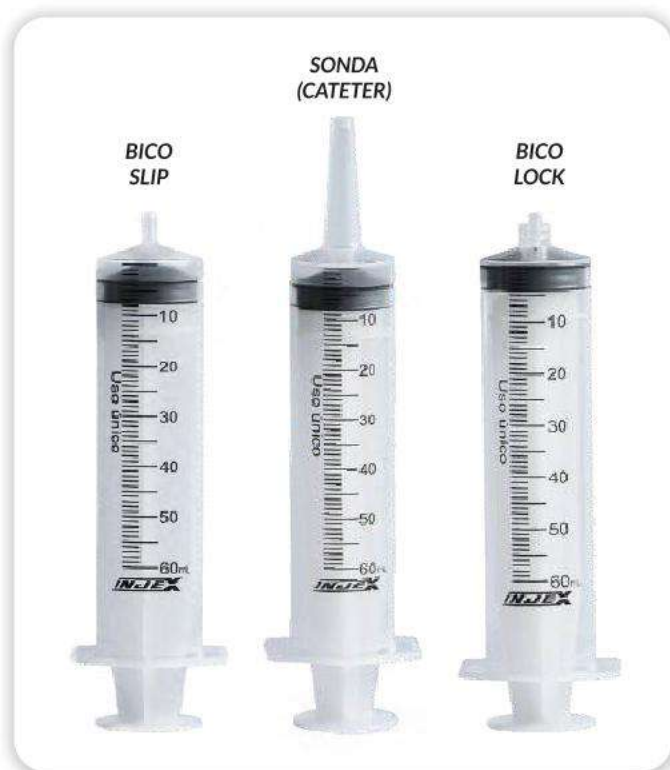

Break off System

Sistema de quebra de haste que inutiliza a seringa.

Sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa



Tampa Protetora Luer - Injex Cap

Projetada para bicos slip ou lock, protege contra a entrada de possíveis contaminações. Apresenta-se estéril atendendo os seguimentos da área da saúde.

Utilizada após preparo ou envase de medicamentos para a prevenção de possíveis contaminações durante o armazenamento e transporte interno em hospitais, consultórios, farmácias de manipulação e indústrias farmacêuticas e veterinárias.

Tapa Protectora Luer - Injex Cap

Diseñado para boquillas de deslizamiento o bloqueo, protege contra posibles contaminaciones. Es estéril, cumple con los requisitos del área de salud. Se utiliza después de la preparación o el envasado de medicamentos para evitar la posible contaminación durante el almacenamiento y el transporte interno en hospitales, clínicas, farmacias de manipulación y las industrias farmacéutica y veterinaria.



Tampas Protetoras

Seringa 1 ml Tuberculina

A seringa de 1 ml Tuberculina é ideal para injeções em geral, injeção de contrastes, preparo de diluições e fracionamento de medicamentos, vem com escala de graduação precisa para o controle ideal de quantidade, sendo indicada também para aplicação de vacinas. São embaladas individualmente em embalagem selada que garante a esterilidade até o momento do uso.

A seringa de 1 ml tuberculina é um artigo médico hospitalar indicado para aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos e soluções, também pode ser utilizada para administrar medicamentos via parenteral

Modelos: Luer Slip e Luer Lock

Jeringa 1 ml Tuberculina

La jeringa de tuberculina de 1 ml es ideal para inyecciones generales, inyección de contraste, preparación de diluciones y fraccionamiento de fármacos, viene con una escala de graduación precisa para un control óptimo de la cantidad, y también está indicado para la aplicación de vacunas. Se envasan individualmente en un paquete sellado que garantiza la esterilidad hasta el momento de su uso.

La jeringa de tuberculina de 1 ml es un artículo médico hospitalario apto para aplicar, inyectar, irrigar, aspirar y extraer líquidos y soluciones, también puede utilizarse para administrar fármacos por vía parenteral.

Modelo: Luer Slip e Luer Lock



Seringa 1 ml
Tuberculina

Seringa com Dispositivo de Segurança (Safety)

Indicada para aplicar, injetar, irrigar, aspirar, extrair fluidos e soluções parenterais.

Seringa com dispositivo de segurança para garantir o descarte seguro e sua inutilização. Segurança para o profissional da saúde e para o paciente. Apresenta protetor articulado para alojamento da agulha após o uso e quebra da haste para inutilização do produto. Segurança para o descarte seguro de perfurocortantes.

Segue a norma Regulamentadora – NR32 para segurança no trabalho em serviços de saúde.

Seringas nos tamanhos: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock.

Jeringa con Dispositivo de Seguridad (Safety)

Indicado para la aplicación, la inyección, irrigación, aspire fluidos y soluciones parenterales.

Jeringa con dispositivo de seguridad para asegurar la eliminación segura y su destrucción. Seguridad para el profesional en el área de la salud y el paciente. Presenta guardia articulado para el alojamiento de la aguja después de su uso y rotula el varilla a la destrucción del producto.

Seguridad para la eliminación de objetos punzocortantes. Sigue la normativa reguladora – NR32 para la seguridad en los servicios de salud.

Jeringas nos tamaños: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml 60ml, Luer Lock.



Tamanhos: 1, 3, 5, 10, 20 e 60ml,
Luer Lock



Seringa Dosadora Oral – Linha Hospitalar

A Seringa Dosadora Oral é indicada para dosagem exata dos medicamentos, proporcionando mais doses por frascos, auxilia na preparação e administração de medicamentos, proporcionando maior comodidade e segurança para o paciente. Apresenta alto grau de precisão em sua graduação. Disponível na cor azul. Confeccionado em plástico atóxico que não interage com o medicamento. Apresenta tampa que evita a contaminação. Acompanha adaptador universal confeccionado em borracha termoplástica atóxica, inerte e flexível adaptando-se aos bocais de diversos diâmetros. Embalagem a granel. Graduações: 3 ml, 5 ml e 10 ml.

Jeringa de Dosificación Oral - Línea Hospitalaria

La Jeringa de Dosificación Oral está indicada para la dosificación exacta de la medicación, proporcionando más dosis por vial, ayuda a la preparación y administración de los medicamentos, proporcionando una mayor comodidad y seguridad para el paciente. Presenta un alto grado de precisión en su graduación. Disponible en color azul. Hecho en plástico no tóxico, que no interactúa con los fármacos. Cuenta con cubierta que evita la contaminación. Incluye adaptador universal hecho de un caucho termoplástico no tóxico que es inerte y flexible, adaptándose a las diversas boquillas de diámetros. Embalaje a granel. Graduaciones: 3 ml, 5 ml e 10 ml.

A Seringa Dosadora Oral apresenta bico arredondado que não fere a boca, e anel de retenção que impede o desprendimento livre do pistão.

La jeringa dosificadora oral presenta una boquilla redondeada que no hiere la boca, y anillo de retención que impide el desprendimiento libre del piston.



Adaptador
Universal



Agulha para Aspiração

As agulhas de aspiração são indicadas para os procedimentos de preparo de medicamentos evitando o uso da agulha que será utilizada para realizar a aplicação. A agulha de aspiração foi projetada para ser utilizada com seringas hipodérmicas através de uma conexão luer slip ou lock. A agulha não apresenta o bisel trifacetado e sim um bisel simples com corte diferenciado que evita a retirada de "fragmentos de borracha" das tampas dos frascos ampolas, típico quando da utilização de agulhas hipodérmicas com bisel trifacetado. Esterilizadas a Óxido de Etileno, em embalagens individuais, validade de 5 anos em embalagem intacta. Disponíveis em vários calibres para atender aos diferentes tipos de procedimentos.

Disponível nos calibres: 25x1,2 e outros sob consulta.

Agujas de Aspiración

Las agujas de aspiración están indicadas para los procedimientos de preparación de medicamentos, evitando el uso de la aguja que será utilizada para la aplicación. La aguja de aspiración fue diseñada para ser utilizada con jeringas hipodérmicas mediante una conexión luer slip o luer lock. La aguja no presenta bisel trifacético, sino un bisel simple con un corte diferenciado que evita la extracción de "fragmentos de goma" de los tapones de los frascos ampolla, lo cual es típico al utilizar agujas hipodérmicas con bisel trifacético. Esterilizadas con óxido de etileno, en envases individuales, con una validez de 5 años en empaque intacto. Disponibles en varios calibres para atender los diferentes tipos de procedimientos.

Disponible en los calibres: 25x1,2 y otros bajo consulta.



INJEX

Agulha Hipodérmica

Agulhas Hipodérmicas, estéreis, atóxicas, apirógenas, apresentam canhão que permitem a perfeita conexão na seringa. Padrão universal de cores para identificação dos calibres, com cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, siliconizado para perfeito e suave deslize.

Esterilizadas a Óxido de Etileno, em embalagens individuais, validade de 5 anos em embalagem intacta. Disponíveis em vários calibres para atender aos diferentes tipos de procedimentos.

Disponível nos calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 e outros sob consulta.

Aguja Hipodérmica

Las agujas Hipodérmicas, estéril, no tóxico, no pirógenos, presenta um cañon que permite la perfecta conexión con la jeringa. Colores estándares universales para la identificación de los indicadores, con cânula de acero inoxidable, bisel con três facetas, siliconado para el deslizamiento perfecto y suave.

Esterilizadas com Oxido de Etileno, en paquetes individuales, con 5 años de validez con el embalaje intacto. Disponible en diferentes calibres con el fin de asistir a los diferentes tipos de procedimientos.

Disponibles en calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 y otros bajo demanda.



Agulha Hipodérmica
Diversos Calibres

Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança (Safety)

Agulhas com Dispositivo de Segurança minimizam os acidentes com perfurocortantes. Treinamento rápido e prático, sem mudança de rotina do profissional, revolucionando o descarte de agulhas, proporcionando segurança no descarte e na sua inutilização. Adaptável nas seringas Luer Lock, Luer Slip e de fácil manuseio.

Disponível nos calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 e outros sob consulta.

Aguja Hipodérmica con Dispositivo de Seguridad (Safety)

Agujas con Dispositivo de Seguridad minimiza los accidentes con materiales punzocortantes. Formación rápida y práctica, sin ningún cambio en la rutina de trabajo, revolucionando la eliminación de las agujas, proporcionando seguridad en la eliminación e la destrucción. Se adapta a jeringas Luer Lock y Luer Slip y de facil manejo.

Disponibles en calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 y otros bajo demanda.



Agulha Hipodérmica com
Dispositivo de Segurança

Cateter Intravenoso com Dispositivo de Segurança Injex Cath

Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança. Indicado na terapia intravenosa para infusões de média duração.

Dispositivo confeccionado em Poliuretano, radiopaco, com conector Luer Lock, de uso único, estéril, embalado unitariamente, apresentando calibres:

14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G, e 24 G.

O cateter Injex Cath possibilita uma punção suave com mínimo trauma, fácil visualização do sangue. Seu sistema de segurança impede a recolocação do bisel no cateter quando acionado, reduzindo significativamente o risco de infecção e proporcionando um descarte seguro e eficaz.

Catéter Intravenoso con Dispositivo de Seguridad - Injex Cath

Cateter intravenoso periférico con dispositivo de seguridad. Indicado en el tratamiento intravenoso para infusiones duración media.

Dispositivo hecha de poliuretano, radiopaco, con conector Luer Lock, de un solo uso; estéril, empaquetados unitariamente, presentación de calibres:

14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G, e 24 G.

El cateter Injex Cath permite una punzada suave trauma mínimo y con fácil verificación de la sangre. Su sistema de seguridad impide la recolocación del bisel en el catéter cuando accionado, reduciendo significativamente el riesgo de infección, y proporcionar una eliminación segura y eficaz.



Cateter com Dispositivo de Segurança

Cateter Intravenoso Injex Cath

Cateter intravenoso periférico, indicado na terapia intravenosa para infusões de curta duração.

Dispositivo confeccionado em teflon, radiopaco, com conector Luer Lock, de uso único, estéril, embalado unitariamente, apresentando calibres:

14G, 16G, 18G, 20G, 22G e 24G.

O material do cateter (teflon) se adapta as paredes internas das veias causando menos dor e desconforto ao paciente. Por ser indicado para infusões de curto prazo, é recomendado que o cateter seja substituído a cada 72 horas.

Catéter Intravenoso Injex Cath

Catéter intravenoso periférico, indicado en terapia intravenosa para infusiones a corto plazo.

Dispositivo fabricado en teflón, radiopaco, con conector Luer Lock, de un solo uso, estéril, envasado individualmente, con calibres:

14G, 16G, 18G, 20G, 22G y 24G.

El material del catéter (teflón) se adapta a las paredes internas de las venas causando menos dolor e incomodidad al paciente. Como está indicado para infusiones de corta duración, se recomienda cambiar el catéter cada 72 horas.



Cateter Intravenoso

A Luva Cirúrgica – Injeté indicada para a proteção das mãos de profissionais da saúde em geral (médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares, etc.) durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas e/ou situações que apresentem riscos de contaminação decorrentes à exposição ao sangue, para proteção das mãos do cirurgião e de seus assistentes, e/ou em outros procedimentos onde sejam recomendadas a proteção com luvas cirúrgicas.

Tamanhos disponíveis: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 e 8,5

El Guante Quirúrgico – Injex está indicado para la protección de las manos de los profesionales de la salud en general (médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, auxiliares, etc.) durante procedimientos quirúrgicos en hospitales, consultorios y clínicas, y/o en situaciones que presenten riesgos de contaminación por exposición a la sangre, para proteger las manos del cirujano y de sus asistentes, y/o en otros procedimientos donde se recomienda el uso de guantes quirúrgicos.

Tamaños disponibles: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 y 8,5.



Luva de Procedimento

Disponível em látex levemente talcada. Não estéril. As luvas de procedimentos Injex estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluidos corporais, membranas, mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos.

Para procedimentos não cirúrgicos, uso único, individual e não deve ser reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras.

Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível

Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).

Tamanhos disponíveis: PP, P, M, G

Guante de Procedimiento

Disponible en látex ligeramente talcado. No estéril. Las guantes de procedimientos Injex se clasifican para la protección profesional de la salud en los procedimientos no invasivos. Son adecuados para la protección del profesional durante procedimientos médicos y de enfermería. Usar guantes siempre que exista una posibilidad de contacto con sangre, fluidos corporales, membranas, mucosas, artículos sucios o procedimientos no invasivos.


Para procedimientos no quirúrgicos, uso único, individual y por procedimiento, no debe ser reprocesado. Anatómica, no estériles y ambidiestro.

Composición: Látex natural, ligeramente adherida con polvo absorbible

Caja dispensadora con 100 unidades cada una (50 pares).

Tamaños disponibles: PP, P, M, G

Látex de Borracha Natural

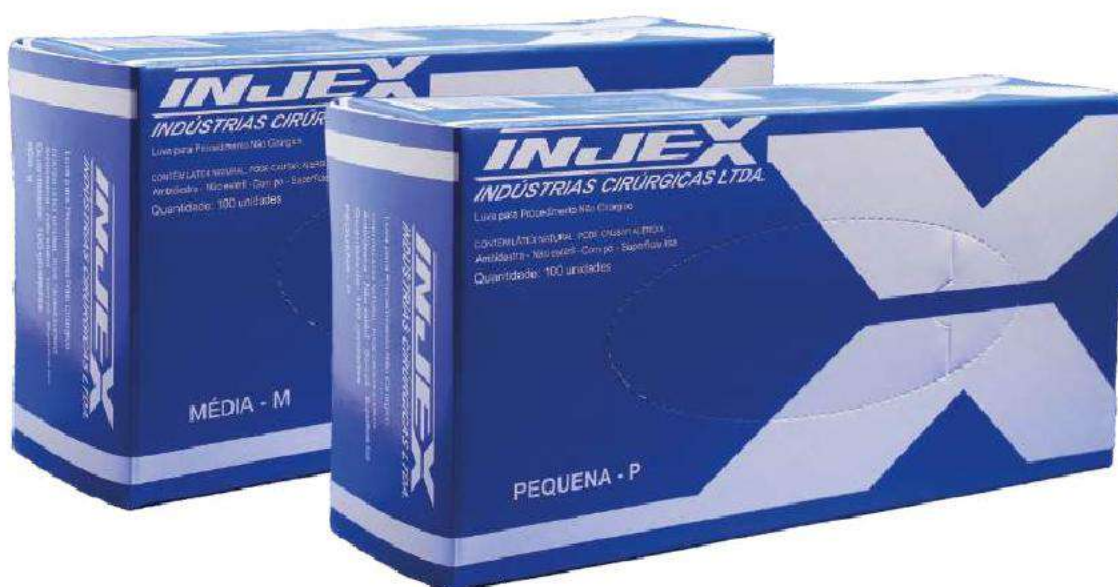

Luva de Procedimento



Torneira de Três Vias

Torneira de Três Vias indicada no auxílio do acesso venoso de média e longa permanência, para administração de soluções e/ou medicamentos. Descartável, atóxica, apirogênica e esterilizada a Óxido de Etileno, com conexão universal, na apresentação Luer Lock ou Luer Slip.

Manípulo com rotação de 360 graus e com indicação de fluxo, corpo translúcido em policarbonato.

Embaladas individualmente, com validade de 5 anos com a embalagem intacta.

Llave de Tres Vías

Llave de Tres Vías, indicada como ayuda de un acceso venoso de permanência a mediano y largo tiempo, y para la administración de soluciones y o medicamentos. Desechable, no tóxico, no pirogénico, esterilizado por Oxido de Etileno, con conexión universal, con presentaciones en Luer Lock ou Luer Slip.

Con un manípulo con rotación de 360 grados y la indicación de flujo, cuerpo translúcido de policarbonato.

Empaquetado individualmente, com 5 años de validez com el embalaje intacto.



Torneira de 3 Vias

Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções

É indicado para possibilitar a administração de várias drogas ao mesmo tempo, através de sistemas de acesso intravenoso parenteral em procedimentos que exigem essa condição. Esse dispositivo facilita o trabalho do profissional de saúde assim como, possibilita uma maior qualidade de atendimento ao paciente pois com apenas um acesso venoso torna-se possível administrar vários fluidos ao mesmo tempo.

Infusor para Multiples Soluciones Simultáneas

Se tiene la intención de facilitar la administración de diversos medicamentos al mismo tiempo, através de sistemas de acceso intravenosa parenteral en procedimientos que requieren esta condición. Este dispositivo facilita el trabajo profesional de la salud, así como proporciona una mayor calidad de la atención al paciente, porque sólo con um acceso venoso se hace posible administrar varios fluidos al mismo tiempo.



Infusor de 2 Vias

Equipo de Infusão Gravitacional

O Equipamento de Infusão Gravitacional é indicado para administração de soluções parenterais. Trata-se de um produto destinado aos profissionais da área médico hospitalar devidamente treinados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso. Esterilizados à Óxido de Etileno em embalagens individuais, com a validade de 5 anos com a embalagem intacta.

Disponíveis em diversos modelos para atender as diversas necessidades de procedimentos, com 1,5 metros de extensão.

Equipo de Infusion Gravitacional

El Equipo de Infusion Gravitacional está indicado para la administración de soluciones parenterales. Es un producto diseñado para los profesionales del área hospitalaria médica que han sido debidamente capacitados y familiarizados con las técnicas y los procedimientos que implican su uso. Esterilizado a Óxido de Etileno en paquetes individuales, 5 años de validez con el paquete intacto. Disponible en diferentes diseños con el fin de satisfacer las diversas necesidades de los procedimientos, 1,5 metros de largo.



Equipo de Infusão Gravitacional

Equipo Enteral


O Equipamento para Nutrição Enteral - Injex é indicado para a administração de soluções enterais, realizando a ligação entre a sonda de alimentação enteral, ligada ao paciente, ao recipiente de solução, frasco ou bolsa, que contém o alimento a ser administrado.

O produto se restringe ao uso médico hospitalar devendo ser usado por profissionais da área médica.

Equipo Enteral

El Equipo para Nutrición Enteral - Injex está indicado para la administración de soluciones enterales, realizando la conexión entre la sonda de alimentación enteral, conectada al paciente, y el recipiente de la solución, frasco o bolsa, que contiene el alimento a ser administrado.

El producto está destinado exclusivamente al uso médico-hospitalario y debe ser utilizado por profesionales del área de la salud.

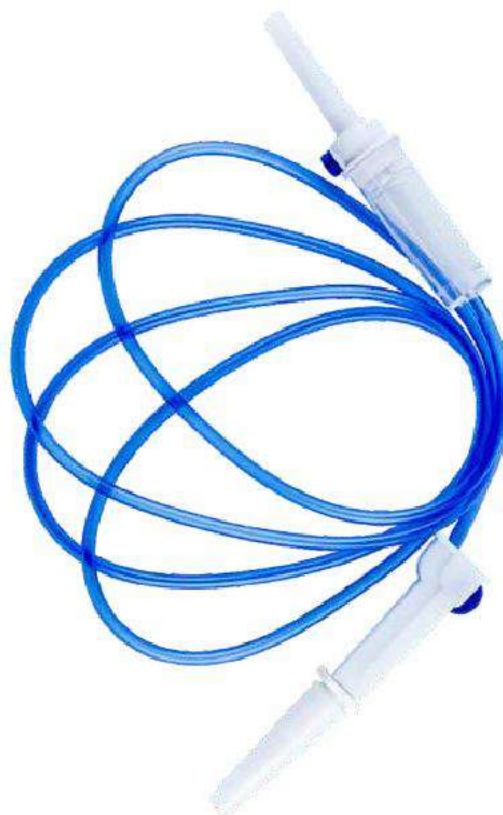

Equipo Enteral



Scalp com Dispositivo de Segurança

O Scalp com Dispositivo de Segurança Injex Safety é utilizado em procedimentos que necessitam de acesso venoso para administração de medicamentos ou soluções parenterais e coleta sanguínea convencional.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp com Dispositivo de Seguridad

El Scalp con dispositivo de seguridad INJEX se utiliza en los procedimientos que requieren acceso venoso para la administración de medicamentos y soluciones parenterales y recolección de sangre convencional.

Conserva sus características y funcionalidad para el uso de una sola vez y deben ser desechados después de su uso, el producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.

Scalp Intravenoso Periférico Injex

O Scalp Intravenoso Periférico Injex é utilizado em procedimentos que necessitam de acesso venoso para administração de medicamentos ou soluções parenterais.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp Intravenoso Periférico Injex

El Scalp Intravenoso Periférico Injex se utiliza en procedimientos que requieren un acceso venoso para la administración de fármacos o soluciones parenterales.

Conserva sus características y funcionalidad para un solo uso, debiendo desecharse tras su uso, es decir, un producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.



Scalp com Dispositivo de Segurança



Scalp Intravenoso Periférico



Embalagem para Esterilização

As embalagens para esterilização são indicadas para embalar artigos médicos, hospitalares e odontológicos a serem submetidos ao processo de esterilização por Vapor e Óxido de Etileno. As embalagens apresentam a finalidade de conservar a integridade microbiológica dos materiais esterilizados até o momento de sua utilização, mantendo suas propriedades de forma conveniente para o usuário. Embalagem para esterilização tipo Pouch em Bobina, em que o usuário pode cortar a bobina no tamanho adequado para embalar o produto a ser esterilizado. Após a selagem, o produto lacrado pode seguir o procedimento de esterilização. A bobina possui impressões com tinta especial que mudam de cor após passar por determinado processo de esterilização.

Embalaje para Esterilización

Los paquetes para la esterilización son adecuados para el envasado médico, hospitalarios y dispositivos dentales para ser sometido al proceso de esterilización por Vapor y Oxido de Etileno. El paquete está destinado a preservar la integridad microbiológica de los materiales esterilizados hasta el momento de su uso, manteniendo sus propiedades convenientemente para el usuario. Embalajes para la bolsa de esterilización tipo carrete, en la que el usuario puede cortar la bobina a medida para el embalaje del producto a esterilizar. Después del sellado, el producto puede seguir el procedimiento de esterilización. La bobina tiene impresiones con tinta especial que cambian de color después de pasar por determinado proceso de esterilización.



Pouch Bobina
(Dois lados
termo selados e
dois lados termo
selantes)

Bobinas com
comprimento de
100m. Largura
variando de 120,
150, 200, 250,
300 e 400 mm

Embalagens para
Esterilização - Bobina

Eletrodo ECG Descartável

O Eletrodo ECG Descartável para Monitoração Cardíaca – Injex é indicado para o registro da atividade cardíaca mediante o emprego de um eletrocardiógrafo. Possibilita a condução da corrente elétrica do aparelho e a leitura do ECG dos pacientes.

Deve ser utilizado em repouso, com a pele preparada para a correta aplicação. Sua função é ser o intermediário entre o paciente e o aparelho de monitorização cardíaca, possibilitando a condução da corrente elétrica e a leitura do ECG do paciente. Possui um adesivo em sua base para ser fixado à pele do paciente, gel condutor, e o eletrodo que conecta o aparelho ao corpo do paciente.

Electrodo ECG Descartable

El Electrodo ECG Descartable para Monitoreo Cardíaco – Injex está indicado para el registro de la actividad cardíaca mediante el uso de un electrocardiógrafo. Permite la conducción de la corriente eléctrica del equipo y la lectura del ECG de los pacientes.

Debe ser utilizado en reposo, con la piel previamente preparada para una correcta aplicación. Su función es actuar como intermediario entre el paciente y el equipo de monitoreo cardíaco, permitiendo la conducción de la corriente eléctrica y la lectura del ECG del paciente. Cuenta con un adhesivo en su base para fijarse a la piel del paciente, gel conductor y el electrodo que conecta el equipo al cuerpo del paciente.



Eletrodo ECG
Descartável

Espardrapo Impermeável

O Espardrapo Impermeável Injex é indicado para fixação de curativos e ataduras. Possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, cateteres, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, etc. Possui um alto desempenho em fixação sendo muito resistente. É flexível e impermeável. É composto de tecido 100% algodão tratado para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento e adesivo acrílico isento de látex. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais prático e econômico. É comercializado em rolos plásticos com ou sem capa protetora, disponível na cor branca e na forma não estéril. Pode ser encontrado nas seguintes dimensões: 10cm x 4,5m; 5cm x 4,5m; 2,5cm x 4,5m; 1,2cm x 4,5m e 2,5cm x 90cm.

Espardrapo Impermeable

La cinta adhesiva impermeable Injex está indicada para fijar apósitos y vendajes. Tiene una amplia gama de usos en el entorno hospitalario, como la fijación de apósitos, sondas, catéteres, drenajes, dispositivos de infusión intravenosa, vendajes, etc. Ofrece una fijación de alto rendimiento y es muy resistente. Es flexible e impermeable. Está compuesta de tejido 100 % algodón tratado para facilitar el desgarro sin deshilacharse y adhesivo acrílico sin látex. Sus bordes dentados permiten un corte bidireccional sin necesidad de herramientas, lo que la hace más práctica y económica. Se vende en rollos de plástico con o sin cubierta protectora, disponible en color blanco y en versión no estéril. Está disponible en las siguientes dimensiones: 10 cm x 4,5 m; 5 cm x 4,5 m; 2,5 cm x 4,5 m; 1,2 cm x 4,5 m y 2,5 cm x 90 cm.



*Espardrapo
Impermeável*

☐ Branco



Máscara Tripla Camada

A Máscara Tripla Camada é utilizada para proteção do usuário durante procedimentos, evitando a contaminação cruzada e exposição a fluídos. Tem como finalidade proteger os profissionais da área da saúde e pacientes, impedindo a passagem de aerodispersóides e bactérias, durante procedimentos médicos, odontológicos e cirúrgicos. Composta por três camadas: 1ª camada: polipropileno não tecido (camada externa), 2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) - (camada do meio) e 3ª camada: polipropileno não tecido (camada interna).

Máscara de Triple Capa

La máscara de triple capa se utiliza para proteger al usuario durante los procedimientos, evitando la contaminación cruzada y la exposición a fluidos. Su finalidad es proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes, impidiendo el paso de aerodispersoides y bacterias durante los procedimientos médicos, odontológicos y quirúrgicos. Compuesto por tres capas: 1ª capa: polipropileno no tejido (capa exterior), 2ª capa: papel filtro soplado en fusión (BFE: $\geq 95\%$) - (capa intermedia) y 3ª capa: polipropileno no tejido (capa interior).



Máscara
Tripla Camada

Touca Descartável

A Touca Descartável – Injex é indicada para proteção do usuário em procedimentos que exigem controle de contaminação, sendo amplamente utilizada em ambientes hospitalares, clínicos, laboratoriais, industriais e alimentícios. Confeccionada em não tecido 100% polipropileno pelo processo SPP ou SMS, oferece boa resistência mecânica, conforto e excelente barreira contra agentes contaminantes. É de uso único, não esterilizável e não reutilizável, ideal para cobrir os cabelos e proteger tanto o ambiente quanto o paciente.

Gorro Desechable

El Gorro Desechable – Injex está indicado para la protección del usuario en procedimientos que requieren control de contaminación, siendo ampliamente utilizado en entornos hospitalarios, clínicos, laboratoriales, industriales y alimentarios. Confeccionado en tejido no tejido 100% polipropileno mediante el proceso SPP o SMS, ofrece buena resistencia mecánica, comodidad y una excelente barrera contra agentes contaminantes. Es de un solo uso, no esterilizable y no reutilizable, ideal para cubrir el cabello y proteger tanto el entorno como al paciente.



Touca Descartável



Sonda Foley Injex


A Sonda Foley Injex é indicada para o tratamento de distúrbios urinários ou nos casos em que o médico necessita de um controle mais rigoroso da diurese. A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo e dependerá da anatomia do paciente. É confeccionada em látex de borracha natural siliconizado, superfície lisa e com textura macia, possui balão com diferentes capacidades de enchimento.

Conector universal para sistema de escoamento de urina, permitindo a adaptação com qualquer tipo de bolsa coletora de urina. Possui diferentes tamanhos para cada necessidade, reduzindo assim os riscos de lesões na uretra e falha nos tratamentos. São diferenciados pela cor presente na ponta do funil de enchimento, além disto também estão indicados o tamanho em french (Fr) e a capacidade de enchimento do balão em mililitro (mL).

Sonda Foley Injex

La Sonda Foley Injex está indicada para el tratamiento de trastornos urinarios o en los casos en que el médico necesite un control más estricto de la diuresis. La indicación de cada tamaño específico es responsabilidad del profesional legalmente habilitado para utilizar el dispositivo y dependerá de la anatomía del paciente. Está hecho de látex de caucho natural siliconado, tiene una superficie lisa y una textura suave, tiene un globo con diferentes capacidades de llenado.

Conector universal para sistema de drenaje de orina, que permite la adaptación a cualquier tipo de bolsa de recogida de orina. Tiene diferentes tamaños para cada necesidad, reduciendo así el riesgo de lesión de la uretra y fracaso del tratamiento. Se diferencian por el color presente en la punta del embudo de llenado, además, también se indica el tamaño en french (Fr) y la capacidad de llenado del globo en mililitros (mL)

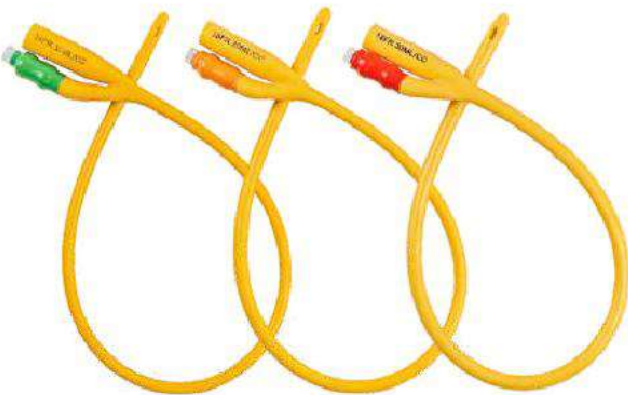

Sonda Foley

Bolsa Coletora de Urina

A Bolsa Coletora de Urina - Injex é destinada para coleta, armazenamento, drenagem e monitoramento do volume urinário de pacientes em unidades de saúde, hospitais e clínicas.

A Bolsa Coletora de Urina - Injex é utilizada para coleta de urina em pacientes que possuem incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há a necessidade de esvaziamento da bexiga. O dispositivo é conectado à sonda previamente introduzida no paciente, recebendo e armazenando a urina drenada do mesmo.

Bolsa Colectora de Orina

La Bolsa Colectora de Orina - Injex está destinada a la recolección, almacenamiento, drenaje y monitoreo del volumen urinario de pacientes en unidades de salud, hospitales y clínicas.

La Bolsa Colectora de Orina - Injex se utiliza a la recolección de orina en pacientes con incapacidad para orinar, con incontinencia urinaria o sometidos a procedimientos quirúrgicos que requieren el vaciado de la vejiga. El dispositivo se conecta a la sonda previamente introducida en el paciente, recibiendo y almacenando la orina drenada del mismo.



Bolsa Coletora de Urina

Seringa Dosadora Oral - Linha Farmacêutica

A Seringa Dosadora Oral é indicada para dosagem exata dos medicamentos, proporcionando mais doses por frascos. Utilizada pela indústria farmacêutica para facilitar a administração de medicamentos em crianças e idosos.

Disponível na cor azul ou incolor. A Seringa Dosadora Oral apresenta bico arredondado que não fere a boca, e anel de retenção que impede o desprendimento livre do êmbolo.

Confeccionada em plástico atóxico que não interage com o medicamento. Apresenta tampa que evita a contaminação do medicamento quando exposto.

Pode ser embalada individualmente das seguintes formas: Sem adaptador, com Adaptador embalado ao lado e com Adaptador acoplado no bico da seringa. O cilindro pode ser personalizado ou não.

Jeringa de Dosificación Oral - Línea Farmaceutica

La Jeringa de Dosificación Oral es adecuada para la dosificación exacta de drogas, proporcionando más dosis por vial. Utilizados por la industria farmacéutica para facilitar la administración de medicamentos en niños y ancianos.

Disponible en color azul o incoloro. Presenta color de cilindro azul o incoloro.

La jeringa de dosificación oral ha boquilla redondeada que no hace daño a la boca y tiene el anillo de retención que impide la liberación libre del émbolo.

Hecho en plástico no tóxico no interactuar con el medicamento. Una cubierta evita contaminaciones de la droga cuando se expone.

Puede ser empaquetada unitariamente de las siguientes maneras: Sin adaptador, con adaptador empaquetado en el lateral y con adaptador acoplado a la boquilla de la jeringa. El cilindro puede ser personalizado o no.



Seringa Dosadora Oral

Adaptador Farmacêutico

Confeccionado em polímeros atóxicos e inertes, em diversos tamanhos que correspondem ao diâmetro dos frascos e vidros utilizados para o envase de medicamentos.

Além de adaptar-se à Seringa Dosadora Oral, o adaptador minimiza a possibilidade de perda por derramamento acidental de medicamentos.

Disponíveis em cinco tamanhos, com diâmetros de 11, 16, 19, 22, e 26mm. Embalados à granel ou com a Seringa Dosadora Oral em embalagem BOPP.

Adaptador Farmaceutico

Hecho de polímeros no tóxicos e inertes, en varios tamaños que se corresponden con el diámetro de las botellas y vidrio utilizados para el envasado de medicamentos.

Además de adaptarse a Jeringa de Dosificación Oral, el adaptador minimiza la posibilidad de perda debido a derrames accidentales de dogras.

Disponible en cinco tamaños con diámetros de 11, 16, 19, 22 y 26mm. Embalados a granel o con la Jeringa de Dosificación Oral em paquetes de BOPP.



Adaptador Farmacêutico

Agulha Gengival

Especialmente projetada para aplicações de anestésicos e outros produtos de uso exclusivo odontológico. Agulhas gengivais estéreis, descartáveis, atóxicas e apirôgenicas, possuem bisel trifacetado e cânula siliconizada que permitem maior conforto e suavidade em sua penetração.

A cânula altamente flexível, com bisel em ângulo curto, faz com que a agulha penetre no tubete sem que ocorra retenção de borracha, que causa entupimento.


Permite ao profissional maior agilidade sem ocorrer a quebra da cânula. Canhão apresenta rosca interna que permite conexão aos diversos modelos de seringas de carpule. Validade de 5 anos com embalagem intacta. Disponível em calibre 30 G (15x0,30, 22x0,30, 30x0,30mm) e 27 G (22x0,40, 30x0,40mm), conforme ISO 7885.

Aguja Gingival

Está especialmente diseñado para las aplicaciones de anestésicos y otros productos de uso exclusivo odontológico. Agujas gingivales estériles, atóxicas y apirógenicas presentando bisel trifacetado y la cânula con silicona, proporcionando un mayor confort y suavidad en su penetración.

La cânula muy flexible, con bisel de ángulo corto hace que la aguja para introducir el cartucho sin ninguna retención de goma que causa la obstrucción.

Permite al usuário una mayor agilidad sin que se produzir la rotura de la cânula. El caño tiene rosca interna que permite la conexión a diversos tipos de jeringas de carpule. 5 años de validez con el paquete intacto. Disponible en calibres 30 G (15x0,30, 22x0,30, 30x0,30mm) e 27 G (22x0,40, 30x0,40mm), de conformidad con la norma ISO 7885.

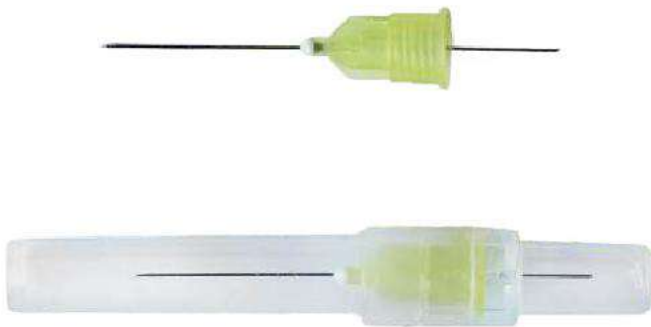

Agulha Gengival

Agulha de Irrigação

Agulhas especiais para uso odontológico, facilitando os procedimentos de irrigação.

Agulhas sem bisel, esterilizadas a Óxido de Etileno, embaladas individualmente, com validade de 5 anos em embalagem intacta.

Apresenta os calibres: 25x0,80, 25x0,70, 25x0,60, 25x0,40 e 25x0,30mm.

Aguja de Irrigacion

Agujas especiales para uso odontológico, que hace que los procedimientos de riego más fácil.

Agujas sin bisel esterilizados con Óxido de Etileno, embaladas individualmente, con 5 años validez con el embalaje intacto.

Presentado en los calibres: 25x0,80, 25x0,70, 25x0,60, 25x0,40 y 25x0,30mm.



Agulha de Irrigação



Kit para Monitoramento de Glicose
no Sangue Injex Sens



Glicosímetro Injex Sens II Plus

Sistema de monitoramento de glicose no sangue através de uma tira reagente (tecnologia Bio Sensor).

Aparelho com escala de medição de 10 a 600mg/dL, sistema aferido para permitir medição de glicemia em amostra de sangue capilar.

O volume de amostra é de 0,5 µl de sangue capilar fresco, o resultado do exame é dado em 5 segundos.

O método de análise é eletroquímico e deve ser usado com a tira reagente Injex Sens.

Monitoramento eficiente da diabetes com símbolos de marcação.

Apresenta capacidade de memória de 1000 exames com data e hora, oferece sistema de monitoramento através de software que possibilita a interação médico-paciente com maior controle, segurança e eficiência, permitindo que o paciente envie via internet seus registros ao seu médico.

Possui 2 baterias de Lítio.

O medidor possui ejetor de tira que possibilita o descarte da mesma de forma segura e higiênica, sem contato com as mãos.

Glucómetro Injex Sens II Plus

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre a través de una tira reactiva (tecnología Bio Sensor).

Dispositivo con escala de medición de 10 a 600 mg / dl, sistema medido para permitir la medición de la glucosa en una muestra de sangre capilar.

El volumen de muestra es de 0,5 ul de sangre capilar fresca, con un resultado en 5 segundos.

El método de análisis es electroquímico y debe usarse con la tira Injex Sens.

Monitoreo eficaz de la diabetes con símbolos de marcado.

Con una capacidad de memoria de 1000 exámenes con fecha y hora, ofrece sistema de monitoreo a través de software que posibilita la interacción médico-paciente con mayor control, seguridad y eficiencia, permitiendo que el paciente envíe por internet sus registros a su médico.

Tiene 2 baterías de Litio.

El medidor tiene un ejetor de tira que posibilita el descarte de la misma de forma segura e higiénica, sin contacto con las manos.



Glicosímetro

Tira de Teste de Glicose no Sangue Injex Sens

Tira reagente para determinação de glicose através do Glicosímetro da linha Injex Sens. Codificada através de uma enzima que ao contato com uma corrente elétrica do medidor converte o sinal obtido numa leitura numérica apresentando o resultado final do exame. Sua sensibilidade analítica é de 10 a 600 mg/dL e sua especificidade é Glicose Oxidase. Necessário apenas 0,5 µl (microlitros) de amostra sanguínea, e aspira o sangue instantaneamente.

Tira de Prueba de Glucosa en Sangre Injex Sens

Tira reactiva para la determinación de glucosa por Injex SENS Glucómetros. Codificada através de una enzima, que en contacto con una corriente eléctrica del dispositivo convierte la señal obtenida a partir de una lectura numérica se presentan el examen final. Su sensibilidad analítica es 10 a 600 mg/dl y su especificidad es Glucosa Oxidasa. Se necesita sólo 0,5 µl (microlitros) de muestra de sangre y aspira la sangre instantáneamente por capilaridad.



Tira Reagente

Lancetador

Dispositivo para auxílio e obtenção de amostras de sangue capilar para testes sanguíneos, deve ser utilizado apenas com as lancetas Injex. Permite uma punção indolor, fácil e rápida. Apresenta dez níveis de ajuste de penetração adequando-se a textura da pele individualmente.

A ativação por contato proporciona segurança, precisão e rapidez em sua punção. Possui dispositivo de extração/ejeção da lanceta trazendo mais segurança em seu descarte. Ativação do lancetador é demonstrada através da identificação de cor.

Dispositivo de punción

Dispositivo para ayudar y obtener muestras de sangre capilar para análisis, que debe ser usado con las lancetas Injex. Se permite una punción indolora, fácil y rápido. Presenta diez niveles de ajuste de penetración adecuando la textura de la piel individualmente.

La activación por contacto proporciona seguridad, precisión y velocidad en la punción, permitiendo su eliminación segura.

Posee dispositivo de extracción de la lanceta trayendo más seguridad en su descarte. La activación del lancetador se demuestra mediante la identificación de color.



Lancetador



Lanceta Hipodérmica

A Lanceta Hipodérmica Injex foi projetada para ser utilizada com um lancetador que irá facilitar a punção para a coleta de amostra de sangue capilar.

A Lanceta apresenta bisel siliconizado que permite rápida punção do local escolhido para retirada de amostra de sangue quando utilizado com o lancetador.

Disponível no calibre: 30G 2,0x0,30mm.

Lanceta Hipodérmica

La lanceta hipodérmica Injex está diseñada para usarde con un dispositivo de punción que facilitará la punción para la toma de muestras de sangre capilar.

La lanceta tiene un bisel siliconizado que permite una punción rápida del sitio elegido para tomar una muestra de sangre cuando se usa con el dispositivo de punción.

Disponible en calibre: 30G 2,0x0,30mm.

Lanceta com Dispositivo de Segurança

Dispositivo para coleta de sangue capilar com sistema de disparo e retração da lanceta automaticamente. Dispositivos estéreis, apirrogênicos e atóxicos, de uso para testes sanguíneos capilares.

Disponível no calibre 28 G 1,5x0,36 mm.

Lanceta con Dispositivo de Seguridad

Dispositivo colector de sangre capilar, con descarga automática y sistema de lanceta con retracción. Los produtos no tóxicos y no pirógenos y esteriles, utilizados para pruebas sanguíneas capilares.

Disponible en 28G 1,5x0,36mm.



Lanceta



Lanceta com
Dispositivo de Segurança

Agulha para Caneta de Aplicação de Insulina

Agulhas indicadas para uso em canetas apropriadas para aplicação de injeção subcutânea, principalmente de insulinas.

Compatível com as canetas existentes no mercado, proporcionando adaptação e conexão segura.

As agulhas são siliconizadas o que proporciona maior conforto no momento da aplicação. Indicadas para crianças, adolescentes e adultos, apresentam protetor interno de agulha que protege o bisel e protetor externo que garante a esterilidade da agulha até a retirada do lacre. Embalagens em caixas com 100 unidades nos calibres mais utilizados, como os de 4,0x0,23; 5,0x0,25; 8,0x0,25 e 12,7x0,33mm e outros sob consulta.

Aguja para la Pluma de Aplicación de Insulina

Agujas indicados para uso en plumas adecuadas para la aplicación de la inyección subcutánea, especialmente las inyecciones de insulina.

Compatible con las plumas en el mercado, lo que permite la adaptación y conexión seguros con la pluma.

Las agujas son siliconado, proporcionando una mayor comodidad durante la aplicación. Adecuadas para niños, adolescentes y adultos, presenta un protector interno que protege el bisel y un protector externo que asegura la esterilidad de la aguja hasta la eliminación de la lacre. Embalaje en cajas con 100 unidades en los calibres más utilizados tales como 4,0x0,23; 5,0x0,25; 8,0x0,25 e 12,7x0,33mm y otros bajo demanda.



Agulha
para Caneta

Seringa 1mL para Insulina U-100 com ou sem Agulha Acoplada

Seringas hipodérmicas de insulina com agulha desconectável, uso único, atóxica, esterilizada a Óxido de Etileno, com validade de 5 anos em embalagem intacta, embaladas individualmente.


Possui alto grau de precisão em sua escala de graduação com intervalos de 10 em 10UI com subdivisão de 2 em 2 UI com volume total de 1mL - 100UI. Possui bico Luer Slip.

Jeringa 1mL para Insulina U-100 con ou sin Aguja Acoplada

Jeringas hipodérmicas de la insulina con aguja desmontable, de un solo uso, no toxico, estéril con Oxido de Etileno, una validez de 5 años con el paquete intacto, empaquetados individualmente.

Presenta un alto grado de precisión en su escala de graduación intervalos de 10 a 10UI con una subdivisión de 2-2 UI con volumen total de 1mL - 100UI. Se tiene la sonda Luer Slip.

BICO LUER SLIP

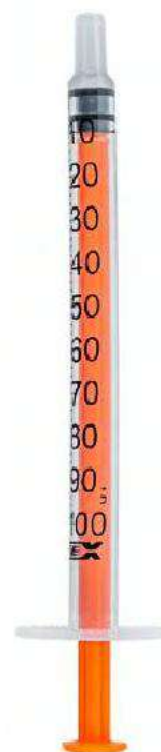

1mL



Seringa para Insulina U-100 (0,5mL e 1mL com Agulha Fixa Stilly Line)

Seringas de Insulina Stilly Line, de 0,5mL e 1mL, com agulha fixa longa e curta. Estéreis, atóxicas, apirrogênicas, livres de látex, descartáveis e de uso único. Volume nominal de 100UI (1ml) com intervalo de 10 em 10UI e subdivisão de 2 em 2UI e volume nominal de 50UI (0,5mL) com intervalos de 5 em 5UI e subdivisão de 1 em 1UI. Fácil leitura de graduação, residual zero, com agulha trifacetada e siliconizada em toda sua extensão.

Jeringa para Insulina U-100 (0,5mL e 1mL com AguJa Fija Stilly Line)


Jeringas de Insulina Stilly Line, de 0,5mL e 1mL, com agulha fija larga y corta. Estériles, atóxicas, apirrogênicas, libres de látex, desenchable y de um solo uso. Volumen nominal de 100UI (1mL) con intervalo de 10 en 10UI y subdivisión de 2 en 2UI y un volumen nominal de 50UI (0,5mL) intervalos de 5 en 5UI y subdivisión de 1 en 1UI. Fácil lectura de graduación, residual cero, con aguja trifacetada y siliconizada en toda su extensión.

AGULHA
FIXA

AGULHA
FIXA



0,5mL

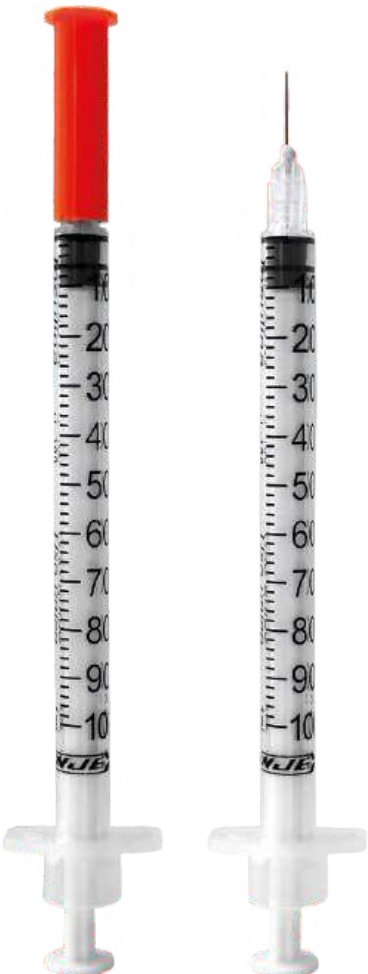

1mL

Adaptador para Agulha de Coleta Múltipla

O adaptador é o acessório que permite ao usuário uma boa empunhadura e segurança na hora da coleta de sangue a vácuo.

É confeccionado em plástico transparente e desenvolvido especialmente para o sistema de coleta Injex Vácuo.

Adaptador de Aguja de Colecta Múltiple

El adaptador es un accesorio que permite a los usuarios un buen agarre y seguridad cuando la recogida de la sangre a vacío.

Está hecho de plástico transparente y especialmente desarrollado para el sistema de recogida Injex Vácuo.

Scalp para Coleta Injex

O Scalp para Coleta Injex é utilizado em procedimentos que necessitam de coleta de sangue a vácuo.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp para Colecta Injex

El Scalp para Colecta Injex se utiliza en procedimientos que requieren la extracción de sangre al vacío.

Conserva sus características y funcionalidad para un solo uso, debiendo desecharse tras su uso, es decir, un producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.



Adaptador de Coleta a Vácuo



Scalp de Coleta de Sangue a Vácuo



Agulha de Coleta Múltipla

Agulhas especiais para coleta de sangue a vácuo em sistema fechado. Apresenta os calibres 21G (25x0,80; 30x0,80) e 22G (25x0,70; 30x0,70), agulha com bisel trifacetado e siliconizado, que facilita a penetração na pele e na veia, minimizando traumas.

Possui proteção de borracha na parte inferior da agulha reduzindo o risco de contaminação durante as trocas dos tubos. Embaladas individualmente, esterilizadas a Óxido de Etileno e validade de 5 anos com embalagem intacta.

Aguja de Colecta Múltiplo

Agujas especiales para la colecta de la sangre de vacío en sistema cerrado. Disponible en calibres 21G (25x0,80; 30x0,80) y 22G (25x0,70; 30x0,70), cuenta con la aguja de bisel siliconado trifacetado, lo que facilita la penetración en la piel y venas y también minimizar los traumas.

Tiene una protección de goma en la parte inferior de la aguja reduciendo el riesgo de contaminación durante los intercambios de tubo. Empaquetado individualmente, esterilización con Óxido de Etileno y 5 años de validez con el paquete intacto.



Agulha de Coleta Múltipla



Agulha

Proteção de Borracha

Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo

Revolucionário no mercado de diagnóstico laboratorial, o sistema fechado de coleta de sangue a vácuo trouxe precisão e segurança nos serviços prestados com a possibilidade de coletas múltiplas.

Os Tubos Injex Vácuo são usados para coletar, transportar e processar sangue para exame de soro, plasma ou sangue in natura. Este sistema evita contaminações da amostra, permite a coleta ideal e suficiente de sangue para a realização do exame, e seu descarte torna-se fácil e seguro evitando acidentes.

Os tubos são esterilizados pelo processo de Radiação, apresentam tampas que contém capas protetoras que evitam fácil abertura, evitando contaminações. São fabricados com e sem aditivos.

O sistema de coleta a vácuo Injex segue a rigorosa Norma Internacional ISO 6710. Dispomos de Tubos para Coagulação, Sorologia, Glicemia, Tipagem Sanguínea.

Tubo de Colecta de Sangre al Vacio

Revolucionario em el mercado de diagnostico de laboratorio, el sistema cerrado de la colecta de sangre al vacio, trajo la precisión y seguridad de los dispositivos previstos con posibilidad de múltiples colecciones.

Tubos de vacio Injex se utilizan para colecta, transporte y proceso para la prueba de suero, plasma o pruebas de sangre fresca. Este sistema evita la contaminación de las muestras. Permite a la colecta de sangre ideal y suficiente para la prueba, y su descarte se vuelve fácil y seguro, para evitar accidentes.

Los tubos se esterizaron mediante proceso de radiación; que cuentan con tapas que contienen cubiertas de protección que impiden la apertura fácil, por lo tanto evitando la contaminación. Se fabrican con o sin aditivos.

El sistema de colecta de vacío sigue la estricta Norma Internacional ISO 6710. Hemos tubos para coagulación, serología, la glucosa em sangre, determinación del grupo sanguíneo.



Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo



A C P CORREA CIA LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgão Públicos, Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.
Área de atuação: Paraná (Interior).

Contato: Pagini / Marina / Gustavo

Telefone: 43 3242-1589
Celular: 43 99972-4151 / 43 99935-0910

E-mail: medialsuture@uol.com.br
acphospitalar@uol.com.br

ADVAITA REPRESENTAÇÕES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Hospitais, Redes de Farmácias e Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.
Área de atuação: Rio de Janeiro.

Contato: Rafael

Telefone: 21 2603-5020
Celular: 21 99735-5423 / 21 98005-0039

E-mail: licitacoes@advrepresentacoes.com.br
licitacoes2@advrepresentacoes.com.br

ARIES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Estado do Paraná (Curitiba e Região Metropolitana).

Contato: Winston

Telefone: 41 3248-4793
Celular: 41 99116-8930
E-mail: winston.hosp@gmail.com

BONS AIRES REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Minas Geras (Região Metropolitana de Belo Horizonte e Central de MG).

Contato: Clayton / Jandinise

Celular: 31 98736-7667 / 31 99234-1514
E-mail: claytonmacedo@uol.com.br
jandinise@hotmail.com

CJS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Segmento: Hospitais Particulares e OSS
Área de atuação: Norte, Nordeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Tocantins

Contato: Sandra/ Julia

Celular: 11 97589-5310
E-mail: sandra@cjsrepresentacao.com.br
celular: 11 96581-9754
E-mail: julia@cjsrepresentacao.com.br

DELTA SERVIÇOS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: São Paulo (Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Bauru).

Contato: Cortez

Telefone: 18 3262-1658
Celular: 18 99704-9887
E-mail: deltavendas1@hotmail.com

DUTRA REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Piauí.

Contato: Marcos Dutra

Celular: 86 99808-4889 / 86 99593-2192
E-mail: marcos@dutrarepresentacoes.com

EPI REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Odontológico
Área de atuação: Rio de Janeiro

Contato: Simone / Carlos

Celular: 21 99918-1965
E-mail: simonepimenta39@hotmail.com

FARMALKLIN REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Hospitais privados e Farmácias.
Área de atuação: Rio Grande do Sul

Contato: Marcos / Felipe

Celular: 51 98421-7753
E-mail: marcos@farmaklin.com.br

Celular: 51 98421-7558
E-mail: felipe@farmaklin.com.br

FENAMAR REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Santa Catarina.

Contato: Fernando/Maria Fernanda/Marina

Telefone: 48 3246-7494
Celular: 48 99969-7494 / 48 99923-4676
48 99941-8401
E-mail: fenamarltda@hotmail.com

H M REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Hospitais, Órgão Públicos, Farmácias e Odontológico.
Área de atuação: Sul e Oeste do Maranhão e Sudeste do Pará.

Contato: Hugo

Celular: 99 98105-9261
E-mail: hugocesarsilvamedes@gmail.com

INOVAMED REP. EIRELLI

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de Farmácias.

Área de atuação: Bahia

Contato: John / Ivana

Celular: 77 98845-1158
E-mail: inovamedba@gmail.com

INS REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Bahia

Contato: Fabio Bittencourt

Celular: 71 99102-8426
E-mail: injex.fabio@gmail.com

J C DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Sergipe / Alagoas.

Contato: José Carlos

Celular: 82 98858-7978
E-mail: jcsantosrep7@gmail.com

JANDERLEY CAMPELO ME

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Ceará.

Contato: Janderley

Telefone: 85 3035-1248
Celular: 85 98888-1248
E-mail: janderleycampelo@hotmail.com

KRL DE PAULA LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Tocantins.

Contato: Kellyson

Celular: 63 99974-1001
E-mail: kellyson_r.51@hotmail.com

LLD REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Hospitais particulares, OSS e Clínicas.
Área de atuação: São Paulo (Grande São Paulo).

Contato: Luiz Ladeira

Celular: 11 96084-7993
E-mail: luizladeira@uol.com.br

MANUEL ALMEIDA MELO

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: São Paulo (Campinas, Sorocaba, Itu, Americana e Rio Claro)

Contato: Manuel

Telefone: 19 3238-8874
Celular: 19 99772-5370
E-mail: manuel.melo@terra.com.br

MEDFARMA REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Pernambuco

Contato: Junior

Celular: 81 99178-0444
E-mail: juniorinjexpe@outlook.com



MEDIEQUIP COM. E REP. EIRELI

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Minas Gerais (Regiões Zona da Mata de Sul de MG).

Contato: Luiz Limp

Celular: 32 98877-3263

E-mail: luiz.limp@hotmail.com

M & B REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Espirito Santo.

Contato: Odair

Telefone: 27 99238-4926

Celular: 27 99686-8948

E-mail: mebcirurgica@gmail.com

NJ REPRESENTAÇÕES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Goiás e Distrito Federal

Contato: Yara Jacinto

Celular: 62 99328-5831

E-mail: njrepresentacoes@gmail.com

OD REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de Farmácias e Laboratórios.

Área de atuação: Amazonas e Roraima

Contato: Alexis / Ma. Trindade / Alexandre / Heleno

Celular: 92 99982-0344

E-mail: alexisod@hotmail.com

Celular: 92 99487-7111

E-mail: odtrindade@hotmail.com

Celular: 92 98429-5794

E-mail: od.alexandre@hotmail.com

Celular: 92 99158-7671

E-mail: od.heleno@outlook.com

ONEMED HOSPITALAR LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Estado do Maranhão (capital e região metropolitana de São Luiz).

Contato: Valmir França.

Celular: 98 98142-5534

E-mail: valmirjesus0509@gmail.com

PABLO CARVALHO

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Laboratórios Farmacêuticos.

Área de atuação: São Paulo, Região Metropolitana, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Paulista (Norte, Baixada Santista, Sul).

Celular: 11 96497-6923

E-mail: vendas5@injex.com.br

PAULO HERIQUE CORREIA LIMA

Segmento: Odontológico

Área de atuação: Minas Gerais.

Celular: 31 98280-6363

E-mail: paulolima10@yahoo.com.br

R DOS ANJOS TELLES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.

Área de atuação: São Paulo (São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca), Minas Gerais (Região do Triângulo Mineiro).

Contato: Rogério / Raquel / Bruna

Telefone: 16 3701-8170

Celular: 16 98259-9318 / 16 99343-0578

E-mail: rogerio@tresrs.com.br / tresrs@tresrs.com.br
raquel@tresrs.com.br / atendimento@tresrs.com.br

SILVANA REPRESENTAÇÕES

Segmento: Laboratório de Análise Clínicas

Área de atuação: Território Nacional.

Contato: Tina / Silvana

Telefone: 11 2087-3908

Celular: 11 96342-6973 / 11 99856-7952

E-mail: silvanarepresentacoes02@outlook.com
silvanarepresentacoes@outlook.com

SOARES E RODRIGUES REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

Segmento: Distribuidores e Órgãos Públicos

Área de atuação: Acre e Rondônia

Contato: Gladly Rodrigues

Celular: 69 99981-4000 / 69 99287-4191

E-mail: soares.rodriguesglady@gmail.com

SOUZA E CERBINO REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de farmácias e Odontológicos.

Área de atuação: Pará e Amapá

Contato: Aline Cerbino

Celular: 91 98547-2465

E-mail: aline.cerbino@outlook.com

TURKI REPRESENT. COM. LTDA

Segmento: Odontológico.

Área de atuação: Rio Grande do Sul.

Contato: Daiane

Celular: 51 99112-7786

E-mail: daianeturki@hotmail.com

VIEIRA DE MELLO REPRESENTAÇÕES

Segmento: Odontológico.

Área de atuação: São Paulo e Grande São Paulo.

Contato: João Tadeu

Celular: 11 99635-9088

E-mail: reprieveirademello@terra.com.br

VILAR E CARVALHO REP. LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias

Área de atuação: Rio Grande do Norte e Paraíba.

Contato: Gislan

Celular: 84 99697-0268

E-mail: vilarecarvalho@hotmail.com

VILELA E FACCIN LTDA.

Segmento: Distribuidores Hospitalar/Farma/Odonto, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Contato: Henrique Vilela / Luiz Henrique Vilela / Vera Lúcia Faccin / Lucélia Silva.

Celular: 65 99981-3437

E-mail: henriquevilela@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99982-3366

E-mail: verafaccin@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99975-8054

E-mail: luhvilela@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99811-3366

E-mail: licelia@vilelafaccin.com.br

WILL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Minas Gerais (Regiões de Montes Claros, Gov. Valadares, Nordeste, Norte, Vale, Jequitinhonha, Vale Mucuri e Vale do Rio Dode).

Contato: Westerle

Celular: 38 99198-0131

E-mail: westerle@uol.com.br

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

www.injex.com.br
injex@injex.com.br

Sac: 0800 770 6080 | +55 14 3302.2900

Av. Comendador José Zillo, 160 – Distrito Industrial
Ourinhos-SP – CEP 19908-170 – Caixa Postal 75

*Produtos para saúde,
dentro dos padrões
de qualidade INJEX.*

Hospitalar
Farmacêutico
Odontológico
Diabetes
Diagnóstico

2832

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

NOSSA QUALIDADE, NOSSO COMPROMISSO

Catálogo

Linha de Produtos



“No ano de 1984 em uma viagem aos Estados Unidos nosso fundador Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues iniciou um estudo de pesquisa de mercado e em 1988 a INJEX foi fundada.

Instalada na cidade de Ourinhos nossa empresa é genuinamente brasileira, está presente em todo mercado nacional e nas principais capitais da América Latina por meio de seus representantes, que atuam dinamicamente na pré e pós-venda assegurando a rapidez na entrega de seus produtos, os quais possuem qualidade assegurada pelas normas de Boas Práticas de Fabricação, NBR ISO 9001 e NBR ISO 13485.

Com uma infraestrutura moderna e segura a INJEX oferece aos seus funcionários um excelente ambiente de trabalho, com treinamentos específicos direcionados a todas as áreas (Cursos de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Boas Práticas de Fabricação, Capacitação para Operadores de Máquinas, etc.), além de uma ampla área de lazer.

Visando contribuir para a melhoria no setor de atendimento da empresa, assim como no aperfeiçoamento das áreas que possibilitem esta transformação, temos o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.

Contando com o que há de mais moderno em tecnologia, processos produtivos dinâmicos, modernas técnicas gerenciais, a INJEX Indústrias Cirúrgicas tem como missão melhorar cada vez mais a qualidade de seus produtos, minimizando os custos, partindo da premissa de que “o sucesso de hoje não garante o de amanhã”.

www.injex.com.br
injex@injex.com.br

LINHAS
HOSPITALAR

Seringa Hipodérmica.....	05
Tampa Protetora Luer - Injex Cap	05
Seringa 1 ml Tuberculina	06
Seringa com Dispositivo de Segurança (Safety)	06
Seringa Dosadora Oral - Linha Hospitalar	07
Agulha para Aspiração	07
Agulha Hipodérmica	08
Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança (Safety).....	08
Cateter Intravenoso com Dispositivo de Segurança Injex Cath.....	09
Cateter Intravenoso Injex Cath.....	09
Luva Cirúrgica.....	10
Luva de Procedimento.....	11
Torneira de Três Vias	12
Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções	12
Equipo de Infusão Gravitacional.....	13
Equipo Enteral.....	13
Scalp com Dispositivo de Segurança.....	14
Scalp Intravenoso Periférico Injex	14
Embalagem para Esterilização	15
Eletrodo ECG Descartável.....	15
Esparadrapo Impermeável Injex	16
Máscara Tripla Camada.....	17
Touca Descartável	17
Sonda Foley Injex.....	18
Bolsa Coletora de Urina.....	18

FARMACÊUTICA

Seringa Dosadora Oral - Linha Farmacêutica	19
Adaptador Farmacêutico	20

ODONTOLÓGICA

Agulha Gengival.....	21
Agulha de Irrigação	21

DIABETES

Glicosímetro Injex Sens II Plus	23
Tira de Teste de Glicose no Sangue Injex Sens.....	24
Lancetador.....	24
Lanceta Hipodérmica	25
Lanceta com Dispositivo de Segurança	25
Agulha para Caneta de Aplicação de Insulina.....	26
Seringa 1ml para Insulina U-100 Com ou Sem Agulha Acoplada	26
Seringa para Insulina U-100 (0,5ml e 1ml Com Agulha Fixa Stilly Line).....	27

DIAGNÓSTICO

Adaptador para Agulha de Coleta Múltipla.....	28
Scalp para Coleta Injex.....	28
Agulha de Coleta Múltipla	29
Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo.....	30

ATENDIMENTO

Representantes Comerciais	31
Representantes Comerciais	32



Linha de Seringas- Injex

INJEX

Seringa Hipodérmica

Estéreis, atóxicas e apirogênicas. Cilindro altamente transparente permitindo total visualização do fluido aspirado.

Êmbolo látex free, graduação com alto grau de precisão.

Embaladas individualmente. Esterilizadas a Óxido de Etileno, com validade de 5 anos em embalagem intacta. Todas, com exceção das seringas de 1 ml e 60 ml, possuem o BREAK OFF SYSTEM, sistema de quebra da haste que inutiliza a seringa.

Tamanhos: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip e 60 ml Sonda.


Jeringa Hipodermica

Esteriles, atoxicas y apirogenicas. Cilindro altamente transparente, permitiendo una total visualización del fluido aspirado.

Êmbolo de látex libre, graduación con alto grado de precisión.

Empaquetado individualmente. Esterilizadas a Oxido de Etileno, con validez de 5 años en embalaje intacta. Todos, a excepciones de las jeringas de 1 ml y 60 ml, tienen el BREAK OFF SYSTEM, sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa.

Tamaños: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip y 60 ml Boquilla Sonda.

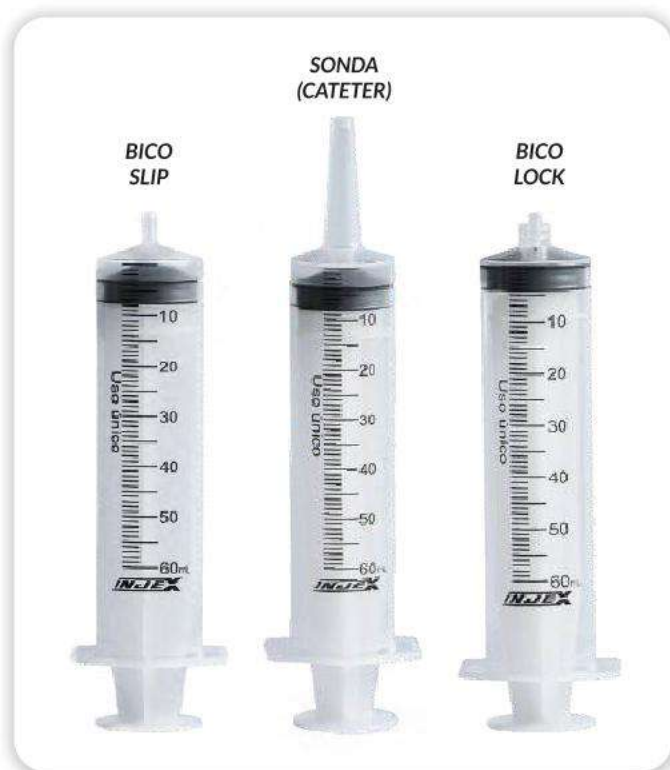

Break off System

Sistema de quebra de haste que inutiliza a seringa.

Sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa



Tampa Protetora Luer - Injex Cap

Projetada para bicos slip ou lock, protege contra a entrada de possíveis contaminações. Apresenta-se estéril atendendo os seguimentos da área da saúde.

Utilizada após preparo ou envase de medicamentos para a prevenção de possíveis contaminações durante o armazenamento e transporte interno em hospitais, consultórios, farmácias de manipulação e indústrias farmacêuticas e veterinárias.

Tapa Protectora Luer - Injex Cap

Diseñado para boquillas de deslizamiento o bloqueo, protege contra posibles contaminaciones. Es estéril, cumple con los requisitos del área de salud. Se utiliza después de la preparación o el envasado de medicamentos para evitar la posible contaminación durante el almacenamiento y el transporte interno en hospitales, clínicas, farmacias de manipulación y las industrias farmacéutica y veterinaria.



Seringa 1 ml Tuberculina

A seringa de 1 ml Tuberculina é ideal para injeções em geral, injeção de contrastes, preparo de diluições e fracionamento de medicamentos, vem com escala de graduação precisa para o controle ideal de quantidade, sendo indicada também para aplicação de vacinas. São embaladas individualmente em embalagem selada que garante a esterilidade até o momento do uso.

A seringa de 1 ml tuberculina é um artigo médico hospitalar indicado para aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos e soluções, também pode ser utilizada para administrar medicamentos via parenteral

Modelos: Luer Slip e Luer Lock

Jeringa 1 ml Tuberculina

La jeringa de tuberculina de 1 ml es ideal para inyecciones generales, inyección de contraste, preparación de diluciones y fraccionamiento de fármacos, viene con una escala de graduación precisa para un control óptimo de la cantidad, y también está indicado para la aplicación de vacunas. Se envasan individualmente en un paquete sellado que garantiza la esterilidad hasta el momento de su uso.

La jeringa de tuberculina de 1 ml es un artículo médico hospitalario apto para aplicar, inyectar, irrigar, aspirar y extraer líquidos y soluciones, también puede utilizarse para administrar fármacos por vía parenteral.

Modelo: Luer Slip e Luer Lock



Seringa 1 ml
Tuberculina

Seringa com Dispositivo de Segurança (Safety)

Indicada para aplicar, injetar, irrigar, aspirar, extrair fluidos e soluções parenterais.

Seringa com dispositivo de segurança para garantir o descarte seguro e sua inutilização. Segurança para o profissional da saúde e para o paciente. Apresenta protetor articulado para alojamento da agulha após o uso e quebra da haste para inutilização do produto. Segurança para o descarte seguro de perfurocortantes.

Segue a norma Regulamentadora – NR32 para segurança no trabalho em serviços de saúde.

Seringas nos tamanhos: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock.

Jeringa con Dispositivo de Seguridad (Safety)

Indicado para la aplicación, la inyección, irrigación, aspire fluidos y soluciones parenterales.

Jeringa con dispositivo de seguridad para asegurar la eliminación segura y su destrucción. Seguridad para el profesional en el área de la salud y el paciente. Presenta guardia articulado para el alojamiento de la aguja después de su uso y rotula el varilla a la destrucción del producto.

Seguridad para la eliminación de objetos punzocortantes. Sigue la normativa reguladora – NR32 para la seguridad en los servicios de salud.

Jeringas nos tamaños: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml 60ml, Luer Lock.



Tamanhos: 1, 3, 5, 10, 20 e 60ml,
Luer Lock



Seringa Dosadora Oral – Linha Hospitalar

A Seringa Dosadora Oral é indicada para dosagem exata dos medicamentos, proporcionando mais doses por frascos, auxilia na preparação e administração de medicamentos, proporcionando maior comodidade e segurança para o paciente. Apresenta alto grau de precisão em sua graduação. Disponível na cor azul. Confeccionado em plástico atóxico que não interage com o medicamento. Apresenta tampa que evita a contaminação. Acompanha adaptador universal confeccionado em borracha termoplástica atóxica, inerte e flexível adaptando-se aos bocais de diversos diâmetros. Embalagem a granel. Graduações: 3 ml, 5 ml e 10 ml.

Jeringa de Dosificación Oral - Línea Hospitalaria

La Jeringa de Dosificación Oral está indicada para la dosificación exacta de la medicación, proporcionando más dosis por vial, ayuda a la preparación y administración de los medicamentos, proporcionando una mayor comodidad y seguridad para el paciente. Presenta un alto grado de precisión en su graduación. Disponible en color azul. Hecho en plástico no tóxico, que no interactúa con los fármacos. Cuenta con cubierta que evita la contaminación. Incluye adaptador universal hecho de un caucho termoplástico no tóxico que es inerte y flexible, adaptándose a las diversas boquillas de diámetros. Embalaje a granel. Graduaciones: 3 ml, 5 ml e 10 ml.

A Seringa Dosadora Oral apresenta bico arredondado que não fere a boca, e anel de retenção que impede o desprendimento livre do pistão.

La jeringa dosificadora oral presenta una boquilla redondeada que no hiere la boca, y anillo de retención que impide el desprendimiento libre del piston.



Adaptador
Universal



Agulha para Aspiração

As agulhas de aspiração são indicadas para os procedimentos de preparo de medicamentos evitando o uso da agulha que será utilizada para realizar a aplicação. A agulha de aspiração foi projetada para ser utilizada com seringas hipodérmicas através de uma conexão luer slip ou lock. A agulha não apresenta o bisel trifacetado e sim um bisel simples com corte diferenciado que evita a retirada de "fragmentos de borracha" das tampas dos frascos ampolas, típico quando da utilização de agulhas hipodérmicas com bisel trifacetado. Esterilizadas a Óxido de Etileno, em embalagens individuais, validade de 5 anos em embalagem intacta. Disponíveis em vários calibres para atender aos diferentes tipos de procedimentos.

Disponível nos calibres: 25x1,2 e outros sob consulta.

Agujas de Aspiración

Las agujas de aspiración están indicadas para los procedimientos de preparación de medicamentos, evitando el uso de la aguja que será utilizada para la aplicación. La aguja de aspiración fue diseñada para ser utilizada con jeringas hipodérmicas mediante una conexión luer slip o luer lock. La aguja no presenta bisel trifacético, sino un bisel simple con un corte diferenciado que evita la extracción de "fragmentos de goma" de los tapones de los frascos ampolla, lo cual es típico al utilizar agujas hipodérmicas con bisel trifacético. Esterilizadas con óxido de etileno, en envases individuales, con una validez de 5 años en empaque intacto. Disponibles en varios calibres para atender los diferentes tipos de procedimientos.

Disponible en los calibres: 25x1,2 y otros bajo consulta.



INJEX

Agulha Hipodérmica

Agulhas Hipodérmicas, estéreis, atóxicas, apirógenas, apresentam canhão que permitem a perfeita conexão na seringa. Padrão universal de cores para identificação dos calibres, com cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, siliconizado para perfeito e suave deslize.

Esterilizadas a Óxido de Etileno, em embalagens individuais, validade de 5 anos em embalagem intacta. Disponíveis em vários calibres para atender aos diferentes tipos de procedimentos.

Disponível nos calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 e outros sob consulta.

Aguja Hipodérmica

Las agujas Hipodérmicas, estéril, no tóxico, no pirógenos, presenta um cañon que permite la perfecta conexión con la jeringa. Colores estándares universales para la identificación de los indicadores, con cânula de acero inoxidable, bisel con três facetas, siliconado para el deslizamiento perfecto y suave.

Esterilizadas com Oxido de Etileno, en paquetes individuales, con 5 años de validez con el embalaje intacto. Disponible en diferentes calibres con el fin de asistir a los diferentes tipos de procedimientos.

Disponibles en calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 y otros bajo demanda.



Agulha Hipodérmica
Diversos Calibres

Agulha Hipodérmica com Dispositivo de Segurança (Safety)

Agulhas com Dispositivo de Segurança minimizam os acidentes com perfurocortantes. Treinamento rápido e prático, sem mudança de rotina do profissional, revolucionando o descarte de agulhas, proporcionando segurança no descarte e na sua inutilização. Adaptável nas seringas Luer Lock, Luer Slip e de fácil manuseio.

Disponível nos calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 e outros sob consulta.

Aguja Hipodérmica con Dispositivo de Seguridad (Safety)

Agujas con Dispositivo de Seguridad minimiza los accidentes con materiales punzocortantes. Formación rápida y práctica, sin ningún cambio en la rutina de trabajo, revolucionando la eliminación de las agujas, proporcionando seguridad en la eliminación e la destrucción. Se adapta a jeringas Luer Lock y Luer Slip y de facil manejo.

Disponibles en calibres: 13x0,38; 13x0,45; 20x0,55; 25x0,60; 30x0,70; 25x0,70; 30x0,80; 25x0,80; 40x1,2 y otros bajo demanda.



Agulha Hipodérmica com
Dispositivo de Segurança

Cateter Intravenoso com Dispositivo de Segurança Injex Cath

Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança. Indicado na terapia intravenosa para infusões de média duração.

Dispositivo confeccionado em Poliuretano, radiopaco, com conector Luer Lock, de uso único, estéril, embalado unitariamente, apresentando calibres:

14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G, e 24 G.

O cateter Injex Cath possibilita uma punção suave com mínimo trauma, fácil visualização do sangue. Seu sistema de segurança impede a recolocação do bisel no cateter quando acionado, reduzindo significativamente o risco de infecção e proporcionando um descarte seguro e eficaz.

Catéter Intravenoso con Dispositivo de Seguridad - Injex Cath

Cateter intravenoso periférico con dispositivo de seguridad. Indicado en el tratamiento intravenoso para infusiones duración media.

Dispositivo hecha de poliuretano, radiopaco, con conector Luer Lock, de un solo uso; estéril, empaquetados unitariamente, presentación de calibres:

14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G, e 24 G.

El cateter Injex Cath permite una punzada suave trauma mínimo y con fácil verificación de la sangre. Su sistema de seguridad impide la recolocación del bisel en el catéter cuando accionado, reduciendo significativamente el riesgo de infección, y proporcionar una eliminación segura y eficaz.



Cateter com Dispositivo de Segurança

Cateter Intravenoso Injex Cath

Cateter intravenoso periférico, indicado na terapia intravenosa para infusões de curta duração.

Dispositivo confeccionado em teflon, radiopaco, com conector Luer Lock, de uso único, estéril, embalado unitariamente, apresentando calibres:

14G, 16G, 18G, 20G, 22G e 24G.

O material do cateter (teflon) se adapta as paredes internas das veias causando menos dor e desconforto ao paciente. Por ser indicado para infusões de curto prazo, é recomendado que o cateter seja substituído a cada 72 horas.

Catéter Intravenoso Injex Cath

Catéter intravenoso periférico, indicado en terapia intravenosa para infusiones a corto plazo.

Dispositivo fabricado en teflón, radiopaco, con conector Luer Lock, de un solo uso, estéril, envasado individualmente, con calibres:

14G, 16G, 18G, 20G, 22G y 24G.

El material del catéter (teflón) se adapta a las paredes internas de las venas causando menos dolor e incomodidad al paciente. Como está indicado para infusiones de corta duración, se recomienda cambiar el catéter cada 72 horas.



Cateter Intravenoso

Luvas Cirúrgicas

A Luva Cirúrgica - Injex é indicada para a proteção das mãos de profissionais da saúde em geral (médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares, etc.) durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas e/ou situações que apresentem riscos de contaminação decorrentes à exposição ao sangue, para proteção das mãos do cirurgião e de seus assistentes, e/ou em outros procedimentos onde sejam recomendadas a proteção com luvas cirúrgicas.

A Luva Cirúrgica - Injex além de garantir a assepsia do procedimento, protege o profissional que está utilizando, de possíveis contaminações bacterianas, viróticas e parasitárias. Atuam reduzindo ou eliminando o risco de contaminação do usuário, funcionando como uma barreira mecânica a secreções sanguíneas e fluidos.

Tamanhos disponíveis: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 e 8,5

Guantes Quirúrgicos

El Guante Quirúrgico - Injex está indicado para la protección de las manos de los profesionales de la salud en general (médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, auxiliares, etc.) durante procedimientos quirúrgicos en hospitales, consultorios y clínicas, y/o en situaciones que presenten riesgos de contaminación por exposición a la sangre, para proteger las manos del cirujano y de sus asistentes, y/o en otros procedimientos donde se recomiende el uso de guantes quirúrgicos.

El Guante Quirúrgico - Injex, además de garantizar la asepsia del procedimiento, protege al profesional que lo utiliza contra posibles contaminaciones bacterianas, virales y parasitarias. Actúa reduciendo o eliminando el riesgo de contaminación del usuario, funcionando como una barrera mecánica frente a secreciones sanguíneas y fluidos.

Tamaños disponibles: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 y 8,5.



Luva de Procedimento

Disponível em látex levemente talcada. Não estéril. As luvas de procedimentos Injex estão classificadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do profissional em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, fluidos corporais, membranas, mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos.

Para procedimentos não cirúrgicos, uso único, individual e não deve ser reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras.

Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível

Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).

Tamanhos disponíveis: PP, P, M, G

Guante de Procedimiento

Disponible en látex ligeramente talcado. No estéril. Las guantes de procedimientos Injex se clasifican para la protección profesional de la salud en los procedimientos no invasivos. Son adecuados para la protección del profesional durante procedimientos médicos y de enfermería. Usar guantes siempre que exista una posibilidad de contacto con sangre, fluidos corporales, membranas, mucosas, artículos sucios o procedimientos no invasivos.


Para procedimientos no quirúrgicos, uso único, individual y por procedimiento, no debe ser reprocesado. Anatómica, no estériles y ambidiestro.

Composición: Látex natural, ligeramente adherida con polvo absorbible

Caja dispensadora con 100 unidades cada una (50 pares).

Tamaños disponibles: PP, P, M, G

Látex de Borracha Natural

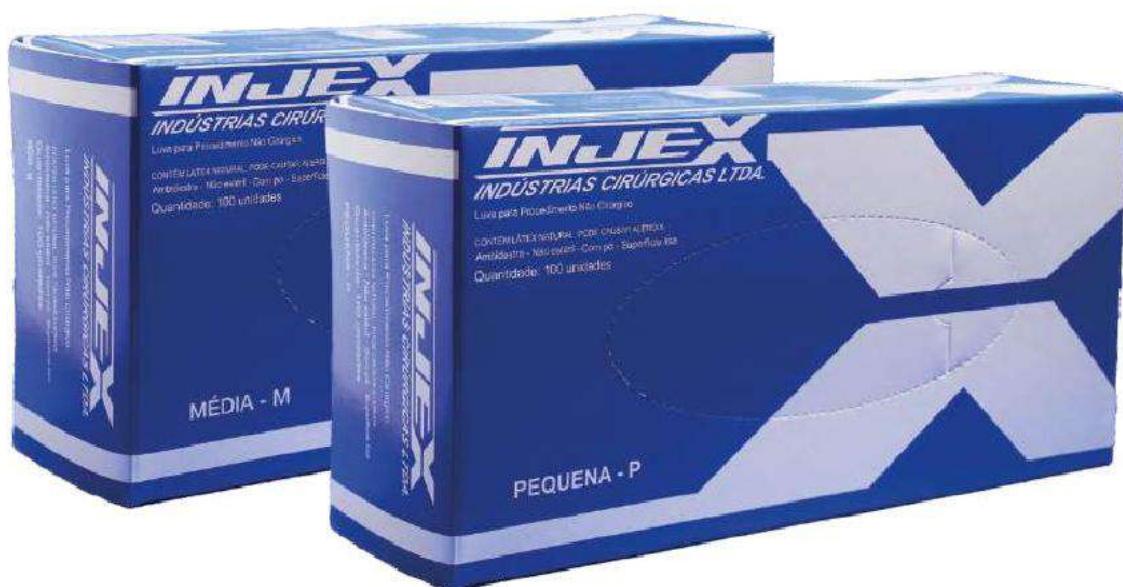

Luva de Procedimento



Torneira de Três Vias

Torneira de Três Vias indicada no auxílio do acesso venoso de média e longa permanência, para administração de soluções e/ou medicamentos. Descartável, atóxica, apirogênica e esterilizada a Óxido de Etileno, com conexão universal, na apresentação Luer Lock ou Luer Slip.

Manípulo com rotação de 360 graus e com indicação de fluxo, corpo translúcido em policarbonato.

Embaladas individualmente, com validade de 5 anos com a embalagem intacta.

Llave de Tres Vías

Llave de Tres Vías, indicada como ayuda de un acceso venoso de permanência a mediano y largo tiempo, y para la administración de soluciones y o medicamentos. Desechable, no tóxico, no pirogénico, esterilizado por Oxido de Etileno, con conexión universal, con presentaciones en Luer Lock ou Luer Slip.

Con un manípulo con rotación de 360 grados y la indicación de flujo, cuerpo translúcido de policarbonato.

Empaquetado individualmente, com 5 años de validez com el embalaje intacto.



Torneira de 3 Vias

Infusor Múltiplo para Administração Simultânea de Soluções

É indicado para possibilitar a administração de várias drogas ao mesmo tempo, através de sistemas de acesso intravenoso parenteral em procedimentos que exigem essa condição. Esse dispositivo facilita o trabalho do profissional de saúde assim como, possibilita uma maior qualidade de atendimento ao paciente pois com apenas um acesso venoso torna-se possível administrar vários fluidos ao mesmo tempo.

Infusor para Multiples Soluciones Simultáneas

Se tiene la intención de facilitar la administración de diversos medicamentos al mismo tiempo, através de sistemas de acceso intravenosa parenteral en procedimientos que requieren esta condición. Este dispositivo facilita el trabajo profesional de la salud, así como proporciona una mayor calidad de la atención al paciente, porque sólo con um acceso venoso se hace posible administrar varios fluidos al mismo tiempo.



Infusor de 2 Vias

Equipo de Infusão Gravitacional

O Equipo de Infusão Gravitacional é indicado para administração de soluções parenterais. Trata-se de um produto destinado aos profissionais da área médico hospitalar devidamente treinados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso. Esterilizados à Óxido de Etileno em embalagens individuais, com a validade de 5 anos com a embalagem intacta.

Disponíveis em diversos modelos para atender as diversas necessidades de procedimentos, com 1,5 metros de extensão.

Equipo de Infusion Gravitacional

El Equipo de Infusion Gravitacional está indicado para la administración de soluciones parenterales. Es un producto diseñado para los profesionales del área hospitalaria médica que han sido debidamente capacitados y familiarizados con las técnicas y los procedimientos que implican su uso. Esterilizado a Óxido de Etileno en paquetes individuales, 5 años de validez con el paquete intacto. Disponible en diferentes diseños con el fin de satisfacer las diversas necesidades de los procedimientos, 1,5 metros de largo.



Equipo de Infusão Gravitacional

Equipo Enteral

O Equipo para Nutrição Enteral - Injex é indicado para a administração de soluções enterais, realizando a ligação entre a sonda de alimentação enteral, ligada ao paciente, ao recipiente de solução, frasco ou bolsa, que contém o alimento a ser administrado.

O produto se restringe ao uso médico hospitalar devendo ser usado por profissionais da área médica.

Equipo Enteral

El Equipo para Nutrición Enteral - Injex está indicado para la administración de soluciones enterales, realizando la conexión entre la sonda de alimentación enteral, conectada al paciente, y el recipiente de la solución, frasco o bolsa, que contiene el alimento a ser administrado.

El producto está destinado exclusivamente al uso médico-hospitalario y debe ser utilizado por profesionales del área de la salud.



Equipo Enteral

Scalp com Dispositivo de Segurança

O Scalp com Dispositivo de Segurança Injex Safety é utilizado em procedimentos que necessitam de acesso venoso para administração de medicamentos ou soluções parenterais e coleta sanguínea convencional.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp com Dispositivo de Seguridad

El Scalp con dispositivo de seguridad INJEX se utiliza en los procedimientos que requieren acceso venoso para la administración de medicamentos y soluciones parenterales y recolección de sangre convencional.

Conserva sus características y funcionalidad para el uso de una sola vez y deben ser desechados después de su uso, el producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.

Scalp Intravenoso Periférico Injex

O Scalp Intravenoso Periférico Injex é utilizado em procedimentos que necessitam de acesso venoso para administração de medicamentos ou soluções parenterais.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp Intravenoso Periférico Injex

El Scalp Intravenoso Periférico Injex se utiliza en procedimientos que requieren un acceso venoso para la administración de fármacos o soluciones parenterales.

Conserva sus características y funcionalidad para un solo uso, debiendo desecharse tras su uso, es decir, un producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.



Scalp com Dispositivo
de Segurança



Scalp Intravenoso
Periférico



Embalagem para Esterilização

As embalagens para esterilização são indicadas para embalar artigos médicos, hospitalares e odontológicos a serem submetidos ao processo de esterilização por Vapor e Óxido de Etileno. As embalagens apresentam a finalidade de conservar a integridade microbiológica dos materiais esterilizados até o momento de sua utilização, mantendo suas propriedades de forma conveniente para o usuário. Embalagem para esterilização tipo Pouch em Bobina, em que o usuário pode cortar a bobina no tamanho adequado para embalar o produto a ser esterilizado. Após a selagem, o produto lacrado pode seguir o procedimento de esterilização. A bobina possui impressões com tinta especial que mudam de cor após passar por determinado processo de esterilização.

Embalaje para Esterilización

Los paquetes para la esterilización son adecuados para el envasado médico, hospitalarios y dispositivos dentales para ser sometido al proceso de esterilización por Vapor y Oxido de Etileno. El paquete está destinado a preservar la integridad microbiológica de los materiales esterilizados hasta el momento de su uso, manteniendo sus propiedades convenientemente para el usuario. Embalajes para la bolsa de esterilización tipo carrete, en la que el usuario puede cortar la bobina a medida para el embalaje del producto a esterilizar. Después del sellado, el producto puede seguir el procedimiento de esterilización. La bobina tiene impresiones con tinta especial que cambian de color después de pasar por determinado proceso de esterilización.



Pouch Bobina
(Dois lados
termo selados e
dois lados termo
selantes)

Bobinas com
comprimento de
100m. Largura
variando de 120,
150, 200, 250,
300 e 400 mm

Embalagens para
Esterilização - Bobina

Eletrodo ECG Descartável

O Eletrodo ECG Descartável para Monitoração Cardíaca – Injex é indicado para o registro da atividade cardíaca mediante o emprego de um eletrocardiógrafo. Possibilita a condução da corrente elétrica do aparelho e a leitura do ECG dos pacientes.

Deve ser utilizado em repouso, com a pele preparada para a correta aplicação. Sua função é ser o intermediário entre o paciente e o aparelho de monitorização cardíaca, possibilitando a condução da corrente elétrica e a leitura do ECG do paciente. Possui um adesivo em sua base para ser fixado à pele do paciente, gel condutor, e o eletrodo que conecta o aparelho ao corpo do paciente.

Electrodo ECG Descartable

El Electrodo ECG Descartable para Monitoreo Cardíaco – Injex está indicado para el registro de la actividad cardíaca mediante el uso de un electrocardiógrafo. Permite la conducción de la corriente eléctrica del equipo y la lectura del ECG de los pacientes.

Debe ser utilizado en reposo, con la piel previamente preparada para una correcta aplicación. Su función es actuar como intermediario entre el paciente y el equipo de monitoreo cardíaco, permitiendo la conducción de la corriente eléctrica y la lectura del ECG del paciente. Cuenta con un adhesivo en su base para fijarse a la piel del paciente, gel conductor y el electrodo que conecta el equipo al cuerpo del paciente.



Eletrodo ECG
Descartável

Esparadrapo Impermeável

O Esparadrapo Impermeável Injex é indicado para fixação de curativos e ataduras. Possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, cateteres, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, etc. Possui um alto desempenho em fixação sendo muito resistente. É flexível e impermeável. É composto de tecido 100% algodão tratado para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento e adesivo acrílico isento de látex. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais prático e econômico. É comercializado em rolos plásticos com ou sem capa protetora, disponível na cor branca e na forma não estéril. Pode ser encontrado nas seguintes dimensões: 10cm x 4,5m; 5cm x 4,5m; 2,5cm x 4,5m; 1,2cm x 4,5m e 2,5cm x 90cm.

Esparadrapo Impermeable

La cinta adhesiva impermeable Injex está indicada para fijar apósitos y vendajes. Tiene una amplia gama de usos en el entorno hospitalario, como la fijación de apósitos, sondas, catéteres, drenajes, dispositivos de infusión intravenosa, vendajes, etc. Ofrece una fijación de alto rendimiento y es muy resistente. Es flexible e impermeable. Está compuesta de tejido 100 % algodón tratado para facilitar el desgarro sin deshilacharse y adhesivo acrílico sin látex. Sus bordes dentados permiten un corte bidireccional sin necesidad de herramientas, lo que la hace más práctica y económica. Se vende en rollos de plástico con o sin cubierta protectora, disponible en color blanco y en versión no estéril. Está disponible en las siguientes dimensiones: 10 cm x 4,5 m; 5 cm x 4,5 m; 2,5 cm x 4,5 m; 1,2 cm x 4,5 m y 2,5 cm x 90 cm.



*Esparadrapo
Impermeável*

☐ Branco

Máscara Tripla Camada

A Máscara Tripla Camada é utilizada para proteção do usuário durante procedimentos, evitando a contaminação cruzada e exposição a fluídos. Tem como finalidade proteger os profissionais da área da saúde e pacientes, impedindo a passagem de aerodispersóides e bactérias, durante procedimentos médicos, odontológicos e cirúrgicos. Composta por três camadas: 1ª camada: polipropileno não tecido (camada externa), 2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) - (camada do meio) e 3ª camada: polipropileno não tecido (camada interna).

Máscara de Triple Capa

La máscara de triple capa se utiliza para proteger al usuario durante los procedimientos, evitando la contaminación cruzada y la exposición a fluidos. Su finalidad es proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes, impidiendo el paso de aerodispersoides y bacterias durante los procedimientos médicos, odontológicos y quirúrgicos. Compuesto por tres capas: 1ª capa: polipropileno no tejido (capa exterior), 2ª capa: papel filtro soplado en fusión (BFE: $\geq 95\%$) - (capa intermedia) y 3ª capa: polipropileno no tejido (capa interior).



Máscara
Tripla Camada

Touca Descartável

A Touca Descartável – Injex é indicada para proteção do usuário em procedimentos que exigem controle de contaminação, sendo amplamente utilizada em ambientes hospitalares, clínicos, laboratoriais, industriais e alimentícios. Confeccionada em não tecido 100% polipropileno pelo processo SPP ou SMS, oferece boa resistência mecânica, conforto e excelente barreira contra agentes contaminantes. É de uso único, não esterilizável e não reutilizável, ideal para cobrir os cabelos e proteger tanto o ambiente quanto o paciente.

Gorro Desechable

El Gorro Desechable – Injex está indicado para la protección del usuario en procedimientos que requieren control de contaminación, siendo ampliamente utilizado en entornos hospitalarios, clínicos, laboratoriales, industriales y alimentarios. Confeccionado en tejido no tejido 100% polipropileno mediante el proceso SPP o SMS, ofrece buena resistencia mecánica, comodidad y una excelente barrera contra agentes contaminantes. Es de un solo uso, no esterilizable y no reutilizable, ideal para cubrir el cabello y proteger tanto el entorno como al paciente.



Touca Descartável



Sonda Foley Injex


A Sonda Foley Injex é indicada para o tratamento de distúrbios urinários ou nos casos em que o médico necessita de um controle mais rigoroso da diurese. A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo e dependerá da anatomia do paciente. É confeccionada em látex de borracha natural siliconizado, superfície lisa e com textura macia, possui balão com diferentes capacidades de enchimento.

Conector universal para sistema de escoamento de urina, permitindo a adaptação com qualquer tipo de bolsa coletora de urina. Possui diferentes tamanhos para cada necessidade, reduzindo assim os riscos de lesões na uretra e falha nos tratamentos. São diferenciados pela cor presente na ponta do funil de enchimento, além disto também estão indicados o tamanho em french (Fr) e a capacidade de enchimento do balão em mililitro (mL).

Sonda Foley Injex

La Sonda Foley Injex está indicada para el tratamiento de trastornos urinarios o en los casos en que el médico necesite un control más estricto de la diuresis. La indicación de cada tamaño específico es responsabilidad del profesional legalmente habilitado para utilizar el dispositivo y dependerá de la anatomía del paciente. Está hecho de látex de caucho natural siliconado, tiene una superficie lisa y una textura suave, tiene un globo con diferentes capacidades de llenado.

Conector universal para sistema de drenaje de orina, que permite la adaptación a cualquier tipo de bolsa de recogida de orina. Tiene diferentes tamaños para cada necesidad, reduciendo así el riesgo de lesión de la uretra y fracaso del tratamiento. Se diferencian por el color presente en la punta del embudo de llenado, además, también se indica el tamaño en french (Fr) y la capacidad de llenado del globo en mililitros (mL)

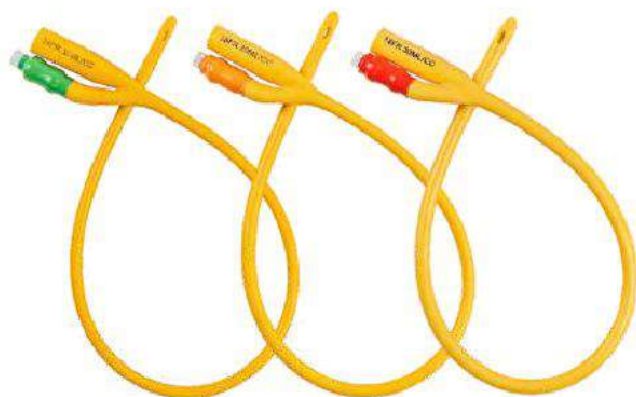

Sonda Foley

Bolsa Coletora de Urina

A Bolsa Coletora de Urina - Injex é destinada para coleta, armazenamento, drenagem e monitoramento do volume urinário de pacientes em unidades de saúde, hospitais e clínicas.

A Bolsa Coletora de Urina - Injex é utilizada para coleta de urina em pacientes que possuem incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há a necessidade de esvaziamento da bexiga. O dispositivo é conectado à sonda previamente introduzida no paciente, recebendo e armazenando a urina drenada do mesmo.

Bolsa Colectora de Orina

La Bolsa Colectora de Orina - Injex está destinada a la recolección, almacenamiento, drenaje y monitoreo del volumen urinario de pacientes en unidades de salud, hospitales y clínicas.

La Bolsa Colectora de Orina - Injex se utiliza a la recolección de orina en pacientes con incapacidad para orinar, con incontinencia urinaria o sometidos a procedimientos quirúrgicos que requieren el vaciado de la vejiga. El dispositivo se conecta a la sonda previamente introducida en el paciente, recibiendo y almacenando la orina drenada del mismo.



Bolsa Coletora de Urina

Seringa Dosadora Oral - Linha Farmacêutica

A Seringa Dosadora Oral é indicada para dosagem exata dos medicamentos, proporcionando mais doses por frascos. Utilizada pela indústria farmacêutica para facilitar a administração de medicamentos em crianças e idosos.

Disponível na cor azul ou incolor. A Seringa Dosadora Oral apresenta bico arredondado que não fere a boca, e anel de retenção que impede o desprendimento livre do êmbolo.

Confeccionada em plástico atóxico que não interage com o medicamento. Apresenta tampa que evita a contaminação do medicamento quando exposto.

Pode ser embalada individualmente das seguintes formas: Sem adaptador, com Adaptador embalado ao lado e com Adaptador acoplado no bico da seringa. O cilindro pode ser personalizado ou não.

Jeringa de Dosificación Oral - Línea Farmaceutica

La Jeringa de Dosificación Oral es adecuada para la dosificación exacta de drogas, proporcionando más dosis por vial. Utilizados por la industria farmacéutica para facilitar la administración de medicamentos en niños y ancianos.

Disponible en color azul o incoloro. Presenta color de cilindro azul o incoloro.

La jeringa de dosificación oral ha boquilla redondeada que no hace daño a la boca y tiene el anillo de retención que impide la liberación libre del émbolo.

Hecho en plástico no tóxico no interactuar con el medicamento. Una cubierta evita contaminaciones de la droga cuando se expone.

Puede ser empaquetada unitariamente de las siguientes maneras: Sin adaptador, con adaptador empaquetado en el lateral y con adaptador acoplado a la boquilla de la jeringa. El cilindro puede ser personalizado o no.



Seringa Dosadora Oral

Adaptador Farmacêutico

Confeccionado em polímeros atóxicos e inertes, em diversos tamanhos que correspondem ao diâmetro dos frascos e vidros utilizados para o envase de medicamentos.

Além de adaptar-se à Seringa Dosadora Oral, o adaptador minimiza a possibilidade de perda por derramamento acidental de medicamentos.

Disponíveis em cinco tamanhos, com diâmetros de 11, 16, 19, 22, e 26mm. Embalados à granel ou com a Seringa Dosadora Oral em embalagem BOPP.

Adaptador Farmaceutico

Hecho de polímeros no tóxicos e inertes, en varios tamaños que se corresponden con el diámetro de las botellas y vidrio utilizados para el envasado de medicamentos.

Además de adaptarse a Jeringa de Dosificación Oral, el adaptador minimiza la posibilidad de perda debido a derrames accidentales de dogras.

Disponible en cinco tamaños con diámetros de 11, 16, 19, 22 y 26mm. Embalados a granel o con la Jeringa de Dosificación Oral em paquetes de BOPP.



Adaptador Farmacêutico

Agulha Gengival

Especialmente projetada para aplicações de anestésicos e outros produtos de uso exclusivo odontológico. Agulhas gengivais estéreis, descartáveis, atóxicas e apirogênicas, possuem bisel trifacetado e cânula siliconizada que permitem maior conforto e suavidade em sua penetração.

A cânula altamente flexível, com bisel em ângulo curto, faz com que a agulha penetre no tubete sem que ocorra retenção de borracha, que causa entupimento.

Permite ao profissional maior agilidade sem ocorrer a quebra da cânula. Canhão apresenta rosca interna que permite conexão aos diversos modelos de seringas de carpule. Validade de 5 anos com embalagem intacta. Disponível em calibre 30 G (15x0,30, 22x0,30, 30x0,30mm) e 27 G (22x0,40, 30x0,40mm), conforme ISO 7885.

Aguja Gingival

Está especialmente diseñado para las aplicaciones de anestésicos y otros productos de uso exclusivo odontológico. Agujas gingivales estériles, atóxicas y apirógenicas presentando bisel trifacetado y la cânula con silicona, proporcionando un mayor confort y suavidad en su penetración.

La cânula muy flexible, con bisel de ángulo corto hace que la aguja para introducir el cartucho sin ninguna retención de goma que causa la obstrucción.

Permite al usuário uma maior agilidade sem que se produzir a rotura da cânula. El caño tiene rosca interna que permite la conexión a diversos tipos de jeringas de carpule. 5 años de validez con el paquete intacto. Disponible en calibres 30 G (15x0,30, 22x0,30, 30x0,30mm) e 27 G (22x0,40, 30x0,40mm), de conformidad con la norma ISO 7885.

Agulha de Irrigação

Agulhas especiais para uso odontológico, facilitando os procedimentos de irrigação.

Agulhas sem bisel, esterilizadas a Óxido de Etileno, embaladas individualmente, com validade de 5 anos em embalagem intacta.

Apresenta os calibres: 25x0,80, 25x0,70, 25x0,60, 25x0,40 e 25x0,30mm.

Aguja de Irrigacion

Agujas especiales para uso odontológico, que hace que los procedimientos de riego más fácil.

Agujas sin bisel esterilizados con Óxido de Etileno, embaladas individualmente, con 5 años validez con el embalaje intacto.

Presenteado en los calibres: 25x0,80, 25x0,70, 25x0,60, 25x0,40 y 25x0,30mm.



Agulha Gengival



Agulha de Irrigação



Kit para Monitoramento de Glicose
no Sangue Injex Sens



Glicosímetro Injex Sens II Plus

Sistema de monitoramento de glicose no sangue através de uma tira reagente (tecnologia Bio Sensor).

Aparelho com escala de medição de 10 a 600mg/dL, sistema aferido para permitir medição de glicemia em amostra de sangue capilar.

O volume de amostra é de 0,5 µl de sangue capilar fresco, o resultado do exame é dado em 5 segundos.

O método de análise é eletroquímico e deve ser usado com a tira reagente Injex Sens.

Monitoramento eficiente da diabetes com símbolos de marcação.

Apresenta capacidade de memória de 1000 exames com data e hora, oferece sistema de monitoramento através de software que possibilita a interação médico-paciente com maior controle, segurança e eficiência, permitindo que o paciente envie via internet seus registros ao seu médico.

Possui 2 baterias de Lítio.

O medidor possui ejetor de tira que possibilita o descarte da mesma de forma segura e higiênica, sem contato com as mãos.

Glucómetro Injex Sens II Plus

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre a través de una tira reactiva (tecnología Bio Sensor).

Dispositivo con escala de medición de 10 a 600 mg / dl, sistema medido para permitir la medición de la glucosa en una muestra de sangre capilar.

El volumen de muestra es de 0,5 ul de sangre capilar fresca, con un resultado en 5 segundos.

El método de análisis es electroquímico y debe usarse con la tira Injex Sens.

Monitoreo eficaz de la diabetes con símbolos de marcado.

Con una capacidad de memoria de 1000 exámenes con fecha y hora, ofrece sistema de monitoreo a través de software que posibilita la interacción médico-paciente con mayor control, seguridad y eficiencia, permitiendo que el paciente envíe por internet sus registros a su médico.

Tiene 2 baterías de Litio.

El medidor tiene un ejetor de tira que posibilita el descarte de la misma de forma segura e higiénica, sin contacto con las manos.



Glicosímetro

Tira de Teste de Glicose no Sangue Injex Sens

Tira reagente para determinação de glicose através do Glicosímetro da linha Injex Sens. Codificada através de uma enzima que ao contato com uma corrente elétrica do medidor converte o sinal obtido numa leitura numérica apresentando o resultado final do exame. Sua sensibilidade analítica é de 10 a 600 mg/dL e sua especificidade é Glicose Oxidase. Necessário apenas 0,5 µl (microlitros) de amostra sanguínea, e aspira o sangue instantaneamente.

Tira de Prueba de Glucosa en Sangre Injex Sens

Tira reactiva para la determinación de glucosa por Injex SENS Glucómetros. Codificada através de una enzima, que en contacto con una corriente eléctrica del dispositivo convierte la señal obtenida a partir de una lectura numérica se presentan el examen final. Su sensibilidad analítica es 10 a 600 mg/dl y su especificidad es Glucosa Oxidasa. Se necesita sólo 0,5 µl (microlitros) de muestra de sangre y aspira la sangre instantáneamente por capilaridad.



Tira Reagente

Lancetador

Dispositivo para auxílio e obtenção de amostras de sangue capilar para testes sanguíneos, deve ser utilizado apenas com as lancetas Injex. Permite uma punção indolor, fácil e rápida. Apresenta dez níveis de ajuste de penetração adequando-se a textura da pele individualmente.

A ativação por contato proporciona segurança, precisão e rapidez em sua punção. Possui dispositivo de extração/ejeção da lanceta trazendo mais segurança em seu descarte. Ativação do lancetador é demonstrada através da identificação de cor.

Dispositivo de punción

Dispositivo para ayudar y obtener muestras de sangre capilar para análisis, que debe ser usado con las lancetas Injex. Se permite una punción indolora, fácil y rápido. Presenta diez niveles de ajuste de penetración adecuando la textura de la piel individualmente.

La activación por contacto proporciona seguridad, precisión y velocidad en la punción, permitiendo su eliminación segura.

Posee dispositivo de extracción de la lanceta trayendo más seguridad en su descarte. La activación del lancetador se demuestra mediante la identificación de color.



Lancetador

Lanceta Hipodérmica

A Lanceta Hipodérmica Injex foi projetada para ser utilizada com um lancetador que irá facilitar a punção para a coleta de amostra de sangue capilar.

A Lanceta apresenta bisel siliconizado que permite rápida punção do local escolhido para retirada de amostra de sangue quando utilizado com o lancetador.

Disponível no calibre: 30G 2,0x0,30mm.

Lanceta Hipodérmica

La lanceta hipodérmica Injex está diseñada para usarde con un dispositivo de punción que facilitará la punción para la toma de muestras de sangre capilar.

La lanceta tiene un bisel siliconizado que permite una punción rápida del sitio elegido para tomar una muestra de sangre cuando se usa con el dispositivo de punción.

Disponible en calibre: 30G 2,0x0,30mm.

Lanceta com Dispositivo de Segurança

Dispositivo para coleta de sangue capilar com sistema de disparo e retração da lanceta automaticamente. Dispositivos estéreis, apirrogênicos e atóxicos, de uso para testes sanguíneos capilares.

Disponível no calibre 28 G 1,5x0,36 mm.

Lanceta con Dispositivo de Seguridad

Dispositivo colector de sangre capilar, con descarga automática y sistema de lanceta con retracción. Los productos no tóxicos y no pirógenos y esteriles, utilizados para pruebas sanguíneas capilares.

Disponible en 28G 1,5x0,36mm.



Lanceta



Lanceta com
Dispositivo de Segurança

DIABETES - Agulha / Seringa

Agulha para Caneta de Aplicação de Insulina

Agulhas indicadas para uso em canetas apropriadas para aplicação de injeção subcutânea, principalmente de insulinas.

Compatível com as canetas existentes no mercado, proporcionando adaptação e conexão segura.

As agulhas são siliconizadas o que proporciona maior conforto no momento da aplicação. Indicadas para crianças, adolescentes e adultos, apresentam protetor interno de agulha que protege o bisel e protetor externo que garante a esterilidade da agulha até a retirada do lacre. Embalagens em caixas com 100 unidades nos calibres mais utilizados, como os de 4,0x0,23; 5,0x0,25; 8,0x0,25 e 12,7x0,33mm e outros sob consulta.

Aguja para la Pluma de Aplicación de Insulina

Agujas indicados para uso en plumas adecuadas para la aplicación de la inyección subcutánea, especialmente las inyecciones de insulina.

Compatible con las plumas en el mercado, lo que permite la adaptación y conexión seguros con la pluma.

Las agujas son siliconado, proporcionando una mayor comodidad durante la aplicación. Adecuadas para niños, adolescentes y adultos, presenta un protector interno que protege el bisel y un protector externo que asegura la esterilidad de la aguja hasta la eliminación de la lacre. Embalaje en cajas con 100 unidades en los calibres más utilizados tales como 4,0x0,23; 5,0x0,25; 8,0x0,25 e 12,7x0,33mm y otros bajo demanda.



Agulha
para Caneta

Seringa 1mL para Insulina U-100 com ou sem Agulha Acoplada

Seringas hipodérmicas de insulina com agulha desconectável, uso único, atóxica, esterilizada a Óxido de Etileno, com validade de 5 anos em embalagem intacta, embaladas individualmente.


Possui alto grau de precisão em sua escala de graduação com intervalos de 10 em 10UI com subdivisão de 2 em 2 UI com volume total de 1mL - 100UI. Possui bico Luer Slip.

Jeringa 1mL para Insulina U-100 con ou sin Aguja Acoplada

Jeringas hipodérmicas de la insulina con aguja desmontable, de un solo uso, no toxico, estéril con Oxido de Etileno, una validez de 5 años con el paquete intacto, empaquetados individualmente.

Presenta un alto grado de precisión en su escala de graduación intervalos de 10 a 10UI con una subdivisión de 2-2 UI con volumen total de 1mL - 100UI. Se tiene la sonda Luer Slip.

BICO LUER SLIP

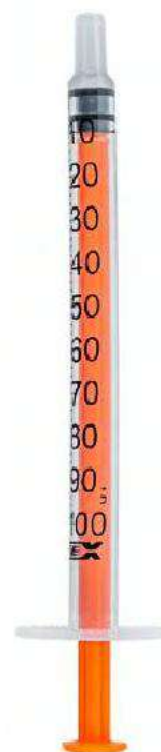

1mL



Seringa para Insulina U-100 (0,5mL e 1mL com Agulha Fixa Stilly Line)

Seringas de Insulina Stilly Line, de 0,5mL e 1mL, com agulha fixa longa e curta. Estéreis, atóxicas, apirrogênicas, livres de látex, descartáveis e de uso único. Volume nominal de 100UI (1ml) com intervalo de 10 em 10UI e subdivisão de 2 em 2UI e volume nominal de 50UI (0,5mL) com intervalos de 5 em 5UI e subdivisão de 1 em 1UI. Fácil leitura de graduação, residual zero, com agulha trifacetada e siliconizada em toda sua extensão.

Jeringa para Insulina U-100 (0,5mL e 1mL com AguJa Fija Stilly Line)


Jeringas de Insulina Stilly Line, de 0,5mL e 1mL, com aguja fija larga y corta. Estériles, atóxicas, apirrogênicas, libres de látex, desenchable y de um solo uso. Volumen nominal de 100UI (1mL) con intervalo de 10 en 10UI y subdivisión de 2 en 2UI y un volumen nominal de 50UI (0,5mL) intervalos de 5 en 5UI y subdivisión de 1 en 1UI. Fácil lectura de graduación, residual cero, con aguja trifacetada y siliconizada en toda su extensión.

AGULHA
FIXA



0,5mL

AGULHA
FIXA

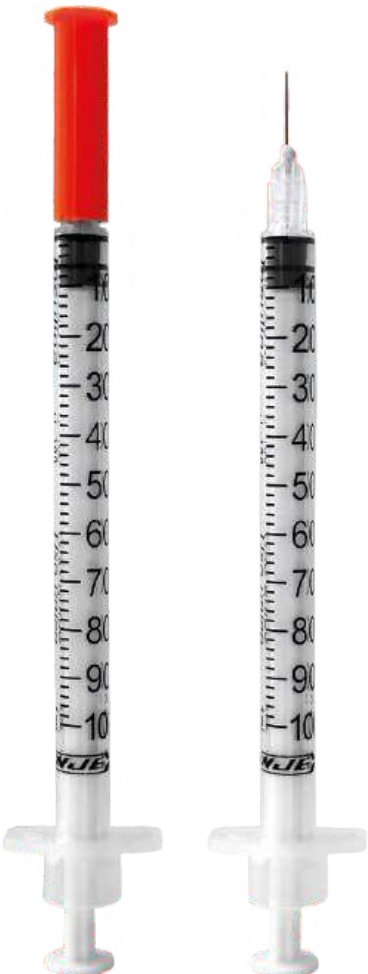

1mL

Adaptador para Agulha de Coleta Múltipla

O adaptador é o acessório que permite ao usuário uma boa empunhadura e segurança na hora da coleta de sangue a vácuo.

É confeccionado em plástico transparente e desenvolvido especialmente para o sistema de coleta Injex Vácuo.

Adaptador de Aguja de Colecta Múltiple

El adaptador es un accesorio que permite a los usuarios un buen agarre y seguridad cuando la recogida de la sangre a vacío.

Está hecho de plástico transparente y especialmente desarrollado para el sistema de recogida Injex Vácuo.

Scalp para Coleta Injex

O Scalp para Coleta Injex é utilizado em procedimentos que necessitam de coleta de sangue a vácuo.

Preserva suas características e funcionalidades por uma só vez de uso, devendo ser descartado após sua utilização, ou seja, produto de uso único.

Tamanhos disponíveis: 21G, 23G, 25G.

Scalp para Colecta Injex

El Scalp para Colecta Injex se utiliza en procedimientos que requieren la extracción de sangre al vacío.

Conserva sus características y funcionalidad para un solo uso, debiendo desecharse tras su uso, es decir, un producto de un solo uso.

Tamaños disponibles: 21G, 23G, 25G.



Adaptador de Coleta a Vácuo



Scalp de Coleta de Sangue a Vácuo



Agulha de Coleta Múltipla

Agulhas especiais para coleta de sangue a vácuo em sistema fechado. Apresenta os calibres 21G (25x0,80; 30x0,80) e 22G (25x0,70; 30x0,70), agulha com bisel trifacetado e siliconizado, que facilita a penetração na pele e na veia, minimizando traumas.

Possui proteção de borracha na parte inferior da agulha reduzindo o risco de contaminação durante as trocas dos tubos. Embaladas individualmente, esterilizadas a Óxido de Etileno e validade de 5 anos com embalagem intacta.

Aguja de Colecta Múltiplo

Agujas especiales para la colecta de la sangre de vacío en sistema cerrado. Disponible en calibres 21G (25x0,80; 30x0,80) y 22G (25x0,70; 30x0,70), cuenta con la aguja de bisel siliconado trifacetadas, lo que facilita la penetración en la piel y venas y también minimizar los traumas.

Tiene una protección de goma en la parte inferior de la aguja reduciendo el riesgo de contaminación durante los intercambios de tubo. Empaquetado individualmente, esterilización con Óxido de Etileno y 5 años de validez con el paquete intacto.



Agulha de Coleta Múltipla



Agulha

Proteção de Borracha

Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo

Revolucionário no mercado de diagnóstico laboratorial, o sistema fechado de coleta de sangue a vácuo trouxe precisão e segurança nos serviços prestados com a possibilidade de coletas múltiplas.

Os Tubos Injex Vácuo são usados para coletar, transportar e processar sangue para exame de soro, plasma ou sangue in natura. Este sistema evita contaminações da amostra, permite a coleta ideal e suficiente de sangue para a realização do exame, e seu descarte torna-se fácil e seguro evitando acidentes.

Os tubos são esterilizados pelo processo de Radiação, apresentam tampas que contém capas protetoras que evitam fácil abertura, evitando contaminações. São fabricados com e sem aditivos.

O sistema de coleta a vácuo Injex segue a rigorosa Norma Internacional ISO 6710. Dispomos de Tubos para Coagulação, Sorologia, Glicemia, Tipagem Sanguínea.

Tubo de Colecta de Sangre al Vacio

Revolucionario em el mercado de diagnostico de laboratorio, el sistema cerrado de la colecta de sangre al vacio, trajo la precisión y seguridad de los dispositivos previstos con posibilidad de múltiples colecciones.

Tubos de vacio Injex se utilizan para colecta, transporte y proceso para la prueba de suero, plasma o pruebas de sangre fresca. Este sistema evita la contaminación de las muestras. Permite a la colecta de sangre ideal y suficiente para la prueba, y su descarte se vuelve fácil y seguro, para evitar accidentes.

Los tubos se esterizaron mediante proceso de radiación; que cuentan con tapas que contienen cubiertas de protección que impiden la apertura fácil, por lo tanto evitando la contaminación. Se fabrican con o sin aditivos.

El sistema de colecta de vacío sigue la estricta Norma Internacional ISO 6710. Hemos tubos para coagulación, serología, la glucosa em sangre, determinación del grupo sanguíneo.



Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo



A C P CORREA CIA LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgão Públicos, Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.
Área de atuação: Paraná (Interior).

Contato: Pagini / Marina / Gustavo

Telefone: 43 3242-1589
Celular: 43 99972-4151 / 43 99935-0910

E-mail: medialsuture@uol.com.br
acphospitalar@uol.com.br

ADVAITA REPRESENTAÇÕES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Hospitais, Redes de Farmácias e Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.
Área de atuação: Rio de Janeiro.

Contato: Rafael

Telefone: 21 2603-5020
Celular: 21 99735-5423 / 21 98005-0039

E-mail: licitacoes@advrepresentacoes.com.br
licitacoes2@advrepresentacoes.com.br

ARIES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Estado do Paraná (Curitiba e Região Metropolitana).

Contato: Winston

Telefone: 41 3248-4793
Celular: 41 99116-8930
E-mail: winston.hosp@gmail.com

BONS AIRES REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Minas Geras (Região Metropolitana de Belo Horizonte e Central de MG).

Contato: Clayton / Jandinise

Celular: 31 98736-7667 / 31 99234-1514
E-mail: claytonmacedo@uol.com.br
jandinise@hotmail.com

CJS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Segmento: Hospitais Particulares e OSS
Área de atuação: Norte, Nordeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Tocantins

Contato: Sandra/ Julia

Celular: 11 97589-5310
E-mail: sandra@cjsrepresentacao.com.br
celular: 11 96581-9754
E-mail: julia@cjsrepresentacao.com.br

DELTA SERVIÇOS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: São Paulo (Presidente Prudente, Araçatuba, Marília e Bauru).

Contato: Cortez

Telefone: 18 3262-1658
Celular: 18 99704-9887
E-mail: deltavendas1@hotmail.com

DUTRA REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Piauí.

Contato: Marcos Dutra

Celular: 86 99808-4889 / 86 99593-2192
E-mail: marcos@dutrarepresentacoes.com

EPI REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Odontológico
Área de atuação: Rio de Janeiro

Contato: Simone / Carlos

Celular: 21 99918-1965
E-mail: simonepimenta39@hotmail.com

FARMALKLIN REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Hospitais privados e Farmácias.
Área de atuação: Rio Grande do Sul

Contato: Marcos / Felipe

Celular: 51 98421-7753
E-mail: marcos@farmaklin.com.br

Celular: 51 98421-7558
E-mail: felipe@farmaklin.com.br

FENAMAR REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Santa Catarina.

Contato: Fernando/Maria Fernanda/Marina

Telefone: 48 3246-7494
Celular: 48 99969-7494 / 48 99923-4676
48 99941-8401
E-mail: fenamarltda@hotmail.com

H M REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Hospitais, Órgão Públicos, Farmácias e Odontológico.
Área de atuação: Sul e Oeste do Maranhão e Sudeste do Pará.

Contato: Hugo

Celular: 99 98105-9261
E-mail: hugocesarsilvamedes@gmail.com

INOVAMED REP. EIRELLI

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de Farmácias.

Área de atuação: Bahia

Contato: John / Ivana

Celular: 77 98845-1158
E-mail: inovamedba@gmail.com

INS REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Bahia

Contato: Fabio Bittencourt

Celular: 71 99102-8426
E-mail: injex.fabio@gmail.com

J C DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Sergipe / Alagoas.

Contato: José Carlos

Celular: 82 98858-7978
E-mail: jcsantosrep7@gmail.com

JANDERLEY CAMPELO ME

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: Ceará.

Contato: Janderley

Telefone: 85 3035-1248
Celular: 85 98888-1248
E-mail: janderleycampelo@hotmail.com

KRL DE PAULA LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Tocantins.

Contato: Kellyson

Celular: 63 99974-1001
E-mail: kellyson_r.51@hotmail.com

LLD REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Hospitais particulares, OSS e Clínicas.
Área de atuação: São Paulo (Grande São Paulo).

Contato: Luiz Ladeira

Celular: 11 96084-7993
E-mail: luizladeira@uol.com.br

MANUEL ALMEIDA MELO

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.
Área de atuação: São Paulo (Campinas, Sorocaba, Itu, Americana e Rio Claro)

Contato: Manuel

Telefone: 19 3238-8874
Celular: 19 99772-5370
E-mail: manuel.melo@terra.com.br

MEDFARMA REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.
Área de atuação: Pernambuco

Contato: Junior

Celular: 81 99178-0444
E-mail: juniorinjexpe@outlook.com



MEDIEQUIP COM. E REP. EIRELI

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Minas Gerais (Regiões Zona da Mata de Sul de MG).

Contato: Luiz Limp

Celular: 32 98877-3263

E-mail: luiz.limp@hotmail.com

M & B REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Espirito Santo.

Contato: Odair

Telefone: 27 99238-4926

Celular: 27 99686-8948

E-mail: mebcirurgica@gmail.com

NJ REPRESENTAÇÕES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Goiás e Distrito Federal

Contato: Yara Jacinto

Celular: 62 99328-5831

E-mail: njrepresentacoes@gmail.com

OD REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de Farmácias e Laboratórios.

Área de atuação: Amazonas e Roraima

Contato: Alexis / Ma. Trindade / Alexandre / Heleno

Celular: 92 99982-0344

E-mail: alexisod@hotmail.com

Celular: 92 99487-7111

E-mail: odtrindade@hotmail.com

Celular: 92 98429-5794

E-mail: od.alexandre@hotmail.com

Celular: 92 99158-7671

E-mail: od.heleno@outlook.com

ONEMED HOSPITALAR LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Estado do Maranhão (capital e região metropolitana de São Luiz).

Contato: Valmir França.

Celular: 98 98142-5534

E-mail: valmirjesus0509@gmail.com

PABLO CARVALHO

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Laboratórios Farmacêuticos.

Área de atuação: São Paulo, Região Metropolitana, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Paulista (Norte, Baixada Santista, Sul).

Celular: 11 96497-6923

E-mail: vendas5@injex.com.br

PAULO HERIQUE CORREIA LIMA

Segmento: Odontológico

Área de atuação: Minas Gerais.

Celular: 31 98280-6363

E-mail: paulolima10@yahoo.com.br

R DOS ANJOS TELLES

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Laboratórios Farmacêuticos e Veterinários.

Área de atuação: São Paulo (São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca), Minas Gerais (Região do Triângulo Mineiro).

Contato: Rogério / Raquel / Bruna

Telefone: 16 3701-8170

Celular: 16 98259-9318 / 16 99343-0578

E-mail: rogerio@tresrs.com.br / tresrs@tresrs.com.br

E-mail: raquel@tresrs.com.br / atendimento@tresrs.com.br

SILVANA REPRESENTAÇÕES

Segmento: Laboratório de Análise Clínicas

Área de atuação: Território Nacional.

Contato: Tina / Silvana

Telefone: 11 2087-3908

Celular: 11 96342-6973 / 11 99856-7952

E-mail: silvanarepresentacoes02@outlook.com
silvanarepresentacoes@outlook.com

SOARES E RODRIGUES REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

Segmento: Distribuidores e Órgãos Públicos

Área de atuação: Acre e Rondônia

Contato: Gladly Rodrigues

Celular: 69 99981-4000 / 69 99287-4191

E-mail: soares.rodriguesglady@gmail.com

SOUZA E CERBINO REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos, Redes de farmácias e Odontológicos.

Área de atuação: Pará e Amapá

Contato: Aline Cerbino

Celular: 91 98547-2465

E-mail: aline.cerbino@outlook.com

TURKI REPRESENT. COM. LTDA

Segmento: Odontológico.

Área de atuação: Rio Grande do Sul.

Contato: Daiane

Celular: 51 99112-7786

E-mail: daianeturki@hotmail.com

VIEIRA DE MELLO REPRESENTAÇÕES

Segmento: Odontológico.

Área de atuação: São Paulo e Grande São Paulo.

Contato: João Tadeu

Celular: 11 99635-9088

E-mail: reprieveirademello@terra.com.br

VILAR E CARVALHO REP. LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias

Área de atuação: Rio Grande do Norte e Paraíba.

Contato: Gislan

Celular: 84 99697-0268

E-mail: vilarecarvalho@hotmail.com

VILELA E FACCIN LTDA.

Segmento: Distribuidores Hospitalar/Farma/Odonto, Órgãos Públicos e Redes de Farmácias.

Área de atuação: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Contato: Henrique Vilela / Luiz Henrique Vilela / Vera Lúcia Faccin / Lucélia Silva.

Celular: 65 99981-3437

E-mail: henriquevilela@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99982-3366

E-mail: verafaccin@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99975-8054

E-mail: luhvilela@vilelafaccin.com.br

Celular: 65 99811-3366

E-mail: licelia@vilelafaccin.com.br

WILL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Segmento: Distribuidores, Órgãos Públicos.

Área de atuação: Minas Gerais (Regiões de Montes Claros, Gov. Valadares, Nordeste, Norte, Vale, Jequitinhonha, Vale Mucuri e Vale do Rio Dode).

Contato: Westerle

Celular: 38 99198-0131

E-mail: westerle@uol.com.br

INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

www.injex.com.br

injex@injex.com.br

Sac: 0800 770 6080 | +55 14 3302.2900

Av. Comendador José Zillo, 160 – Distrito Industrial
Ourinhos-SP – CEP 19908-170 – Caixa Postal 75

*Produtos para saúde,
dentro dos padrões
de qualidade INJEX.*



Catálogo **Hospitalar**

A companhia
que **mais cresce**
e investe em
infraestrutura e
lançamento de
novos produtos
no Brasil



Conheça nossa
estrutura

Fundada em 13 de agosto de 2008, **Medix Brasil** é uma **importadora** brasileira que oferece ampla variedade de **dispositivos hospitalares, soluções diagnósticas, EPI's e produtos multiuso.**

Consolidada e inovadora, **somos referência** nacional em proteção e estamos entre os maiores **líderes do segmento.**

Atualmente, com um portfólio composto por mais de **800 SKUs**, investimos continuamente em **evolução e expansão** de mercado, reafirmando nosso maior propósito: **fazer parte da vida de milhares de pessoas, oferecendo a proteção, o cuidado e o bem-estar que elas merecem.**

Medix
BRASIL

Guia Rápido de Identificação

Para facilitar a leitura e compreensão dos produtos apresentados neste catálogo, utilize este guia de simbologia, abreviações e metodologia de embalagem. Aqui você encontra os significados dos ícones, termos técnicos e formatos de apresentação utilizados ao longo das páginas, garantindo uma leitura mais ágil e precisa.

Simbologia



Livre de látex



Produto esterilizado



Nova embalagem



Produto que contém dispositivo de segurança



Luvas livres de pó



Novo modelo ou nova apresentação



Produto sustentável



Novo produto



Produto que faz parte da linha Supreme

Abreviações

Cód.	Código	Vol.	Volume	Un.	Unidade
Tam.	Tamanho	Emb.	Embalagem	Cart.	Cartucho
Apres.	Apresentação	C/	Com	S.A.	Sistema Aberto
Gram.	Gramatura	S/	Sem	S.F.	Sistema Fechado
Comp.	Comprimento	Pct.	Pacote	Disp. de Seg.	Dispositivo de Segurança

Metodologia de embalagem

O sistema de embalagens Medix abrange:

Embalagem primária



Embalagem que acomoda o produto diretamente, podendo ou não ser individualizado

Embalagem secundária



Caixa ou pacote que comporta diversas unidades individuais

Caixa de embarque



Caixa master utilizada no transporte dos produtos

Sumário



Luvas

Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Látex Ambidestra	9
Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Vinil Ambidestra	9
Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Nitrilo Sem Pó Ambidestra	9
Luva para Proced. Não Cirúrg. de Nitrilo Preta Sem Pó Ambidestra Polybag	11
Luva Plástica Estéril Descartável Ambidestra	11
Luva Antimicrobiana p/ Proced. Não Cirúrg. de Nitrilo AMG Sem Pó Ambidestra	11
Luva Cirúrgica de Látex Anatômica	13
Luva Cirúrgica de Látex Supreme Anatômica	13
Luva Cirúrgica Sintética de Poliisopreno Supreme Anatômica	13

Paramentação e descartáveis

Avental Manga Longa Descartável Classic e Supreme	15
Avental Cirúrgico Estéril	15
Avental Descartável Impermeável	15
Lençol Descartável Premium	16
Lençol Descartável Sustentável	16
Lençol Descartável Fibras Brancas	16
Touca Descartável	17
Lençol Descartável	17
Máscara Tripla Descartável	18
Máscara Descartável 4 Camadas de Proteção	18
Toalha Descartável para Assepsia	19
Propé Descartável	19
Óculos de Proteção	19

Esterilização

Envelope Autoselante para Esterilização	21
Rolo para Esterilização	21

Urologia

Bolsa de Urina Sistema Fechado	23
Bolsa de Urina Sistema Fechado Supreme	23
Sonda Uretral Nelaton	24
Sonda Foley Látex Siliconizada 2 vias	24
Sonda Foley Látex Siliconizada 3 vias	25
Sonda Foley Supreme Silicone 2 vias	25
Sonda Foley Supreme Silicone 3 vias	25

Gastroenterologia

Sonda de Nutrição Enteral Supreme	27
Equipo de Nutrição Enteral	27
Frasco de Alimentação Enteral	27
Sonda Nasogástrica Levine Supreme	27
Sonda Nasogástrica Curta Supreme	28
Sonda Nasogástrica Longa Supreme	28



Sumário



Cirúrgica

Bisturi com Dispositivo de Segurança Supreme	30
Clamp Umbilical	31
Eletrodo para ECG	31
Dreno de Sucção Sanfonado	31
Kit de Campo Cirúrgico Universal	31
Fio de Sutura Não Absorvível Polipropileno	32
Fio de Sutura Não Absorvível Seda	32
Fio de Sutura Não Absorvível Nylon	33

Têxtil e algodão

Compressa de Gaze Hidrófila Supreme Não Estéril	35
Compressa de Gaze Hidrófila Supreme Estéril	35
Atadura de Crepom Classic	35
Atadura de Crepom Supreme	37
Compressa de Campo Operatório Estéril Classic e Supreme	37
Rolo Dental Não Estéril Supreme	37

Coletores e suportes

Coletor Perfurocortante Premium	39
Coletor Perfurocortante Sustentável	39
Coletor Perfurocortante Químico	39
Suporte para Coletor	39

Descarte de resíduos

Saco para Lixo Resíduos Infectantes – ABNT	41
Saco para Lixo Resíduos Infectantes	41
Saco para Enjoo	41
Saco Hamper Roupas Infectadas	41

Agulhas e seringas

Agulha Hipodérmica	43
Agulha para Aspiração	43
Agulha Descartável para Caneta de Insulina	43
Agulha Gengival	44
Seringa Hipodérmica	44
Seringa Hipodérmica com Agulha	44
Seringa Bico Cateter	45
Seringa Dosadora	45
Seringa de Insulina	45
Lanceta de Segurança Supreme	46
Lanceta para Lancetador	46
Lancetador (Caneta Lancetadora)	46

Acesso vascular

Cateter Intravenoso Periférico	48
Cateter Intravenoso Periférico com Dispositivo de Segurança Automático	48
Scalp para Infusão Intravenosa	48
Dispositivo Transferidor de Soluções	49
Tampa Vedante	49
Conector Valvulado	49



Sumário



Terapia de infusão

Equipo de Infusão Gravitacional.....	51
Equipo para Transfusão de Sangue.....	52
Equipo de Infusão Gravitacional Bureta.....	52
Extensor Multivias.....	53
Torneira 3 Vias.....	53

Oncologia

Agulha Huber Supreme.....	55
Bomba Elastomérica Descartável.....	56
Filtro de Infusão Supreme.....	56

Respiratória

Cânula de Guedel.....	58
Cateter Tipo Óculos.....	58
Tubo Extensor de Oxigênio.....	58
Máscara de Oxigênio Não Reinalante.....	59
Máscara Laríngea Supreme.....	59
Reanimador Manual em PVC.....	59
Tubo Endotraqueal Supreme.....	60
Tubo Endotraqueal Aramado Supreme.....	60
Tubo Endotraqueal com Aspiração.....	61
Tubo Traqueostomia Sem Cuff Supreme.....	61
Tubo Traqueostomia Com Cuff Supreme.....	61
Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Aberto Supreme.....	62
Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado Supreme - 24h.....	62
Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado Supreme - 72h.....	63
Filtro HMEF.....	63
Filtro HEPA.....	63



Panos

Pano Wiper Reutilizável 28x240 600 panos.....	65
Pano Wiper Reutilizável 28x35,2 88 panos.....	65
Pano Wiper Reutilizável 28x35 100 panos.....	66
Pano Wiper Reutilizável 45x45 50 panos.....	66

Descarte de resíduos

Saco para Lixo Resíduos comuns.....	67

Proteção química

Multiuso Plus Luva de Látex Ranhurada.....	68



Um portfólio premium para quem não abre mão do melhor



- Excelência em padrão de embalagem
- Excelência em materiais premium
- Excelência em proteção, segurança e conforto



Conheça a
Medix Supreme

Medix
BRASIL
Supreme



Luvras

A Medix tem a luva
ideal para você



Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Látex | Ambidestra

Código		Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
Com Pó	Sem Pó			
17	6060	PP	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 10 cartuchos
29	6071	P		
30	6083	M		
42	6095	G		



Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Vinil | Ambidestra

Código		Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
Com Pó	Sem Pó			
8638	8663	P	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 10 cartuchos
8626	8651	M		
8614	8640	G		
9520	9501	GG		



Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Nitrilo Sem Pó | Ambidestra

Código			Tam.	Emb. Primária	Caixa Embarque
Azul	Rosa	Preta			
6022	6229	-	PP	Cartucho com 100 unidades	Caixa com 10 cartuchos
6034	6230	6181	P		
6046	6242	6193	M		
6058	6254	6205	G		
9602	-	6217	GG		



A laranjinha
favorita do 🇧🇷!





Luva para Procedimento Não Cirúrgico de Nitrilo Preta Sem Pó | Ambidestra | Polybag

Código	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
10221	P		
10222	M		
10223	G	Pacote c/ 10 unidades	Caixa c/ 60 pacotes
10224	GG		



Polybag 1 un. Pacote 100 un.

Luva Plástica Estéril Descartável | Ambidestra

- Fabricada em polietileno de alta densidade
- Tamanho único
- Transparente
- Unidade embalada individualmente



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
11380	Pacote c/ 100 unidades	Caixa c/ 100 pacotes



Microtexturizada nas pontas dos dedos



Mata até **99,99%** das bactérias* e o vírus da covid-19



Luva Antimicrobiana para Procedimento Não Cirúrgico de Nitrilo AMG | Sem Pó | Ambidestra

- Com tecnologia antimicrobiana é a primeira e única capaz de eliminar uma ampla gama de microorganismos
- Barreira de proteção ativa entre mãos e microorganismos
- Previne infecções por bactérias e contaminação cruzada
- Penetração viral 0%
- Possui eficiência bactericida e virucida



Código	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
6315	PP		
6327	P		
6339	M		
6340	G	Cartucho com c/ 100 unidades	Caixa c/ 10 cartuchos
9463	GG		

Luvas Cirúrgicas *Supreme*



Excelência
em cada
procedimento
cirúrgico

- Sensibilidade tátil
- Elasticidade e conforto
- Mais resistência
- Proteção suprema





Luva Cirúrgica de Látex | Anatômica

- Fabricada em látex de borracha natural
- Superfície texturizada
- Embalada em blister, com indicação específica para mão direita e esquerda
- Abertura asséptica
- Embalada individualmente (1 par/envelope)



Código		Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
Com Pó	Sem Pó			
5905	9456	6.5	Cartucho c/ 50 pares	Caixa c/ 500 pares
5917	9457	7.0		
5929	9458	7.5		
5930	9459	8.0		
5942	9460	8.5		



Luva Cirúrgica de Látex Supreme | Anatômica

- Fabricada em látex de borracha natural
- Superfície texturizada
- Embalada em blister, com indicação específica para mão direita e esquerda
- Abertura asséptica
- Embalada individualmente (1 par/envelope)



Código		Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
Com Pó	Sem Pó			
12719	12720	6.0	Cartucho c/ 50 pares	Caixa c/ 500 pares
12583	12588	6.5		
12584	12589	7.0		
12585	12590	7.5		
12586	12591	8.0		
12587	12592	8.5		



Luva Cirúrgica Sintética de Poliisopreno Supreme | Anatômica

- Fabricada em Poliisopreno (borracha sintética)
- Superfície texturizada
- Sem pó
- Comprimento: aproximadamente 300mm
- Embalada em blister, com indicação específica para mão direita e esquerda
- Abertura asséptica
- Embalada individualmente (1 par/envelope)



Código	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
12414	6.5	Cartucho c/ 50 pares	Caixa c/ 200 pares
12415	7.0		
12416	7.5		
12417	8.0		
12418	8.5		



**Paramentação
e descartáveis**



Avental Manga Longa Descartável Classic e Supreme

- Confeccionado em não tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado
- Punho elástico
- Fechamento em tiras
- Tamanho único
- Cor: Branca



A apresentação Supreme 50g possui em sua composição 26% tecido laminado de polietileno com aditivo masterbatch - o que lhe confere impermeabilidade à pequenos volumes de fluidos

Código	Gramatura	Emb. Primária	Caixa Embarque
5783	16g	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 20 pac.
8259	30g	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 10 pac.
8590	40g	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 10 pac.
9422	50g	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 10 pac.



Avental Cirúrgico Estéril

- Confeccionado em não tecido 100% polipropileno SMS
- Acompanha toalha absorvente (40cm x 50cm)
- Punho em malha
- Embalado individualmente



Código	Tamanho	Gramatura	Caixa Embarque
11993	G	40g	Caixa c/ 50 unidades
11994	EG	40g	



Avental Descartável Impermeável

- Confeccionado em 50% camada de não tecido de polipropileno e 48% polietileno
- Tipo barbeiro
- Punho elástico
- Manga longa
- Fechamento em tiras
- Aberto nas costas



Código	Gramatura	Emb. Primária	Caixa Embarque
13799	50g	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 100 pac.



Lençol Descartável Premium

- 100% celulose virgem
- Firme e resistente
- Ultra absorvente
- Macio ao toque
- Extra branco

Código	Tamanho	Caixa Embarque
12058	50cm x 50m	Caixa c/ 10 rolos
12059	70cm x 50m	



Lençol Descartável Fibras Brancas

- Fibra celulósica branca
- Produto sustentável
- Alta absorção
- Suave ao toque
- Branco soft



Código	Tamanho	Caixa Embarque
12056	50cm x 50m	Caixa c/ 10 rolos
12057	70cm x 50m	



Lençol Descartável Sustentável

- Fibra celulósica natural
- Produto sustentável
- Textura leve
- Cor natural



Código	Tamanho	Caixa Embarque
12060	50cm x 50m	Caixa c/ 10 rolos
12061	70cm x 50m	



Touca Descartável

- Confeccionada em não tecido 100% de polipropileno
- Cor: Branca

Apresentação com Elástico: disponível em fabricação nacional e importada

Código	Apres.	Gramatura	Emb. Primária	Caixa Embarque
5624	Tiras	20G	Pacote c/ 100 und.	Caixa c/ 10 pacotes
5612	Elástico	10G	Pacote c/ 100 und.	Caixa c/ 50 pacotes
10352	Elástico	10G	Pacote c/ 100 und.	Caixa c/ 50 pacotes



Lençol Descartável

- Confeccionado em não tecido 100% de polipropileno
- Tipo de borda: elástico revestido em todo o perímetro
- Gramatura: 16g/m²

Código	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
9761	90cm X 2m	Pacote c/ 10 unidades	Caixa c/ 50 pacotes

Proteção
completa
para todos
os gostos



Máscara Tripla Descartável

- Confeccionada em não tecido 100% de polipropileno e papel filtro melt blown BFE: $\geq 95\%$
- Possui 03 camadas:
 - 1ª Camada: polipropileno não tecido de $25g \pm 2g$
 - 2ª Camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) de $25g \pm 2g$
 - 3ª Camada: polipropileno não tecido de $25g \pm 2g$

Código	Cor	Apres.	Emb. Primária	Caixa Embarque
9515	●	Elástico	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 40 cart.
5587	○	Elástico	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 40 cart.
9436	●	Elástico	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 40 cart.
9437	●	Elástico	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 40 cart.
6500	○	Elást. Polybag	Pacote c/ 50 unidades	Caixa c/ 100 pct.
13782	●	Elást. Polybag	Pacote c/ 50 unidades	Caixa c/ 100 pct.
5599	○	Tiras	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 40 cart.

Máscara Descartável | 4 Camadas de Proteção

- Confeccionada em não tecido 100% de polipropileno e papel filtro melt blown BFE: $\geq 95\%$
- Possui 04 camadas:
 - 1ª Camada: polipropileno não tecido de $55g \pm 2g$
 - 2ª Camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) de $25g \pm 2g$
 - 3ª Camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) de $25g \pm 2g$
 - 4ª Camada: polipropileno não tecido de $50g \pm 2g$

Modelo não equivalente a PFF2/N95

Código	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
7568	○	Cartucho c/ 10 unidades	Caixa c/ 100 cartuchos





Toalha Descartável para Assepsia

- Confeccionada em viscose e poliéster
- Toque macio
- Não desprende fios
- Não estéril
- Não umedecida
- Recomendado uso único

Código	Gramatura	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
10215	50g	30cm x 35cm	Pacote c/ 100 un.	Caixa c/ 12 pct.



Propé Descartável

- Confeccionado em não tecido 100% polipropileno
- Com elástico para fácil ajuste

Código	Gram.	Tamanho	Emb. Primária	Cx. Embarque
5600	8g	46cm x 49cm	Pacote c/ 100 un.	Caixa c/ 20 pct.

Óculos de Proteção

CA 48553



- Arcos e visor confeccionados em policarbonato
- Hastes que permitem o ajuste de tamanho
- Proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e raios ultravioleta (U6)
- Tamanho único
- Produto não estéril
- Embalado individualmente
- Aprovado para uso em saúde

Notificação do Produto na Anvisa: 80495510150

Código	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9601	Antirrisco e Anti-embuçante	Unitário	Caixa c/ 300 un.
9977	Antirrisco		





Esterilização



Envelope Autoselante para Esterilização

- Fabricado com papel cirúrgico e filme transparente resistente de poliéster/polipropileno e papel grau cirúrgico
- Selagem rápida e segura
- Uso em autoclave a vapor ou gás óxido etileno (EO)

Código	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
14171	7cm x 23cm	Cartucho c/ 200 envelopes	Caixa c/ 15 cart.
14172	9cm x 16,5cm		Caixa c/ 20 cart.
14173	9cm x 26cm		Caixa c/ 10 cart.



Rolo para Esterilização

- Fabricado em filme transparente e papel grau cirúrgico
- Atóxico
- Para esterilização em autoclaves
- Mantém o conteúdo esterilizado até o momento do uso
- Vedação tripla
- Isento de alvejante

Código	Tamanho	Emb. Primária	Caixa Embarque
14163	5cm x 100m	1 rolo	Caixa c/ 24 rolos
14164	7,5cm x 100m		Caixa c/ 16 rolos
14165	10cm x 100m		Caixa c/ 12 rolos
14166	12cm x 100m		Caixa c/ 8 rolos
14167	15cm x 100m		Caixa c/ 8 rolos
14168	20cm x 100m		Caixa c/ 4 rolos
14169	25cm x 100m		Caixa c/ 4 rolos
14170	30cm x 100m		Caixa c/ 4 rolos





Urologia

Soluções em urologia para quem prioriza saúde

✓ Materiais de alta qualidade

✚ Conforto nos procedimentos

📦 Portfólio completo

Simplex

Standard



Bolsa de Urina Sistema Fechado

- Confeccionada em PVC
- Capacidade de 2000ml
- Possui ponto de coleta
- Tubo extensor de 100cm fabricado em PVC transparente
- Válvula de drenagem inferior (ponto de descarte) "Torneira T"
- Válvula antirrefluxo
- Clamp corta fluxo
- Alça para transporte
- Embalada individualmente



Apresentação Standard: Novo formato e custo-benefício

Código	Apresentação	Caixa Embarque
6280	Simplex	Caixa c/ 100 unidades
11564	Standard	

Bolsa de Urina Sistema Fechado Supreme


- Capacidade de 2000ml
- Com filtro de ar
- Válvula de drenagem inferior (ponto de descarte)
- Dispositivo anti-refluxo
- Câmara gotejadora tipo Pasteur
- Tubo de extensão de 110cm feito de PVC transparente (diâmetro interno de 7mm e diâmetro externo de 9mm)
- Conector escalonado com tampa protetora
- Braçadeira de fluxo
- Grampo para lençol
- Suporte de fixação com haste retangular que permite o manuseio com apenas uma das mãos e fixação segura em todos os tipos de leitos
- Cordão para fixação em maca
- Ponto de coleta com membrana auto cicatrizante
- Sem látex
- Estéril - óxido de etileno



Código	Apresentação	Caixa Embarque
13280	Sistema Fechado	Caixa c/ 50 unidades

Sonda Uretral | Nelaton


- Confeccionada em PVC
- Conector luer universal com tampa em PVC
- Contém 2 orifícios laterais alternados
- Ponta arredondada atraumática
- Embalada individualmente

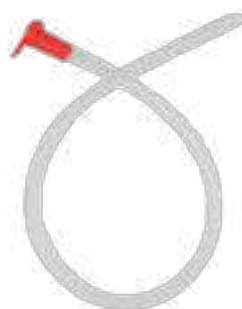

Código	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9889	4FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 900 un.
9890	6FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 900 un.
9891	8FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 900 un.
9892	10FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 800 un.
9893	12FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 800 un.
9894	14FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 700 un.
9895	16FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 600 un.
9896	18FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 600 un.
9897	20FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 500 un.
9898	22FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 500 un.
9899	24FR	40cm	Pct. c/ 50 unidades	Caixa c/ 500 un.

Sonda Foley | Látex Siliconizada | 2 vias


- Fabricada em látex de borracha natural
- Siliconizada
- Com cuff inflável
- Possui válvula de insuflação
- Ponta arredondada atraumática
- Embalada individualmente

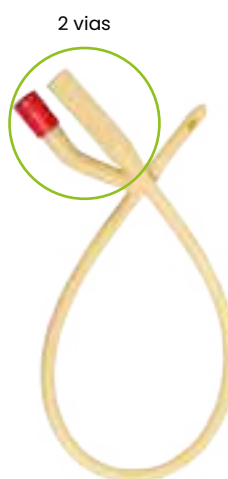

Os tamanhos 6FR, 8FR e 10FR possuem fio guia

Código	Apres.	Tam.	Comp.	Vol. cuff	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6511	2 vias	6FR	30,5cm	3ml		
6523	2 vias	8FR	30,5cm	3-5ml		
6535	2 vias	10FR	30,5cm	3-5ml		
6547	2 vias	12FR	39,5cm	15-30ml		
6559	2 vias	14FR	39,5cm	15-30ml	Caixa c/ 10 un.	Caixa c/ 500 un.
6560	2 vias	16FR	39,5cm	15-30ml		
6572	2 vias	18FR	39,5cm	15-30ml		
6584	2 vias	20FR	39,5cm	15-30ml		
6596	2 vias	22FR	39,5cm	15-30ml		
6608	2 vias	24FR	39,5cm	30-50ml		

3 vias

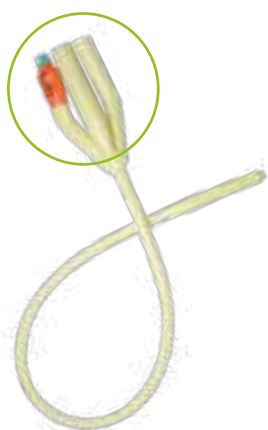

Sonda Foley | Látex Siliconizada | 3 vias

- Fabricada em látex de borracha natural
- Siliconizada
- Com cuff inflável
- Possui válvula de insuflação
- Ponta arredondada atraumática
- Embalada individualmente

STERILE

Código	Apres.	Tam.	Comp.	Vol. cuff	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6610	3 vias	16FR	39,5cm	30-50ml	Caixa c/ 10 un.	Caixa c/ 500 un.
6621	3 vias	18FR	39,5cm	30-50ml		
6633	3 vias	20FR	39,5cm	30-50ml		
6645	3 vias	22FR	39,5cm	30-50ml		
6657	3 vias	24FR	39,5cm	30-50ml		

Sonda Foley Supreme | Silicone | 2 vias

- Confeccionada em 100% silicone grau médico
- Com cuff inflável
- Possui válvula de insuflação
- Ponta arredondada atraumática
- Embalada individualmente


STERILE

LATEX

Supreme

Os tamanhos 6FR, 8FR e 10FR possuem fio guia

2 vias

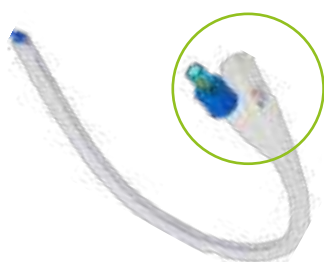

Código	Apres.	Tam.	Comp.	Vol. cuff	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9742	2 vias	6FR	30,5cm	1.5ml	Caixa c/ 10 un.	Caixa c/ 500 un.
9743	2 vias	8FR	30,5cm	3-5ml		
9744	2 vias	10FR	30,5cm	3-5ml		
9745	2 vias	12FR	39,5cm	5-15ml		
9746	2 vias	14FR	39,5cm	5-15ml		
9747	2 vias	16FR	39,5cm	15-30ml		
9748	2 vias	18FR	39,5cm	15-30ml		
9749	2 vias	20FR	39,5cm	15-30ml		
9750	2 vias	22FR	39,5cm	15-30ml		
9751	2 vias	24FR	39,5cm	30-50ml		

3 vias



Sonda Foley Supreme | Silicone | 3 vias


- Confeccionada em 100% silicone grau médico
- Com cuff inflável
- Possui válvula de insuflação e funil de drenagem
- Ponta arredondada atraumática
- Embalada individualmente

STERILE

LATEX

Supreme

Código	Apres.	Tam.	Comp.	Vol. cuff	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9752	3 vias	18FR	39,5cm	30-50ml	Caixa c/ 10 un.	Caixa c/ 500 un.
9753	3 vias	20FR	39,5cm	30-50ml		
9754	3 vias	22FR	40cm	30-50ml		

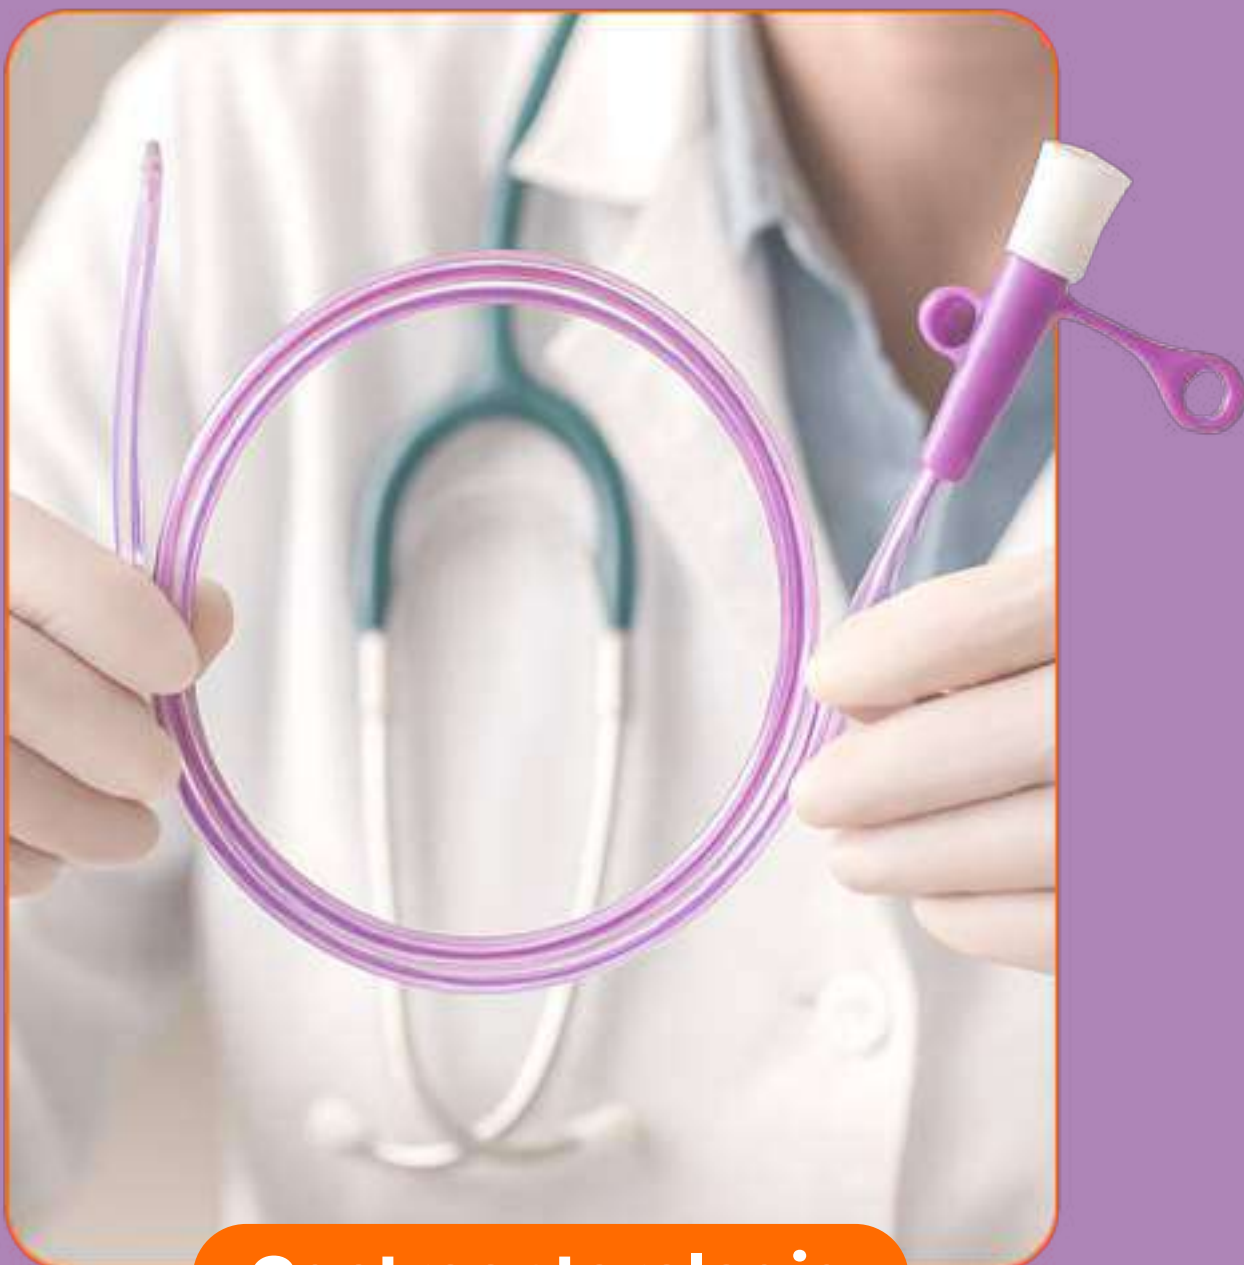

Gastroenterologia



Sonda de Nutrição Enteral Supreme

- Contém peso na ponta e fio guia em aço inoxidável AISI 304
- Possui coloração roxa para distinção de uso enteral
- Tubo confeccionado em poliuretano
- Conector "Y" confeccionado em PVC
- Embalada individualmente



Código	Tamanho	Comprimento	Emb. Sec.	Caixa Embarque
9900	6FR	60cm		
9901	8FR	100cm	Caixa c/ 15 unidades	Caixa c/ 180 unidades
9902	10FR	120cm		
9903	12FR	120cm		



Conector escalonado com tampa protetora

Equipo de Nutrição Enteral

- Fabricado em polietileno, polipropileno e plástico ABS
- Tubo flexível de PVC de 150cm na cor azul
- Câmara gotejadora flexível
- Pinça rolete reguladora de fluxo
- Conector escalonado com tampa protetora
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
9529	Macrogotas Polybag	Caixa c/ 400 unidades



Frasco de Alimentação Enteral

- Fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD)
- Volume 300ml
- Contém etiqueta de identificação
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
13476	Polybag	Caixa c/ 150 unidades




Sonda Nasogástrica Levine Supreme

- Conector assegura a compatibilidade com equipos de nutrição e seringas
- Tubo confeccionado em PVC cristal transparente
- Conector confeccionado em PVC
- Contém 4 orifícios laterais alternados, com ponta fechada e arredondada
- Acabamento atraumático
- Embalada individualmente



Código	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9866	4FR	125cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9867	6FR	125cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9868	12FR	125cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 400 un.
9869	14FR	125cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 400 un.
9870	18FR	125cm	Pacote c/ 15 un.	Caixa c/ 300 un.
9871	20FR	125cm	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 200 un.
9872	22FR	125cm	Pacote c/ 10 un.	Caixa c/ 200 un.

Sonda Nasogástrica Curta Supreme

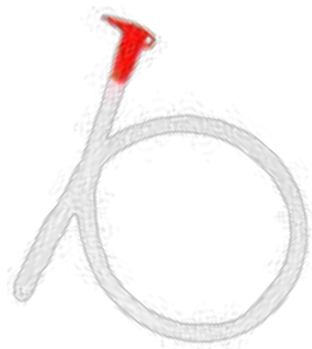

- Conector assegura a compatibilidade com equipos de nutrição e seringas
- Tubo confeccionado em PVC cristal transparente
- Conector confeccionado em PVC
- Contém 2 orifícios laterais alternados, com ponta fechada e arredondada
- Acabamento atraumático
- Embalada individualmente



Código	Apres.	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9855	Curta	4FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 900 un.
9856	Curta	6FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 900 un.
9857	Curta	8FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 900 un.
9858	Curta	10FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 800 un.
9859	Curta	12FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 800 un.
9860	Curta	14FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 700 un.
9861	Curta	16FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 600 un.
9862	Curta	18FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 600 un.
9863	Curta	20FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.
9864	Curta	22FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.
9865	Curta	24FR	40cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.

Sonda Nasogástrica Longa Supreme



- Conector assegura a compatibilidade com equipos de nutrição e seringas
- Tubo confeccionado em PVC cristal transparente
- Conector confeccionado em PVC
- Contém 2 orifícios laterais alternados, com ponta fechada e arredondada
- Acabamento atraumático
- Embalada individualmente



Código	Apres.	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9844	Longa	4FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9845	Longa	6FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9846	Longa	8FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9847	Longa	10FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 500 un.
9848	Longa	12FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 400 un.
9849	Longa	14FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 400 un.
9850	Longa	16FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 300 un.
9851	Longa	18FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 300 un.
9852	Longa	20FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 200 un.
9853	Longa	22FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 200 un.
9854	Longa	24FR	120cm	Pacote c/ 20 un.	Caixa c/ 200 un.



Cirúrgica

Bisturi com Dispositivo de Segurança Supreme



Carbono Inoxidável

- Cabo confeccionado em plástico ABS
- Lâmina confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável
- Possui dispositivo de segurança com capa protetora e trava
- Ativação ambidestra
- Uso único
- Embalado individualmente



Código			Emb. Secundária	Caixa Embarque
Carbono	Inoxidável	Tam.		
10263	10271	10	Caixa c/ 10 unidades	Caixa c/ 500 unidades
10264	10272	11		
10265	10273	12		
10266	10274	15		
10267	10275	20		
-	10276	21		
10268	10277	22		
10269	10278	23		
10270	10279	24		

Lâminas

No. 10

No. 15

No. 22

No. 11

No. 20

No. 23

No. 12

No. 21

No. 24

Lâmina de Bisturi

- Confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável
- Atóxico e apirogênico
- Embalado individualmente




Inoxidável



Carbono

Código			Emb. Secundária	Caixa Embarque
Carbono	Inoxidável	Tam.		
8333	8431	10	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 5000 un.
8345	8443	11		
8357	8455	12		
8369	8467	15		
8370	8479	15c		
8382	8480	20		
8394	8492	21		
8406	8504	22		
8418	8516	23		
8420	8528	24		

Lâminas



No. 10

No. 11

No. 12

No. 15

No. 15C

No. 20

No. 21

No. 22

No. 23

No. 24



Clamp Umbilical

- Confeccionado em Poliacetal
- Dentes projetados para segurar firmemente o cordão umbilical
- Cor: branca
- Atóxico e apirrogênico
- Embalado individualmente



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9480	Caixa c/ 100 unidades	Caixa c/ 1000 unidades

Eletrodo para ECG



- Pino de aço inoxidável
- Gel condutor sólido
- Espuma médica com gel adesivo hipoalérgico
- Fita porosa ou tecido macio, autoaderente
- Capa plástica que mantém a umidade do gel



Cód.	Formato	Apresentação	Emb. Primária	Caixa Embarque
8308	Retângulo	SF22 (35x40mm) Adulto	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 40 pacotes
8310	Redondo	SF11 (30mm) Pediátrico		
8321	Redondo	SF68 (25x31mm) Neonatal		



Dreno de Sucção Sanfonado

- Bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade até 510ml
- Introdutor metálico com ponta perfurante
- Alça para transporte
- Conector com 2 vias
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
11245	3.2mm (1/8")	Caixa c/	Caixa c/ 40
11246	4.8mm (3/16")	1 unidade	unidades

Kit de Campo Cirúrgico Universal

- Confeccionado em SMS com gramatura de 40g/m2 com áreas de reforço em não tecido Laminado 48g/m2
- Possui fita adesiva dupla face hipoalérgica, para fixação do campo e delimitação do sítio cirúrgico
- Produto de uso único



	1 campo de mesa instrumental: 2m x 1,30m		1 bolsa para instrumental: (48g/m2) 1,5m x 1,0m
	2 campos laterais: 1,5m x 1,0m		Não possui janela
	1 campo superior: 2,5m x 1,5m		1 campo inferior: 2,0m x 1,5m

Código	Emb. Primária	Caixa Embarque
10201	Pacote c/ 1 kit	Caixa c/ 5 kits

Precisão em cada ponto, confiança em cada sutura



Fio de Sutura Não Absorvível | Polipropileno



- Construção: Monofilamentar
- Agulha: Aço inoxidável AISI 420
- Matéria-prima: Monofilamento de Polipropileno
- Coloração do material: Azul
- Corpo da agulha: agulha de corpo redondo (cylindrical)
- Ponta da agulha: Taper point (round bodied)
- Envelope embalado individualmente



Código	Fio (azul)			Tam.	Agulha Curva	Tipo	Emb. Secundária	Caixa Embarque
	Comp.	USP	Metric					
9842	75 cm	2-0	3	35 mm	1/2	●	Cartucho c/ 24 envelopes	Caixa c/ 50 cartuchos
9843	75 cm	1	4	35 mm	1/2	●		
9841	75 cm	1	4	40 mm	1/2	●		

Fio de Sutura Não Absorvível | Seda



- Construção: Monofilamentar
- Matéria-prima: Seda trançada com revestimento de silicone
- Agulha: Aço inoxidável AISI 420
- Coloração do material: Preto (hematoxilina)
- Ponta da agulha: Ponta cortante
- Envelope embalado individualmente



Código	Fio (preto)			Tam.	Agulha Curva	Tipo	Emb. Secundária	Caixa Embarque
	Comp.	USP	Metric					
9837	45 cm	3-0	2	17 mm	1/2	▲	Cartucho c/ 24 envelopes	Caixa c/ 50 cartuchos
9839	45 cm	3-0	2	17 mm	3/8	▲		
9838	45 cm	4-0	1.5	17 mm	1/2	▲		
9840	45 cm	4-0	1.5	17 mm	3/8	▲		



Fio de Sutura Não Absorvível | Nylon

- Construção: Monofilamentar
- Agulha: Aço inoxidável AISI 420
- Coloração do material: Preto (hematoxilina)
- Curvatura da agulha: 3/8 de círculo
- Corpo da agulha: Corte convencional (curved cutting)
- Ponta da agulha: Ponta cortante
- Envelope embalado individualmente



Código	Fio (preto)			Tam.	Agulha		Emb. Secundária	Caixa Embarque
	Comp.	USP	Metric		Curva	Tipo		
9824	45 cm	0	3.5	20 mm	3/8	▲	Cartucho c/ 24 envelopes	Caixa c/ 50 cartuchos
9830	45 cm	0	3.5	25 mm	3/8	▲		
9819	45 cm	0	3.5	30 mm	3/8	▲		
9826	45 cm	1	4	20 mm	3/8	▲		
9833	45 cm	1	4	25 mm	3/8	▲		
9817	45 cm	1	4	30 mm	3/8	▲		
9832	45 cm	2-0	3	15 mm	3/8	▲		
9821	45 cm	2-0	3	20 mm	3/8	▲		
9828	45 cm	2-0	3	25 mm	3/8	▲		
9834	45 cm	2-0	3	30 mm	3/8	▲		
9816	45 cm	3-0	2	20 mm	3/8	▲		
9822	45 cm	3-0	2	25 mm	3/8	▲		
9835	45 cm	3-0	2	30 mm	3/8	▲		
9815	45 cm	4-0	1.5	20 mm	3/8	▲		
9820	45 cm	4-0	1.5	25 mm	3/8	▲		
9827	45 cm	4-0	1.5	30 mm	3/8	▲		
9825	45 cm	5-0	1	15 mm	3/8	▲		
9818	45 cm	5-0	1	20 mm	3/8	▲		
9829	45 cm	5-0	1	25 mm	3/8	▲		
9836	45 cm	6-0	0.7	15 mm	3/8	▲		
9823	45 cm	6-0	0.7	20 mm	3/8	▲		
9831	45 cm	6-0	0.7	25 mm	3/8	▲		

Nosso método de rotulagem

Os **envelopes** dos Fios de Sutura apresentam **gabarito** em tamanho real que **garante** verificação fácil e precisa do **tamanho e curvatura da agulha**.



Acesse para
saber mais

- Material do fio (1)
- Diâmetro do fio | n° cirúrgico (2)
- Diâmetro do fio | n° métrico (3)
- Comprimento do fio (4)
- Formato da agulha (5)
- Curvatura da agulha (5)
- Perfil da agulha (5)
- Tamanho da agulha (5)





Têxtil e Algodão



Compressa de Gaze Hidrófila Supreme Não Estéril

- Confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela
- Possui 8 camadas e 5 dobras para dentro em toda sua extensão para evitar o desfiamento
- Disponível em dois modelos: 11 e 13 fios
- Tamanho: 7,5x7,5cm (fechada) – 13x30cm (aberta)



Código	Apres.	Emb. Primária	Caixa Embarque
13337	11 Fios	Pacote c/ 500 un	Caixa c/ 14 pacotes
13336	13 Fios	Pacote c/ 500 un	Caixa c/ 14 pacotes



Compressa de Gaze Hidrófila Supreme Estéril

- Confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela
- Possui 8 camadas e 5 dobras para dentro em toda sua extensão para evitar o desfiamento
- Tamanho: 7,5x7,5cm (fechada) – 13x30cm (aberta)



Código	Apres.	Emb. Primária	Caixa Embarque
13335	11 Fios	Pacote c/ 10 un	Caixa c/ 240 pacotes
13334	13 Fios	Pacote c/ 10 un	Caixa c/ 240 pacotes

Atadura de Crepom Classic

- Confeccionada com fios 90% poliéster e 10% elastano
- Confeccionada em tecido tipo trama crochê
- Não estéril
- Bordas acabadas (tecnologia safe)
- Embalada Individualmente



Código	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
13346	06cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 100 pct.
13347	08cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 80 pct.
13348	10cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 70 pct.
13349	12cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 60 pct.
13350	15cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 40 pct.
13351	20cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 35 pct.
13352	25cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 30 pct.
13353	30cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 25 pct.

Curativos que redefinem o cuidado em cada procedimento



Linha Têxtil
Classic e Supreme



100% algodão
super macio

Atadura de Crepom Supreme

- Confeccionada com fios 100% algodão cru
- Confeccionada em tecido tipo trama tela
- Não estéril
- Densidade de 13 fios (conferindo grande elasticidade no sentido longitudinal)
- Embalada Individualmente



Código	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
13338	06cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 72 un.
13339	08cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 72 un.
13340	10cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 84 un.
13341	12cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 84 un.
13342	15cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 72 un.
13343	20cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 72 un.
13344	25cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 96 un.
13345	30cmx1,80m	Pacote c/ 12 Un.	Caixa c/ 72 un.



Compressa de Campo Operatório Estéril Classic e Supreme

- Tecido com fios 100% algodão
- 25X28cm
- Com elemento radiopaco



Código	Gramatura	Apres.	Emb. Primária	Caixa Embarque
13333	13g	Classic	Pacote c/ 05 un	Caixa c/ 64 pacotes
13332	18g	Supreme	Pacote c/ 05 un	Caixa c/ 40 pacotes

Rolo Dental Não Estéril Supreme

- Elaborado com fibras 100% algodão macio de alta absorção
- Adapta ao movimento natural da boca
- Com cinta organizadora para fácil pinçamento
- Formato de cilindro compacto, isento de amido, cloro e impurezas
- Disponível em duas apresentações:
 - **Número 1:** Rolo com dimensão de 3,8 a 4 cm de comprimento e peso por pacote de 32 a 37g
 - **Número 2:** Rolo com dimensão de 3,8 a 4 cm de comprimento e peso por pacote de 41 a 48g.



Código	Apres.	Emb. Primária	Caixa Embarque
13354	Nº 1	Pacote c/ 100 un	Caixa c/ 54 pacotes
13355	Nº 2	Pacote c/ 100 un	Caixa c/ 48 pacotes




Coletores e suportes

Coletor Perfurocortante Premium



- Confeccionado em papelão ondulado virgem
- Sacola plástica de revestimento cor amarela
- Fundo e cinta interna de papel rígido
- Bandeja interna de papelão ondulado
- Cor amarelo gold



Modelo 1,5L possui desconector de agulhas

Código	Apresentação	Dimensões	Caixa Embarque
12064	1,5L	117 X 107 X 137mm	Caixa c/ 20 unidades
12065	3L	135 X 110 X 213mm	
12066	7L	212 X 167 X 219mm	
12067	13L	285 x 205 x 240mm	
12068	20L	300 X 235 X 300mm	

Coletor Perfurocortante Sustentável



- Confeccionado em papelão ondulado reciclado
- Sacola plástica de revestimento cor amarela
- Fundo e cinta interna de papel rígido
- Bandeja interna de papelão ondulado
- Cor amarelo



Código	Apresentação	Dimensões	Caixa Embarque
5650	3L	135 X 110 X 213mm	Caixa c/ 20 unidades
5661	7L	212 X 167 X 219mm	
5673	13L	285 x 205 x 240mm	
5685	20L	300 X 235 X 300mm	

Coletor Perfurocortante Químico



- Confeccionado em papelão ondulado
- Sacola plástica de revestimento cor laranja
- Fundo e cinta interna de papel rígido
- Bandeja interna de papelão ondulado
- Cor laranja

Código	Apresentação	Dimensões	Caixa Embarque
12069	3L	135 X 110 X 213mm	Caixa c/ 20 unidades
12070	7L	212 X 167 X 219mm	
12071	13L	285 x 205 x 240mm	
12072	20L	300 X 235 X 300mm	

Suporte para Coletor



- Confeccionado em aço com pintura EPÓXI
- Cor: branco
- Acompanha parafuso e bucha para o suporte de parede

Código	Apresentação	Dimensões	Caixa Embarque
12075	3L	437 x 230 x 278mm	Caixa c/ 5 unidades
12076	7L	215 x 170 x 220mm	
12077	13L	285 x 205 x 240mm	
12078	20L	305 x 245 x 310mm	



Descarte de resíduos

Saco para Lixo | Resíduos Infectantes – ABNT



- Fabricado em blenda composta com PEBD (Polietileno de Baixa Densidade recuperado - PCR), pigmentos e aditivos
- Produto elaborado e inspecionado segundo normativas ABNT NBR 9191 e ABNT NBR 7500
- Com símbolo indicativo de resíduos infectantes
- Cor: Branco



Código	Vol.	Capac. de carga	Modelo	Embalagem Secundária	Fardo
13536	15L	6 kg	Econômico	100 un	10 pct.
13537	30L	6 kg	Econômico	100 un	10 pct.
13538	50L	6 kg	Econômico	100 un	8 pct.
13539	50L	15 kg	Reforçado	100 un	8 pct.
13540	110L	12 kg	Econômico	100 un	4 pct.
13541	110L	15 kg	Médio	100 un	4 pct.
13542	110L	20 kg	Reforçado	100 un	4 pct.

Saco para Lixo | Resíduos Infectantes



- Fabricado em blenda composta com PEBD (Polietileno de Baixa Densidade recuperado - PCR), pigmentos e aditivos
- Com símbolo indicativo de resíduos infectantes
- Cor: Branco



Código	Vol.	Capac. de carga	Modelo	Embalagem Secundária	Fardo
13543	15L	6 kg	Econômico	100 un	10 pct.
13544	30L	6 kg	Econômico	100 un	10 pct.
13545	50L	15 kg	Econômico	100 un	8 pct.
13546	110L	12 kg	Econômico	100 un	4 pct.
13547	110L	15 kg	Reforçado	100 un	4 pct.

Saco Hamper | Roupas Infectadas



- Fabricado em blenda composta com PEBD (Polietileno de Baixa Densidade recuperado - PCR), pigmentos e aditivos
- Com símbolo indicativo de resíduos infectantes
- Com cordão de polipropileno ou fita de polietileno para amarração embutida na boca do saco
- Solda contínua, homogênea e uniforme para maior segurança



Código	Vol.	Capac. de carga	Modelo	Cor	Embalagem Secundária	Fardo
13549	120L	20 kg	Médio	Red	50 un.	2 pct.
13550	120L	20kg	Médio	Blue	50 un.	2 pct.
13551	120L	20kg	Médio	Green	50 un.	2 pct.
13552	120L	20kg	Médio	Yellow	50 un.	2 pct.

Saco para Enjoo



- Fabricado em polietileno
- Anel em polipropileno
- Livre de látex
- Fácil de fechar e à prova de vazamentos
- Bloqueia odores
- Embalagem destacável que se transforma em suporte

Código	Modelo	Emb. Primária	Caixa Embarque
14785	1500ml	50 unidades	12 caixas c/ 50 un.



Agulhas e Seringas

Simples

Supreme
c/ Disp. de Seg.

Agulha Hipodérmica

- Bisel trifacetado para trauma mínimo de punção
- Lubrificada com silicone
- Conexão compatível com seringas Luer Lock e Luer Slip
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores
- Embalada individualmente



Código		Cor	Gauge	Tamanho	Embalagem Secundária	Caixa Embarque
Simples	C/ Disp. de Seg.					
8834	-		30G	13 X 0,30mm(30G X 1/2)	Modelo Simples	
8846	9506		26G	13 X 0,45mm (26G X 1/2)		
8858	9507		24G	20 X 0,55mm (24G X 3/4)		
8860	9508		23G	25 X 0,60mm (23G X 1)		
8871	9509		22G	25 X 0,70mm (22G X 1)	Cartucho c/ 100 un.	Caixa c/ 100 cartuchos
8883	9510		21G	25 X 0,80mm (21G X 1)		
8895	9511		22G	30 X 0,70mm (22G X 1 1/4)		
8907	9512		21G	30 X 0,80mm (21G X 1 1/4)		
8919	9513		18G	40 X 1,20mm (18G X 1 1/2)	Cartucho c/ 100 un.	Caixa c/ 10 cartuchos
10351	-		16G	40 X 1,60mm (16G X 1 1/2)		

O modelo com dispositivo de segurança faz parte da linha Medix Supreme



Agulha para Aspiração

- Ponta romba
- Conexão compatível com seringas Luer Lock e Luer Slip
- Embalada individualmente



Obs: Uso exclusivo para aspiração de medicamentos. Não utilizar para aplicações injetáveis na pele.

Cód.	Cor	Gauge	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
11991	Vermelho	18G	25 X 1,2mm (18G 1)	Cartucho c/ 100 un.	Caixa c/ 100 cartuchos
11992	Vermelho	18G	40 X 1,2mm (18G 1 1/2)		

Agulha Descartável para Caneta de Insulina

- Compatível com as principais marcas de caneta do mercado
- Embalada individualmente



Código	Gauge	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
9659	31G	5mm	Púrpura	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 20 cartuchos
9658	31G	6mm	Amarelo		
9657	31G	8mm	Azul		
9656	32G	4mm	Verde		



Agulha Gengival




- Bisel trifacetado
- Cânula siliconizada
- Estojo plástico protetor com lacre de segurança
- Rosca interna universal para encaixe seguro em seringas do tipo carpule
- Embalada individualmente

STERILE

Cód.	Gauge	Modelo	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
10850	30G	Longa	30mm x 0,3mm	Cartucho c/ 100 un.	Caixa c/ 50 cartuchos
10851	27G	Longa	30mm x 0,4mm		
10800	30G	Curta	21mm x 0,3mm		
10801	30G	Curta	25mm x 0,3mm		
12123	30G	Extra curta	16mm x 0,3mm		

Seringa Hipodérmica

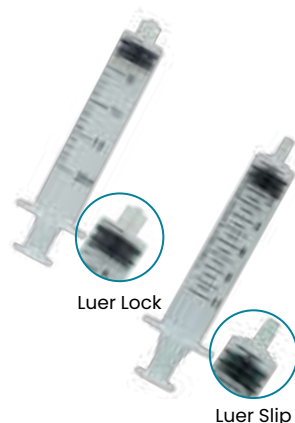

Luer Lock

Luer Slip

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Sem agulha
- Êmbolo de borracha natural (contém látex)
- Embalada individualmente

STERILE

Obs: Luer Slip 60ml – Bico lateral

Código		Vol.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
Luer Slip	Luer Lock			
8700	8712	3ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 3000 unidades
8675	8724	5ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 2400 unidades
8699	8687	10ml	Caixa c/ 100 und.	Caixa c/ 1600 unidades
9534	9533	20ml	Caixa c/ 50 und.	Caixa c/ 800 unidades
9536	9535	60ml	Caixa c/ 25 und.	Caixa c/ 400 unidades

Seringa Hipodérmica com Agulha



Luer Lock

Luer Slip

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Êmbolo de borracha natural (contém látex)
- Agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado
- Embalada individualmente

STERILE

Código		Volume	Gauge	Tamanho	Emb. Secundária	Caixa Embarque
Luer Slip	Luer Lock					
10154	10155	3ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 3000 unidades
10156	10157	5ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 2400 unidades
10158	10159	10ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 1600 unidades
10160	10161	20ml	22G	25 x 0,70mm 22G x 1	Caixa c/ 50 un.	Caixa c/ 800 unidades



Seringa Bico Cateter

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Anel de retenção
- Êmbolo de borracha natural
- Encaixe seguro para cateteres e sondas
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Sem agulha
- Embalada individualmente



Código	Vol.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9913	60ml	Caixa c/ 25 unidades	Caixa c/ 300 unidades

Seringa Dosadora

- Confeccionada em polipropileno
- Êmbolo em borracha sintética
- Uso único
- Apenas para uso oral
- Não compatível com agulhas hipodérmicas e infusões via intravenosa ou intramuscular
- Produto não estéril



Código	Vol.	Emb. Primária	Caixa Embarque
9997	3ml	Pacote c/ 150 unidades	Pacote c/ 3600 unidades
9998	5ml	Pacote c/ 100 unidades	Pacote c/ 2400 unidades
9999	10ml	Pacote c/ 80 unidades	Pacote c/ 1920 unidades
10000	20ml	Pacote c/ 40 unidades	Pacote c/ 960 unidades



Seringa de Insulina

- Confeccionada em polipropileno
- Corpo transparente
- Lubrificada com silicone de grau médico
- Graduação 2 em 2 UI
- Não possui espaço residual
- Embalado individualmente



Código	Tipo	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
8027	Sem Agulha Slip	1ml	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 3200 un.
7092	Agulha Acoplada Slip	13 x 0,45mm 100UI 1ml (26G 1/2")	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 3200 un.
7080	Agulha Fixa	12,7 x 0,33mm 100UI 1ml (29G x 1)	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 2000 un.
9421	Agulha Fixa	8 x 0,30mm 100UI 1ml (30G 5/16")	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 2000 un.
10258	Agulha Fixa	0,25 x 6mm 100UI 1ml (31G x 1/4)	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 2000 un.

Lanceta de Segurança Supreme



- Confeccionada em polipropileno
- Agulha de aço inoxidável trifacetada
- Mecanismo de segurança com a retração automática da agulha após o uso
- Produto de uso único



Supreme

Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
10212	21G (1.8mm)	●	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 20 cartuchos
10213	26G (1.8mm)	●		
10214	28G (1.5mm)	●		
12162	28G (1.8mm)	●		

Lanceta para Lancetador



- Confeccionada em ABS e polietileno
- Agulha de aço inoxidável lubrificada
- Compatível com a maioria dos lancetadores do mercado
- Produto de uso único



Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
10180	28G (0.36mm)	●	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 50 cartuchos
10181	30G (0.30mm)	●		
10182	33G (0.20mm)	●		

Lancetador (Caneta Lancetadora)



- Confeccionado em plástico ABS
- Com 9 níveis para ajuste de profundidade na punção
- Lancetas não acompanham o produto
- Produto não estéril
- Produto reutilizável
- Embalado individualmente

Código	Tamanho	Caixa Embarque
10689	Único	Caixa c/ 100 unidades



Acesso vascular



Simples

Cáteter Intravenoso Periférico

- Confeccionado em material teflon (FEP)
- Agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado
- Conector Luer Lock
- Câmara flashback
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores
- Embalado individualmente



Código					
Simples	Cor	Gauge	Emb. Secundária	Caixa Embarque	
6669	●	14G	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 1000 unidades	
6670	●	16G			
6682	●	18G			
6694	●	20G			
6706	●	22G			
6718	●	24G			
10115	●	26G			




Cáteter Intravenoso Periférico com Dispositivo de Segurança Automático

- Confeccionado em poliuretano (PUR)
- Agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado
- Conector Luer Lock
- Câmara flashback
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores
- Acionamento automático do dispositivo de segurança (sistema passivo) recobre a ponta do bisel
- Embalado individualmente



Código	Cor	Gauge	Emb. Secundária	Caixa Embarque	
9689	●	14G	Cartucho c/ 100 unidades	Caixa c/ 1000 unidades	
9690	●	16G			
9736	●	18G			
9737	●	20G			
9738	●	22G			
9739	●	24G			

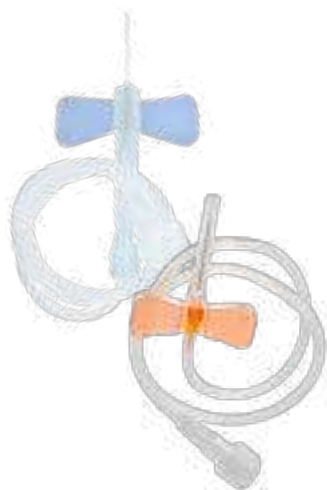Supreme
c/ Disp. de Seg

Simples

Scalp para Infusão Intravenosa

- Confeccionado em aço inoxidável com bisel trifacetado
- Conector fêmea com tampa rosqueável
- Tubo confeccionado em PVC flexível
- Asas flexíveis para empunhadura
- Embalado individualmente



Código					
Simples	Com Disp. de Seg.	Cor	Gauge	Embalagem Secundária	Caixa Embarque
6388	9452	○	19G	Cartucho c/ 100 un.	Caixa c/ 20 cartuchos
6390	9453	●	21G		
6401	9454	●	23G		
6413	9500	●	25G		
6425	9455	●	27G		

O modelo com dispositivo de segurança faz parte da linha Medix Supreme





Dispositivo Transferidor de Soluções

- Confeccionado em plástico ABS e polipropileno
- Pontas de perfuração padrão ISO com protetor
- Ponta de transferência fina levemente siliconada com corte arredondado
- Tampa protetora
- Embalado individualmente



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
13634	Caixa c/ 50 unidades	Caixa c/ 500 unidades



Tampa Vedante

- Confeccionada em polietileno (modelo Slip e Lock) e polipropileno (modelo combinado)
- Apresentação Fêmea (Luer Slip): para conexão com ponta de equipo gravitacional, equipo multivias, seringas e dispositivos com bico liso
- Apresentação Macho (Luer Lock): para conexão com cateter, scalp, torneira 3 vias e dispositivos com bico Luer Lock
- Apresentação Macho/Fêmea (Slip/Lock): para conexão com dispositivos que possuem bico Slip ou Lock
- Recomendado uso único
- Atóxica e apirogênica
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
10280	Luer Macho/Fêmea	Pacote c/ 200 unidades	Caixa c/ 9600 unidades
10281	Luer Fêmea		
10282	Luer Macho		



Conector Valvulado

- Corpo confeccionado em policarbonato e membrana em borracha de silicone
- Dispositivo de acesso sem agulha
- Superfície lisa, transparente e de fácil desinfecção
- Sistema fechado
- Atóxico e apirogênico
- Livre de: DEHP e PVC
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
10283	Positivo	Pacote c/ 250 un.	Caixa c/ 5000 un.
10284	Negativo	Pacote c/ 250 un.	Caixa c/ 2000 un.
10285	Neutro	Pacote c/ 250 un.	Caixa c/ 5000 un.



Terapia de infusão

Equipo de Infusão Gravitacional

- Confeccionado em polietileno, polipropileno e acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
- Tubo flexível de PVC de 150cm (1)
- Pinça rolete reguladora de fluxo (2)
- Câmara gotejadora flexível com filtro de partículas 15µ (3)
- Ponta perfurante com tampa protetora (4)
- Embalado individualmente



Simple



Completo



Obs: Equipo Completo possui abertura para ventilação de ar com filtro (membrana hidrófoba e bacteriológica) e injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante



Injetor lateral (5)




Abertura para ventilação de ar (6)

Código		Apresentação	Caixa Embarque
Simple	Completo		
7020	8968	Macrogotas Polybag Luer Slip	Caixa c/ 500 unidades
-	6266	Macrogotas Papel Grau Luer Slip	Caixa c/ 400 unidades
-	6278	Microgotas Papel Grau Luer Slip	Caixa c/ 400 unidades
-	9531	Macrogotas Polybag Luer Lock	Caixa c/ 500 unidades



Conheça o **Equipo de Nutrição Enteral** na **página 23**

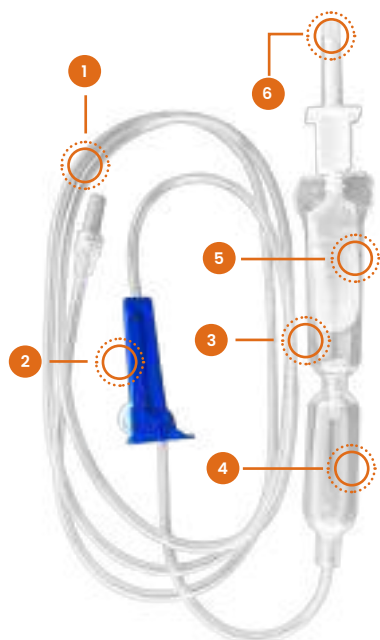


Equipo para Transfusão de Sangue

- Confeccionado em polietileno, polipropileno e acrilonitrila-butadieno estireno (ABS)
- Tubo flexível de PVC de 150cm (1)
- Pinça rolete reguladora de fluxo (2)
- Câmara dupla flexível:
 - 1ª câmara: dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos (3)
 - 2ª câmara: visualização e controle de gotejamento (4)
- Filtro de sangue e hemocomponentes em nylon66 com 180µm (5)
- Ponta perfurante com tampa protetora (6)
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
11328	Macrogotas Papel Grau Luer Lock	Caixa c/ 100 unidades

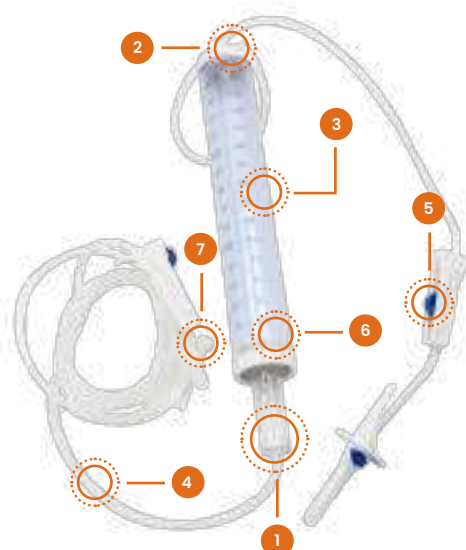

Equipo de Infusão Gravitacional Bureta

- Confeccionado em polietileno, polipropileno e plástico ABS
- Câmara gotejadora flexível com filtro de partículas 15µ (1)
- Abertura para ventilação de ar com filtro (2)
- Bureta com capacidade de 150ml (3)
- Tubo flexível de PVC com 150cm (4)
- Pinça rolete reguladora de fluxo (5)
- Membrana flutuante (boia) (6)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante (7)
- Embalado Individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
9537	Microgotas Papel Grau Luer Lock	Caixa c/ 100 unidades



Extensor Multivias

- Tubo confeccionado em PVC
- Clamp confeccionado em polietileno
- Via de acesso venoso com conector Luer Slip
- Embalado individualmente



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6486	Pacote c/ 40 unidades	Caixa c/ 800 unidades



Simples



Supreme
Lipídio Resistente

Torneira | 3 Vias

- Tampa superior: confeccionada em polipropileno
- Via de acesso venoso: a depender da apresentação (conforme tabela)
- 2 vias com conexões compatíveis com Luer Lock e Luer Slip
- Manipulo giratório: confeccionado em polietileno
- Corpo principal: confeccionado em policarbonato
- Tampa protetora: confeccionada em polietileno
- Embalada individualmente



Obs: Somente a apresentação Lipídio Resistente é compatível com a utilização de lipídios, hemoderivados, citostáticos e pressão de até 6 BAR (87 PSI) e faz parte da linha Supreme

Cód.	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6498	Simples Luer Slip	Cartucho c/ 50 unidades	Caixa c/ 10 cartuchos
9762	Lipídio Resist. Luer Lock		



Oncologia

Medix na Oncologia

Portfólio que eleva o cuidado no tratamento oncológico



Agulha Huber Supreme

- Agulha para punção em cateter totalmente implantado (Port-a-Cath)
- Ponta proximal com entrada tipo Luer slip/lock (6)
- Agulha angulada a 90° (1) com capa protetora
- Possui dispositivo de segurança para melhor fixação com curativo (3)
- Com extensão (5), clamp corta fluxo (4) e asa para punção (2)
- Extensão em PVC



Código	Tamanho	Cor	Emb. Secundária	Caixa Embarque
12831	19G x 25			
12830	20G x 15		Cartucho c/ 15 un.	Caixa c/ 8 cartuchos
12829	20G x 19			



Supreme

Infusão segura que reduz riscos de extravasamento

Asa dupla
que garante estabilidade na punção



Base fixa quadrada
para maior segurança e conforto




Bomba Elastomérica Descartável

- Alça de suporte (1)
- Reservatório rígido, transparente com escala graduada (2 e 3)
- Elastômero de silicone e êmbolo com formato cônico (4 e 5)
- Porta de preenchimento com válvula antirrefluxo (6)
- Tubo de PVC de 105cm com sistema antidobras (7)
- Clamp de Robert para fechamento da extensão (8)
- Filtro de partículas de 1,2µm (9)
- Filtro de ar de 0,2µm (9)
- Conector Luer Lock com tampa protetora (10)
- Restritor – capilar de vidro (11)
- Volume do reservatório: 100ml
- Taxa de infusão: 2ml/hora
- Acompanha bolsa protetora



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
12018	Unitário	Caixa c/ 10 unidades

- Portátil
- Até 50h de infusões contínuas
- Não utiliza bateria e eletricidade

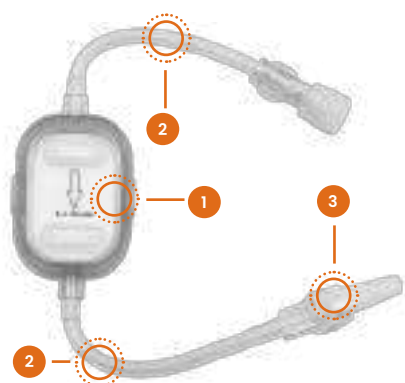

Filtro de Infusão Supreme

- Previne e impede a passagem de partículas, endotoxinas bacterianas e bolhas de ar (1)
- Resistente a pressões de 50-300kpa
- Com tubo extensor (2)
- “Priming” de 2,3ml
- Via de acesso venoso com conexão luer lock (3)
- Livre de látex e PVC



Código	Emb. Secundária	Caixa Embarque
12999	Caixa c/ 50 un.	Caixa c/ 600 un.





Respiratória


Cânula de Guedel



- Confeccionada em polietileno de alta densidade e PVC
- Parte da mordida confeccionada em policarbonato
- Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral
- Produto não estéril
- Embalada individualmente



Cód.	Tam.	Comprimento	Cor	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9904	000	35mm ± 2,5	●	Caixa c/ 150 un.	Caixa c/ 1500 un.
9905	00	50mm ± 2,5	●	Caixa c/ 150 un.	Caixa c/ 1500 un.
9906	0	60mm ± 2,5	●	Caixa c/ 150 un.	Caixa c/ 1500 un.
9907	1	70mm ± 2,5	○	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 1000 un.
9908	2	80mm ± 2,5	●	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 1000 un.
9909	3	90mm ± 2,5	●	Caixa c/ 80 un.	Caixa c/ 800 un.
9910	4	100mm ± 2,5	●	Caixa c/ 70 un.	Caixa c/ 700 un.
9911	5	110mm ± 2,5	●	Caixa c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.
9912	6	120mm ± 2,5	●	Caixa c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.

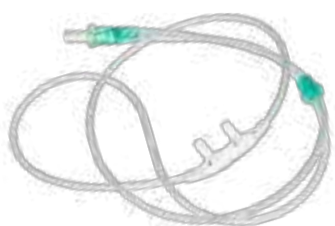

Sem extensor

Cateter Tipo Óculos

- Pronga em PVC flexível e extra macia
- Cateter com 50cm
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
10435	Sem tubo extensor	Caixa c/ 500 un.
9934	Com tubo extensor	Caixa c/ 100 un.



Com extensor



Conheça mais sobre o produto

Obs: Apresentação com tubo extensor possui comprimento aproximado de 2m (cateter com 50cm e tubo extensor acoplado com 1,4m)

Tubo Extensor de Oxigênio

- Confeccionado em PVC
- Comprimento aproximado 2m
- Embalado individualmente



Código	Caixa Embarque
9603	Caixa c/ 100 unidades





Máscara de Oxigênio Não Reinalante

- Máscara facial e tubo extensor em PVC
- Embalada individualmente
- Máscara de oxigênio não reinalante
- Clip nasal ajustável de alumínio



Código	Apresentação	Reservatório	Caixa Embarque
9618	Pediátrico	600ml	Caixa c/ 100 unidades
9616	Adulto	1.000ml	



Máscara Laríngea Supreme

- Confeccionada em PVC
- Possui cuff, válvula unidirecional e balão de controle
- Base com conformação anatômica
- Embalada individualmente



Cód.	Tamanho	Comp. tubo	Comp. máscara	Embalagem Secundária	Caixa Embarque
10170	1.0: 5kg	90mm ± 10mm	39.0mm ± 5mm	Caixa c/ 5 un.	Caixa c/ 50 un.
10171	1.5: 5-10kg	100mm ± 10mm	48.0mm ± 5mm		
10172	2.0: 10-20kg	120mm ± 10mm	57.5mm ± 5mm		
10173	2.5: 20-30kg	130mm ± 10mm	67.0mm ± 5mm		
10174	3.0: 30-50kg	175mm ± 10mm	78.0mm ± 5mm		
10175	4.0: 50-70kg	175mm ± 10mm	88.5mm ± 5mm		
10176	5.0: ≥ 70kg	190mm ± 10mm	99.5mm ± 5mm		



Reanimador Manual em PVC

- Reanimador confeccionado em PVC
- Válvula e adaptador de válvula de PEEP confeccionados em silicone
- Itens inclusos: máscara, reservatório, válvula limitadora de pressão e tubo extensor com aproximadamente 2m de comprimento
- Volume do reservatório: 2000ml
- Produto de uso único não autoclavável
- Produto não estéril
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
10210	Adulto	Caixa c/ 24 unidades

Tubo Endotraqueal Supreme

- Para intubação oral e nasal
- Ponta atraumática
- Olho de murphy
- Curva Magill
- Conector ISO padrão de 15mm
- Confeccionado em PVC termossensível
- Embalado individualmente



Supreme




Obs: A apresentação com cuff possui válvula unidirecional e balão de controle

Código		Tam.	Comprimento	Emb. Secundária	Caixa Embarque
S/ cuff	C/cuff				
10046	-	2.0	130mm ± 5mm	Cartucho c/ 25 unidades	Caixa c/ 200 un.
10047	10020	2.5	140mm ± 5mm		
6951	9549	3.0	160mm ± 5mm		
6963	9550	3.5	180mm ± 5mm		
6975	9551	4.0	200mm ± 5mm		
6987	9552	4.5	220mm ± 5mm		
10048	6720	5.0	240mm ± 5mm		
10049	6731	5.5	270mm ± 5mm		
10050	6743	6.0	280mm ± 5mm		
10051	6755	6.5	290mm ± 5mm		
-	6767	7.0	300mm ± 5mm		
-	6779	7.5	310mm ± 5mm		
-	6926	8.0	320mm ± 5mm		
-	9553	8.5	320mm ± 5mm		
-	6938	9.0	320mm ± 5mm		
-	13897	9.5	320mm ± 5mm		
-	6940	10.0	320mm ± 5mm		



Com mola interna

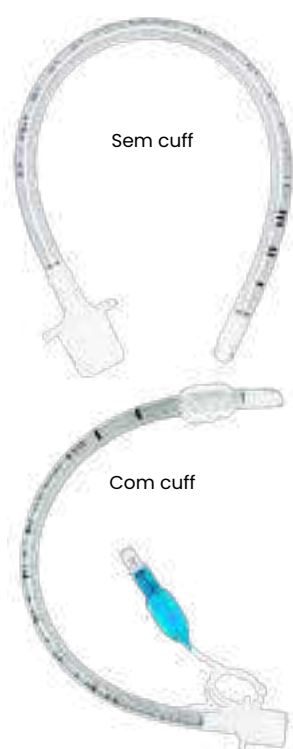

Tubo Endotraqueal Aramado Supreme

- Para intubação oral e nasal
- Ponta atraumática
- Olho de murphy
- Curva Magill
- Conector ISO padrão de 15mm
- Confeccionado em PVC termossensível
- Mola interna confeccionada em aço inoxidável
- Embalado individualmente



Supreme

Obs: A apresentação com cuff possui válvula unidirecional e balão de controle

Código		Tam.	Comprimento	Emb. Secundária	Caixa Embarque
S/ cuff	C/cuff				
9464	-	3.0	185mm ± 5mm	Cartucho c/ 25 un.	Caixa c/ 200 un.
9465	-	3.5	195mm ± 5mm		
9467	-	4.5	240mm ± 5mm		
-	9468	5.0	256mm ± 5mm		
-	9469	5.5	286mm ± 5mm		
-	9470	6.0	295mm ± 5mm		
-	9471	6.5	301mm ± 5mm		
-	9472	7.0	315mm ± 5mm		
-	9473	7.5	325mm ± 5mm		
-	9474	8.0	337mm ± 5mm		
-	9475	8.5	337mm ± 5mm		
-	9476	9.0	337mm ± 5mm		
-	9477	9.5	337mm ± 5mm		

Tubo Endotraqueal com Aspiração



- Para intubação oral e nasal
- Possui cuff, válvula unidirecional e balão de controle
- Ponta atraumática
- Olho de murphy
- Curva Magill
- Conector ISO padrão de 15mm
- Confeccionado em PVC termossensível
- Via de aspiração integrada
- Embalado individualmente



Cód.	Tam.	Comprimento	Emb. Secundária	Caixa Embarque
10332	7.0	310.0 ± 10mm	Cartucho c/ 25 un.	Caixa c/ 200 un.
10333	7.5	320.0 ± 10mm		
10334	8.0	330.0 ± 10mm		
10335	8.5	340.0 ± 10mm		
10336	9.0	350.0 ± 10mm		

Tubo Traqueostomia Sem Cuff Supreme



- Confeccionado em PVC termossensível
- Ponta atraumática
- Possui curvatura anatômica
- Conector ISO padrão de 15mm
- Peça de fixação flexível com fita em tecido pré-conectada
- Embalado individualmente



Cód.	Tam.	Comprimento	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6889	3.0	56,5mm ± 5mm	Cartucho c/ 10 un.	Caixa c/ 100 un.
6890	3.5	56,5mm ± 5mm		
6902	4.0	56,5mm ± 5mm		
6914	4.5	56,5mm ± 5mm		
9484	5.0	62mm ± 2mm		
9485	5.5	67mm ± 2mm		
9486	6.5	77mm ± 2mm		
9487	7.0	80mm ± 2mm		

Tubo Traqueostomia Com Cuff Supreme



- Confeccionado em PVC termossensível
- Possui cuff, válvula unidirecional e balão de controle
- Ponta atraumática
- Possui curvatura anatômica
- Conector ISO padrão de 15mm
- Peça de fixação flexível com fita em tecido pré-conectada
- Embalado individualmente



Cód.	Tam.	Comprimento	Emb. Secundária	Caixa Embarque
6780	5.0	62mm ± 2mm	Cartucho c/ 10 un.	Caixa c/ 10 cartuchos
6792	5.5	67mm ± 2mm		
6804	6.0	67mm ± 2mm		
6816	6.5	77mm ± 2mm		
6828	7.0	80mm ± 2mm		
6830	7.5	84mm ± 2mm		
6841	8.0	90mm ± 2mm		
6853	8.5	90mm ± 2mm		
6865	9.0	97mm ± 2mm		
6877	10.0	97mm ± 2mm		




Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Aberto Supreme

- Confeccionada em PVC
- Contém 2 orifícios laterais alternados
- Possui ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas
- Possibilita uso com válvula de pressão negativa
- Embalada individualmente



Cód.	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9873	4FR	50cm	Pacote c/ 50 un.	Caixa c/ 500 un.
9874	6FR	50cm		
9875	8FR	50cm		
9876	10FR	50cm		
9877	12FR	50cm		
9878	14FR	50cm		
9879	16FR	50cm		
9880	18FR	50cm		
10350	20FR	50cm		

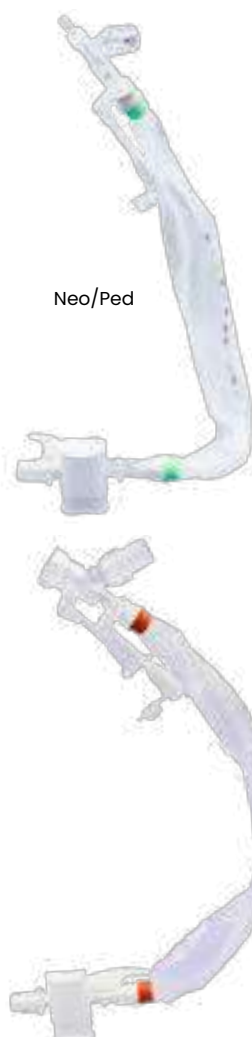

Neo/Ped

Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado Supreme - 24h

- As apresentações neonatal e pediátrica possuem marca de graduação colorida no tubo
- Trava para ativação da aspiração
- Manga em EVA
- Via de irrigação com sistema "needle-less"
- Embalada individualmente



Cód.	Apresentação	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9726	Neo/Ped	5FR	32cm	Caixa c/ 10 un.	Caixa c/ 100 un.
9727	Neo/Ped	6FR	32cm		
9728	Neo/Ped	8FR	36cm		
9729	Neo/Ped	10FR	45,5cm		
9720	Traqueostomia	10FR	36cm		
9721	Traqueostomia	12FR	36cm		
9722	Traqueostomia	14FR	36cm		
9723	Traqueostomia	16FR	36cm		
9712	Endotraqueal	10FR	54cm		
9713	Endotraqueal	12FR	54cm		
9714	Endotraqueal	14FR	54cm		
9715	Endotraqueal	16FR	54cm		



Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado Supreme - 72h

- Sistema "Stop Valve" veda a sonda em uma câmara isoladamente, evitando o entupimento da rede de vácuo por secreção durante a lavagem
- Trava para ativação da aspiração
- Manga em EVA
- Embalada individualmente



Cód.	Apresentação	Tam.	Comp.	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9724	Traqueostomia	12FR	36cm		
9725	Traqueostomia	14FR	36cm		
9716	Endotraqueal	10FR	54cm	Caixa c/ 100 un.	Caixa c/ 100 un.
9717	Endotraqueal	12FR	55cm		
9718	Endotraqueal	14FR	56cm		
9719	Endotraqueal	16FR	57cm		



Filtro HMEF

- Filtração bacteriana > BFE 99.999%
- Filtração viral > VFE 99.99%
- Filtro com papel HME
- Conector ISO padrão de 15mm
- Acompanha traqueia corrugada
- Embalado individualmente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
8272	Pediátrico	Caixa c/ 100 unidades
8260	Adulto	Caixa c/ 100 unidades

Filtro HEPA

- Fabricado em polipropileno e copolímeros
- Filtração bacteriana > BFE 99.999%
- Filtração viral > VFE 99.99%
- Sem tubo
- Embalado individualmente
- Papel absorvente



Código	Apresentação	Caixa Embarque
9976	Adulto	Caixa c/ 100 unidades



Medix
BRASIL
Profissional

Panos



Pano Wiper Reutilizável | 28x240 | 600 panos

- Confeccionado em 80% celulose e 20% polipropileno
- Não solta fibras
- 600 panos

Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
-	28x40cm	●	1 rolo	6 rolos
13328	28x40cm	○		



Pano Wiper Reutilizável | 28x35,2 | 88 panos

- Confeccionado em 70% celulose e 30% polipropileno
- Não solta fibras
- 88 panos

Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
13329	28x40cm	○	1 rolo	6 rolos



Pano Wiper Reutilizável | 28x35 | 100 panos

- Confeccionado em 80% celulose e 20% polipropileno
- Não solta fibras
- 100 panos

Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
13330	28x35cm	○	Cartucho c/ 100 panos	Caixa c/ 12 cartuchos



Pano Wiper Reutilizável | 45x45 | 50 panos

- Confeccionado em 80% celulose e 20% polipropileno
- Não solta fibras
- 50 panos

Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
13331	45x45cm	○	1 rolo	Caixa c/ 24 rolos

O lançamento que vai
transformar a rotina de
limpeza profissional



Reutilizável



Ultra
absorção



Mais
resistente



Descarte de Resíduos




Saco para Lixo | Resíduos comuns

- Fabricado em blenda composta com PEBD (Polietileno de Baixa Densidade recuperado - PCR), pigmentos e aditivos
- Produto sustentável, composto a partir de insumos 100% reciclados e compatíveis com novos processos de reciclagem
- Desenvolvido em diversos tamanhos e níveis de resistência para atender às mais variadas aplicações
- Ideal para residências, estabelecimentos comerciais, coleta seletiva, ambientes industriais e hospitalares (áreas comuns)
- Cor: Preto



Código	Vol.	Capacidade de carga	Modelo	Embalagem Secundária	Fardo
13526	20L	6 kg	Econômico	100 un.	10 pct.
13527	40L	6 kg	Econômico	100 un.	10 pct.
13528	60L	6 kg	Econômico	100 un.	8 pct.
13529	110L	6 kg	Leve	100 un.	4 pct.
13530	110L	12 kg	Econômico	100 un.	4 pct.
13531	110L	18 kg	Médio	100 un.	4 pct.
13532	110L	25 kg	Reforçado	100 un.	4 pct.
13533	200L	12 kg	Econômico	100 un.	2 pct.
13534	200L	20 kg	Médio	100 un.	2 pct.
13535	200L	25 kg	Reforçado	100 un.	2 pct.

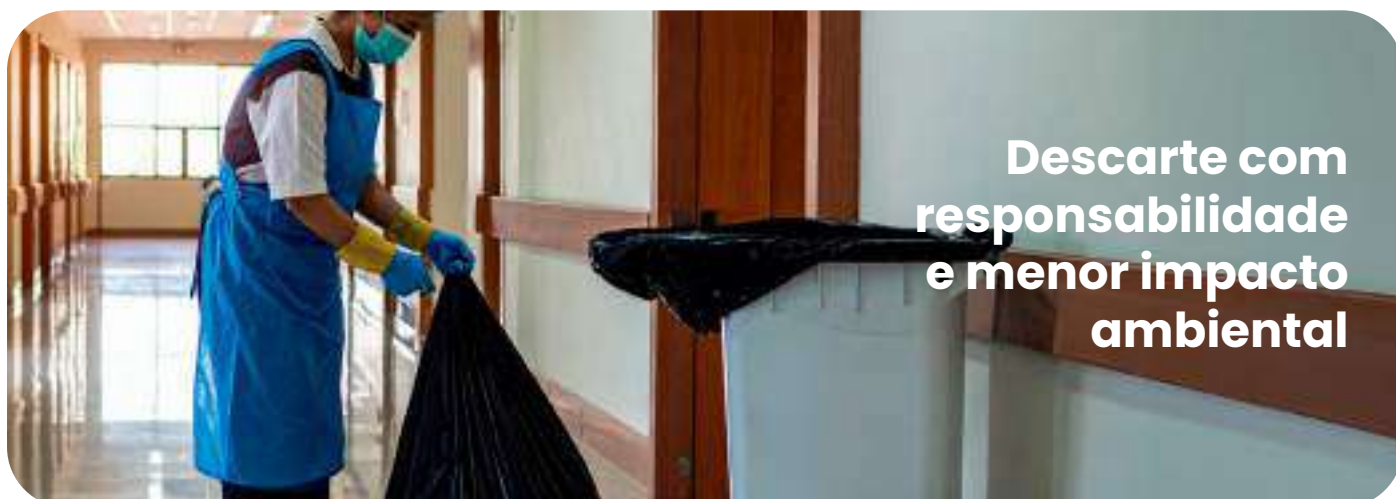

**Descarte com
responsabilidade
e menor impacto
ambiental**

Proteção Química



CA52077



Multiuso Plus | Luva de Látex Ranhurada

- Luva em látex reforçado, para entregar proteção mecânica, química e térmica nas mais diversas atividades.
- Desenho antiderrapante profissional na palma, proporcionando aderência em todas as superfícies.
- Cano extra longo ajustável (ranhurado), dificultando a entrada de líquidos e facilitando a movimentação no dia a dia.
- Lisa internamente e clorada para facilitar o calçar e descalçar.

Código	Tamanho	Cor	Apresentação
14051	P (7)	●	12 pares por pacote Caixa c/ 120 pares
14052	M (8)	●	
14053	G (9)	●	
14054	GG (10)	●	

Medix

BRASIL

Sua referência
nacional em
proteção



Acesse e conheça o
nosso universo laranja

 www.medixbrasil.com.br
   medixbrasil

Medix^{&co}

**Sede Administrativa**

Rua Paraná, 1791 - Centro
85812-010 | Cascavel/PR
(45) 3039-4242

**Centro de Distribuição**

Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4
89248-000 | Garuva/SC
(47) 3432-8741

**PRODUTOS
CONFIÁVEIS
GARANTEM A
CONSOLIDAÇÃO
DA MARCA**





Elaborados com atenção meticulosa aos detalhes, os produtos **Technofio proporcionam tranquilidade para aqueles que valorizam a precisão em suas atividades.**

Nossas suturas cirúrgicas são amplamente reconhecidas como ferramentas de confiança, garantindo segurança e uniformidade em cada procedimento. Isso é resultado de nossa infraestrutura cuidadosamente configurada para atender às demandas específicas de cada produto, aliada a protocolos de produção rigorosos.

NYLON

MONOFILAMENTO PRETO




TIPO DE AGULHA

▼ TRIANGULAR CORTANTE



CURVATURA DA AGULHA

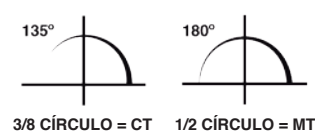


3/8 CÍRCULO = CT 1/2 CÍRCULO = MT

Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
NY04CT20	0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY04CT30	0	45cm	CT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY04CT40	0	45cm	CT40	4,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24CT20	2-0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24CT25	2-0	45cm	CT25	2,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24CT30	2-0	45cm	CT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24CT40	2-0	45cm	CT40	4,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24MT20	2-0	45cm	MT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24MT25	2-0	45cm	MT25	2,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY24MT30	2-0	45cm	MT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34CT20	3-0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34CT24	3-0	45cm	CT24	2,4cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34CT30	3-0	45cm	CT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34CT40	3-0	45cm	CT40	4,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34MT15	3-0	45cm	MT15	1,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34MT20	3-0	45cm	MT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34MT25	3-0	45cm	MT25	2,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY34MT30	3-0	45cm	MT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44CT20	4-0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44CT24	4-0	45cm	CT24	2,4cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44CT30	4-0	45cm	CT30	3,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44MT15	4-0	45cm	MT15	1,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44MT20	4-0	45cm	MT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY44MT25	4-0	45cm	MT25	2,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY54CT16	5-0	45cm	CT16	1,65cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY54CT20	5-0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY54MT15	5-0	45cm	MT15	1,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY54MT25	5-0	45cm	MT25	2,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY64CT16	6-0	45cm	CT16	1,65cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY64CT20	6-0	45cm	CT20	2,0cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA
NY64MT15	6-0	45cm	MT15	1,5cm	24	PRETA	CUTICULAR / PLÁSTICA

CATEGUTE

CROMADO




TIPO DE AGULHA

● CILÍNDRICA



CURVATURA DA AGULHA

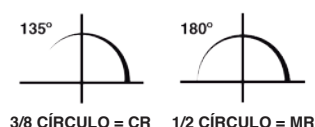

Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
CC17CR30	1	75cm	CR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC17MR35	1	75cm	MR35	3,5cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC17MR40	1	75cm	MR40	4,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC19MR50	1	90cm	MR50	5,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC07CR30	0	75cm	CR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC07MR25	0	75cm	MR25	2,5cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC07MR30	0	75cm	MR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC07MR35	0	75cm	MR35	3,5cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC07MR40	0	75cm	MR40	4,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC09MR50	0	90cm	MR50	5,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC27CR30	2-0	75cm	CR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC27MR20	2-0	75cm	MR20	2,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC27MR25	2-0	75cm	MR25	2,5cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC27MR30	2-0	75cm	MR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC27MR35	2-0	75cm	MR35	3,5cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC27MR40	2-0	75cm	MR40	4,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC29MR50	2-0	90cm	MR50	5,0cm	24	MARROM	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CC37CR30	3-0	75cm	CR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC37MR20	3-0	75cm	MR20	2,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC37MR25	3-0	75cm	MR25	2,5cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC37MR30	3-0	75cm	MR30	3,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC47MR15	4-0	75cm	MR15	1,5cm	24	MARROM	UROLOGIA
CC47MR20	4-0	75cm	MR20	2,0cm	24	MARROM	GASTROINTESTINAL
CC57MR15	5-0	75cm	MR15	1,5cm	24	MARROM	UROLOGIA

CATEGUTE

SIMPLES




TIPO DE AGULHA

● CILÍNDRICA



CURVATURA DA AGULHA

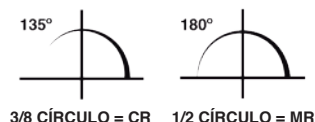

Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
CS17CR30	1	75cm	CR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS17MR40	1	75cm	MR40	4,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS19MR50	1	90cm	MR50	5,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS07CR30	0	75cm	CR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS07MR25	0	75cm	MR25	2,5cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS07MR30	0	75cm	MR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS07MR35	0	75cm	MR35	3,5cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS07MR40	0	75cm	MR40	4,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS09MR50	0	90cm	MR50	5,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS27CR20	2-0	75cm	CR20	2,0cm	24	AMARELA	AMIGDALECTOMINA
CS27CR30	2-0	75cm	CR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS27MR20	2-0	75cm	MR20	2,0cm	24	AMARELA	AMIGDALECTOMINA
CS27MR25	2-0	75cm	MR25	2,5cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS27MR30	2-0	75cm	MR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS27MR35	2-0	75cm	MR35	3,5cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS27MR40	2-0	75cm	MR40	4,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS29MR50	2-0	90cm	MR50	5,0cm	24	AMARELA	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
CS37CR30	3-0	75cm	CR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS37MR20	3-0	75cm	MR20	2,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS37MR25	3-0	75cm	MR25	2,5cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS37MR30	3-0	75cm	MR30	3,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS47MR15	4-0	75cm	MR15	1,5cm	24	AMARELA	UROLOGIA
CS47MR20	4-0	75cm	MR20	2,0cm	24	AMARELA	GASTROINTESTINAL
CS57MR15	5-0	75cm	MR15	1,5cm	24	AMARELA	UROLOGIA

SEDA ODONTO

TRANÇADA PRETA




TIPO DE AGULHA

▼ TRIANGULAR CORTANTE



CURVATURA DA AGULHA

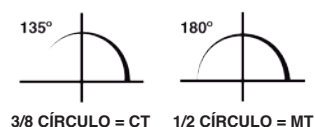

Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
SO34CT17	3-0	45cm	CT17	1,7cm	24	PRETA	ODONTOLOGIA
SO34MT17	3-0	45cm	MT17	1,7cm	24	PRETA	ODONTOLOGIA
SP34MT20	3-0	45cm	MT20	2,0cm	24	PRETA	ODONTOLOGIA
SO44CT17	4-0	45cm	CT17	1,7cm	24	PRETA	ODONTOLOGIA
SO44MT17	4-0	45cm	MT17	1,7cm	24	PRETA	ODONTOLOGIA

SEDA GASTRO

TRANÇADA PRETA




TIPO DE AGULHA

● **CILÍNDRICA**



CURVATURA DA AGULHA




Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
SG07CR30	0	75cm	CR30	3,0cm	24	PRETA	GASTROINTESTINAL
SG27CR30	2-0	75cm	CR30	3,0cm	24	PRETA	GASTROINTESTINAL
SG37CR30	3-0	75cm	CR30	3,0cm	24	PRETA	GASTROINTESTINAL

POLIPROPILENO

MONOFILAMENTO AZUL




TIPO DE AGULHA

- **CILÍNDRICA**



CURVATURA DA AGULHA

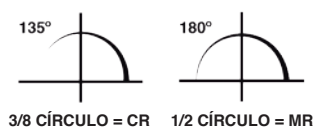

3/8 CÍRCULO = CR 1/2 CÍRCULO = MR

Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
PP07MR25	0	75cm	MR25	2,5cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL
PP07MR35	0	75cm	MR35	3,5cm	24	AZUL	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
PP07MR40	0	75cm	MR40	4,0cm	24	AZUL	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
PP27CR30	2-0	75cm	CR30	3,0cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL
PP27MR25	2-0	75cm	MR25	2,5cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL
PP27MR35	2-0	75cm	MR35	3,5cm	24	AZUL	GAST./ FECH. GER./ GINEC- OBST.
PP37CR30	3-0	75cm	CR30	3,0cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL
PP37MR25	3-0	75cm	MR25	2,5cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL
PP47MR25	4-0	75cm	MR25	2,5cm	24	AZUL	GASTROINTESTINAL

ALGODÃO

TORCIDO PRETO




TIPO DE AGULHA

- CILÍNDRICA



CURVATURA DA AGULHA



Descrições do Produto

CÓDIGO	DIÂM. FIO	COMP. FIO	CÓD. AG.	TAM. AG.	ENV. CX.	COR	INDICAÇÃO
AP040000	0	15 x 45cm	-	-	24	PRETA	-
AP240000	2-0	15 x 45cm	-	-	24	PRETA	-
AP340000	3-0	15 x 45cm	-	-	24	PRETA	-
AP440000	4-0	15 x 45cm	-	-	24	PRETA	-
AP27CR30	2-0	75cm	CR30	3,0cm	24	PRETA	GASTROINTESTINAL
AP37CR30	3-0	75cm	CR30	3,0cm	24	PRETA	GASTROINTESTINAL



Para assegurar a excelência em cada interação com nossos produtos e serviços, seguimos três princípios fundamentais:

- **Inovação Contínua:** Buscamos constantemente maneiras de melhorar e inovar em nossos processos, produtos e serviços, mantendo-nos à frente das demandas do mercado e proporcionando soluções cada vez mais eficazes e eficientes para nossos clientes.
- **Matéria-Prima de Excelência:** Avaliamos rigorosamente a qualidade de cada matéria-prima antes de processá-la, garantindo consistência em cada peça.
- **Entrega Rápida:** Priorizamos a agilidade na entrega para atender às necessidades de nossos parceiros e clientes em qualquer localidade, assegurando eficiência e pontualidade.

Estamos comprometidos em colocar a satisfação do cliente em primeiro lugar, desde a seleção cuidadosa das matérias-primas até a entrega rápida e um suporte pós-venda eficaz.

Downloads e instruções de uso pelo QR Code



Documentos disponíveis
no download.

ALVARÁ SANITÁRIO

CBPF

**CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE BOMBEIROS**

**CERTIFICADO DE
REGULARIDADE TÉCNICA**

REGISTRO DE PRODUTOS

AFE DE FUNCIONAMENTO - ANVISA





(62) 3282 1620


(62) 3956 9900



technofio@technofio.com.br

sac@technofio.com.br

technofio.com.br



TECHNOFIO

SUTURE COMPANY

FICHA TÉCNICA



- **Produto:** Espéculo vaginal descartável não estéril grande
- **Código:** 50001
- **Marca:** CRALPLAST
- **Cadastro Anvisa:** Produto com registro na ANVISA

Características Técnicas:

O espéculo vaginal descartável não estéril é um instrumento médico-hospitalar projetado para a retração das paredes vaginais, possibilitando a visualização e acesso ao colo uterino para exames ginecológicos, procedimentos cirúrgicos e coleta de amostras.

Composição:

Poliestireno (PS)

Polietileno (PEAD – parafuso)

Precauções e Cuidados: Verificar a integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar caso a embalagem esteja violada. Respeitar o prazo de validade do produto.

Armazenamento e Transporte: Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local limpo, seco e protegido da luz solar direta.

Instruções de Uso:

- Inserir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.
- Ajustar a abertura do espéculo através do parafuso, de acordo com a necessidade do procedimento.
- Realizar o procedimento ginecológico ou coleta de amostra.
- Retirar o espéculo da vagina após o procedimento, desajustando o parafuso.

PRODUTO DE USO ÚNICO

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

Produtos

descarbox

Inteligência em descartáveis!



Fabricado no **Brasil**

Instagram icon | **descarbox** | Facebook icon | **Descarbox**
Globe icon | **www.descarbox.com.br**



Coletores Descarbox **PREMIUM**

2950



90
Litros



20
Litros



13
Litros



7
Litros



3
Litros



1,5
Litros



Coletores Descarbox **ECOLOGIC**



90
Litros



20
Litros



13
Litros



7
Litros



3
Litros



1,5
Litros



Coletores Descarbox **QUIMIOTERÁPICO | Premium**



20
Litros



13
Litros



7
Litros



3
Litros



Coletores Descarbox **QUÍMICO | Eco**



90
Litros



20
Litros



13
Litros



7
Litros




3
Litros

Lençol Descarbox **PREMIUM ECOLOGIC NATURAL**



- Tamanhos:
50cm x 50mt
70cm x 50mt

Suportes para **COLETORES**

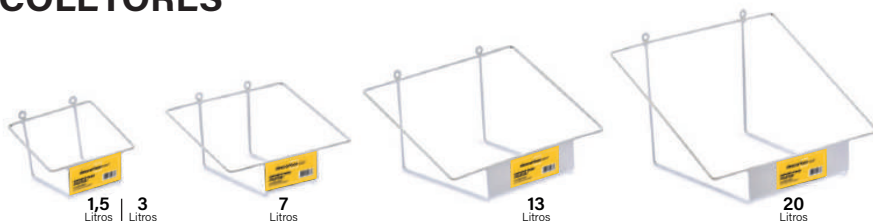

Suporte para **COLETORES**




Suportes para **LENÇOL**



- Tamanhos:
50cm
70cm

Sacos de ÓBITO

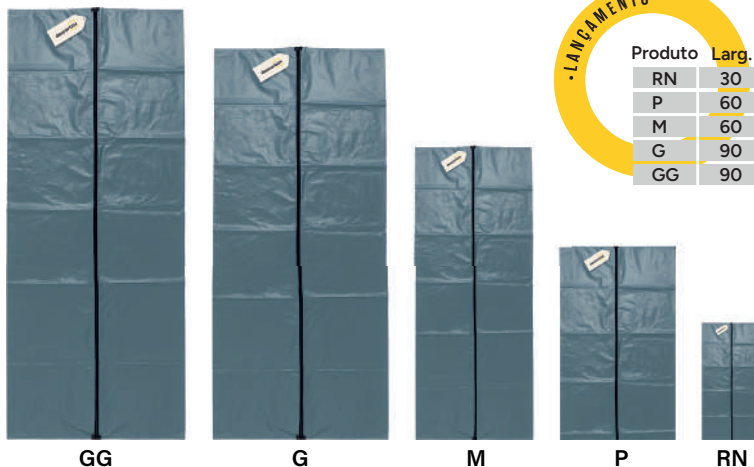

Produto	Larg.	Comp.
RN	30	60
P	60	100
M	60	150
G	90	200
GG	90	220

Sacos de lixo INFECTANTE



Sacos para HAMPER



descarbox

Rod. PR. 317, N° 8.407 - Pq. Industrial
Maringá - PR - CEP 87.065-005

A Descarbox é uma indústria de materiais hospitalares tendo início em suas atividades em 2013, produzindo inicialmente apenas coletores de material perfurocortante, hoje conta com um mix de produtos que engloba diversos itens produzidos em papel (celulose) e polímeros (plásticos). Atendemos todo o território nacional, tendo em carteira centenas de distribuidores e revendedores do ramo, ajudando as necessidades de sua empresa com praticidade e qualidade.

SONDA NASOGÁSTRICA

Notificação do Produto / Registro Anvisa:

80495519043

Modelos

Curta/Longa/Levine

Indicação de uso

É usada para introduzir alimentos, nutrientes, medicamentos, outro material no estômago, drenar o conteúdo gástrico ou descomprimir o estômago. Utilizada para alimentação de curto prazo. São conectadas a um equipo de nutrição, o qual é conectado ao frasco de alimentação ou as sondas podem ser conectadas a uma seringa.

Especificação técnica

Sonda de paredes finas e maleáveis;

- Modelo Curta/Longa:

Contém 2 orifícios laterais alternados com ponta fechada;

Com ponta fechada e arredondada, acabamento atraumático;

Conector luer universal com tampa em PVC;

Conector com cores diferentes para facilitar a identificação dos calibres;

Conector assegura a compatibilidade com equipos de nutrição e seringas;

Comprimento:

Curta 40cm

Longa 120cm

- Modelo Levine:

Contém 4 orifícios laterais alternados com ponta fechada;

Com ponta fechada e arredondada, acabamento atraumático;

Conector luer universal com tampa em PVC;

Conector com cores diferentes para facilitar a identificação dos calibres;

Conector assegura a compatibilidade com equipos de nutrição e seringas;

Comprimento: 125cm

Composição para ambos os modelos:

Sonda – PVC cristal transparente

Conector: PVC

Livre de látex

Estéril – óxido de etileno

Atóxico, apirogênico

Validade 5 anos após a data de esterilização

Descartável e de uso único

Modelos:

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 4FR; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: vermelho claro;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 6FR; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: verde claro;

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **8FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: azul;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **10FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: preto;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **12FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: branco;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **14FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: verde;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **16FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: laranja;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **18FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: vermelho;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **20FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: amarelo;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **22FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: roxo;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA **24FR**; Comprimento (incluindo o conector): 40cm; com dois orifícios laterais; Cor: azul escuro;
-
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **4FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: vermelho claro;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **6FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: verde claro;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **8FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: azul;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **10FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: preto;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **12FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: branco;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **14FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: verde;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **16FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: laranja;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **18FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: vermelho;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **20FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: amarelo;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **22FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: roxo;
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA **24FR**; Comprimento (incluindo o conector): 120cm; com dois orifícios laterais; Cor: azul escuro;
-
- MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **4FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: vermelho claro;

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **6FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: verde claro;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **12FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: branco;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **14FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: verde;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **18FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: vermelho;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **20FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com dois orifícios laterais; Cor: amarelo;

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE **22FR**; Comprimento (incluindo o conector): 125cm; com quatro orifícios laterais; Cor: roxo;

Apresentação

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA (40cm):

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária:

4FR – 8FR: caixas de papelão contendo 900 unidades de Sonda Nasogástrica Curta (18 pacotes com 50 unidades cada);

10FR e 12FR: caixas de papelão contendo 800 unidades de Sonda Nasogástrica Curta (16 pacotes com 50 unidades cada);

14FR: caixas de papelão contendo 700 unidades de Sonda Nasogástrica Curta (14 pacotes com 50 unidades cada);

16FR e 18FR: caixas de papelão contendo 600 unidades de Sonda Nasogástrica Curta (12 pacotes com 50 unidades cada);

20FR e 24FR: caixas de papelão contendo 500 unidades de Sonda Nasogástrica Curta (10 pacotes com 50 unidades cada);

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA (120cm):

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária:

4FR – 10FR: caixas de papelão contendo 500 unidades de Sonda Nasogástrica Longa (25 pacotes com 20 unidades cada);

12FR e 14FR: caixas de papelão contendo 400 unidades de Sonda Nasogástrica Longa (20 pacotes com 20 unidades cada);

16FR e 18FR: caixas de papelão contendo 300 unidades de Sonda Nasogástrica Longa (15 pacotes com 20 unidades cada);

20FR - 24FR: caixas de papelão contendo 200 unidades de Sonda Nasogástrica Longa (10 pacotes com 20 unidades cada);

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE (125cm):

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária:

4FR e 6FR: caixas de papelão contendo 500 unidades (25 pacotes com 20 unidades cada);

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

12FR e 14FR: caixas de papelão contendo 400 unidades (20 pacotes com 20 unidades cada);
 18FR: caixas de papelão contendo 300 unidades (15 pacotes com 20 unidades cada);
 20FR e 22FR: caixas de papelão contendo 200 unidades (10 pacotes com 20 unidades cada);

Orientações de Uso

1. Antes de usar, verifique o produto quanto a danos e contaminação;
2. Verifique se a especificação do produto se está consistente com a especificação esperada;
3. Retire o produto da embalagem através de técnicas assépticas;
4. Proceder com a medição da sonda conforme protocolo institucional;
5. Introduzir suavemente a sonda pela narina do paciente com as técnicas anestésicas conforme protocolo;
6. Flexionar o pescoço aproximando o queixo ao tórax, pedindo ao paciente para realizar movimentos de deglutição;
7. Introduzir a sonda seguindo a marcação indicada;
8. Realizar testes de verificação conforme protocolos da instituição;
9. Conecte o conector com o dispositivo adequado;
10. Ajuste o dispositivo de forma adequada;
11. Após a utilização realizar o descarte em local adequado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“SÃO DE USO ÚNICO! NÃO DEVEM SER REUTILIZADOS!” “PROIBIDO REPROCESSAR” “ESTÉRIL”
 “LÁTEX FREE”

Recomendamos o manuseio apenas por profissionais habilitados;

Usar o produto somente durante prazo de validade.

Não utilizar se o produto ou a embalagem apresentarem danos;

Em caso de evento adverso, informar o fabricante.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura deve ser 10°C a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA

EAN13		EAN14	
7898652373992	4FR	17898652373999	CX C/ 900 4FR
7898652374012	6FR	17898652374019	CX C/ 900 6FR
7898652374029	8FR	17898652374026	CX C/ 900 8FR

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
 ☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
 ☎ (47) 3432-8741

7898652374548	10FR	17898652374545	CX C/ 800 10FR
7898652374555	12FR	17898652374552	CX C/ 800 12FR
7898652374562	14FR	17898652374569	CX C/ 700 14FR
7898652374579	16FR	17898652374576	CX C/ 600 16FR
7898652374586	18FR	17898652374583	CX C/ 600 18FR
7898652374593	20FR	17898652374590	CX C/ 500 20FR
7898652374609	22FR	17898652374606	CX C/ 500 22FR
7898652374616	24FR	17898652374613	CX C/ 500 24FR

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA

EAN13		EAN14	
7898652374210	4FR	17898652374217	CX C/ 500 4FR
7898652374227	6FR	17898652374224	CX C/ 500 6FR
7898652374630	8FR	17898652374637	CX C/ 500 8FR
7898652374036	10FR	17898652374033	CX C/ 500 10FR
7898652374043	12FR	17898652374040	CX C/ 400 12FR
7898652374050	14FR	17898652374057	CX C/ 400 14FR
7898652374067	16FR	17898652374064	CX C/ 300 16FR
7898652374074	18FR	17898652374071	CX C/ 300 18FR
7898652374081	20FR	17898652374088	CX C/ 200 20FR
7898652374098	22FR	17898652374095	CX C/ 200 22FR
7898652374623	24FR	17898652374620	CX C/ 200 24FR

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE

EAN13		EAN14	
7898652373848	4FR	17898652373845	CX C/ 500 4FR
7898652373855	6FR	17898652373852	CX C/ 500 6FR
7898652373886	12FR	17898652373883	CX C/ 400 12FR
7898652373893	14FR	17898652373890	CX C/ 400 14FR
7898652373916	18FR	17898652373913	CX C/ 300 18FR
7898652373923	20FR	17898652373920	CX C/ 200 20FR
7898652373930	22FR	17898652373937	CX C/ 200 22FR

Detentor da Notificação:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR Nº 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 03 de 22/05/2026

Imagens meramente ilustrativas:

Sede Administrativa


📍 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR

☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC

☎ (47) 3432-8741

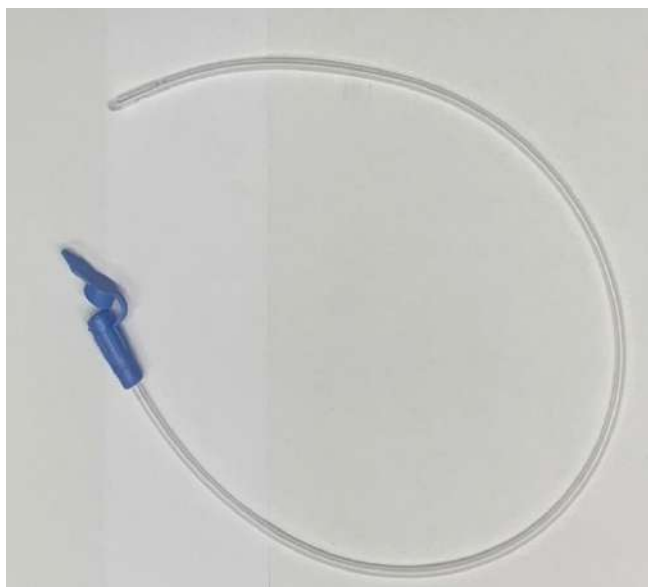MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA CURTA**MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LONGA****Sede Administrativa**

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE



Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741



Instrução de uso

Nome Comercial: Eletrodo para Desfibrilador – marca BluePad

Nome Técnico: CABO/ELETRODO PARA DESFIBRILADOR

Código: 9000039

O Eletrodo para Desfibrilador – marca BluePad é um dispositivo médico desenvolvido, como acessório do desfibrilador, aplicado no tratamento de desfibrilação há muitos anos. O Eletrodo para Desfibrilador faz parte de um sistema de desfibrilação para conduzir os diferentes níveis de energia de desfibrilação como resultado da passagem de corrente pelo miocárdio do paciente para desfibrilação, cardioversão, monitoramento e estimulação. O gel úmido condutor no Eletrodo para Desfibrilador fornece melhor acoplamento e aumenta a eficácia da desfibrilação, ao mesmo tempo em que é armazenado na pele de forma estável. Os Eletrodos para Desfibrilador desconectados podem reduzir ainda mais a impedância e aumentar a eficácia do choque. O dispositivo pode deixar as mãos dos operadores livres durante os procedimentos de desfibrilação, em comparação com o eletrodo de pás tradicional.

O dispositivo deve ser usado em pacientes desde crianças em idade pré-escolar até adultos com peso acima de 25kgs. Auxiliares de manuseio são fornecidos para manipular convenientemente e posicionar com precisão as pás. Isso garante um alto nível de proteção ao paciente e ao operador. O operador, que treinou a operação relativa de desfibrilação ou processamento do conhecimento relativo, deve usar o dispositivo de acordo com as instruções de uso.

O Eletrodo para Desfibrilador são parte de um sistema de desfibrilação para conduzir os diferentes níveis de energia de desfibrilação como resultado da passagem de corrente pelo miocárdio do paciente para desfibrilação, cardioversão, monitoramento e estimulação. O dispositivo conduz a alta potência e curta duração do pulso elétrico através do tórax ou diretamente através do coração, para auxiliar na despolarização de todas as fibras miocárdicas ao mesmo tempo em um curto período, e interromper a via de reentrada para eliminar a excitação ectópica da estufa, de modo que nó sinusal recuperar o controle da frequência cardíaca, para retornar a frequência cardíaca sinoatrial normal.

Os modelos de Eletrodo para Desfibrilador são constituídos por duas pás, um cabo com 2m de comprimento e um plugue.

Fotos do produto

Instrução de uso




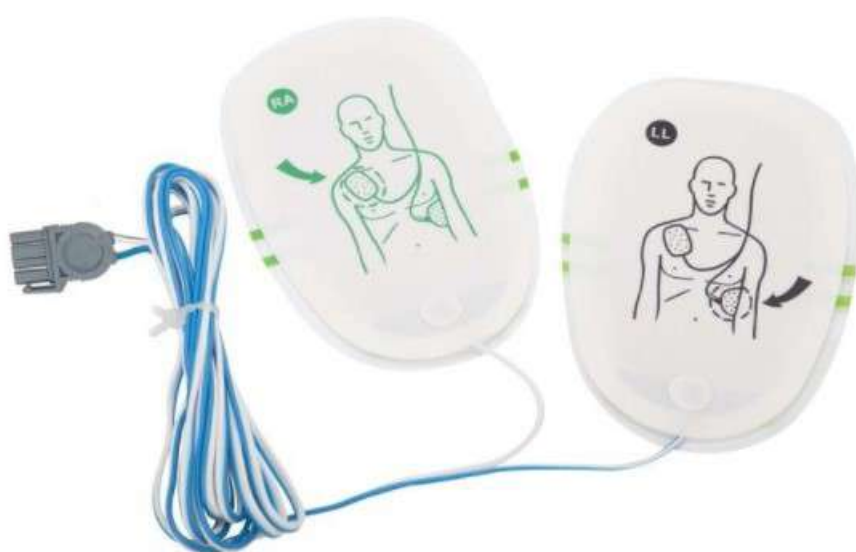


Tabela 1 – Modelos Comerciais

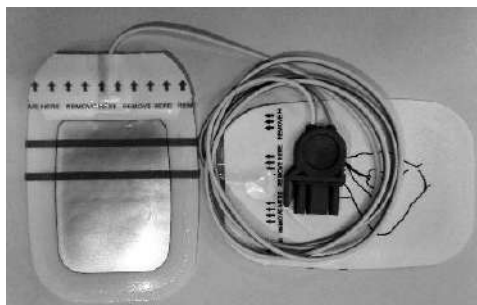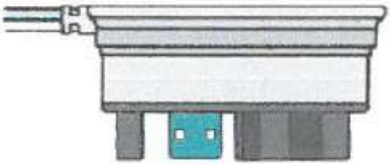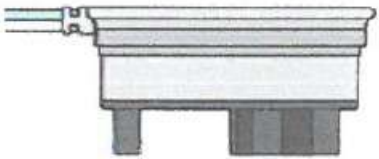

Instrução de uso

***A única diferença entre os modelos comerciais abaixo é o tipo de plugue (conector) do cabo.**

Modelo Comercial	Tipo de conector (plugue)	Modelo do Equipamento compatível
DE-PH		Philips HEARTSTART: FR2, FR2+, FR3, MRx, XL, XL+ HEARTSTREAM FORERUNNER, Heartstart Mrx, Heartstart XL, Heartstart XL+.
DE-MT		Medtronic Physiocontrol, Osatu Bexen, Cardioline, Mindray, Jousing.
DE-NK1		Nihon Kohden, Instramed
DE-ZL1		Zoll Medical Corp
DE-ZL2		Zoll, séries E, M, R, AED Plus, AED Pro.
DE-PH2		Philips
DE-PR1		Primedic Heartsave Y/YA
DE-PR2		



Instrução de uso

DE-NK2		Nihon Kohden
DE-CU1		CU Medical Systems
DE-CU2		CU Medical Systems CMOS Drake
DE-MP		Metrax Primedic
DE-SC1		Schiller
DE-SC2		
DE-ME		Mediana

Dimensões

Componentes	Dimensões (mm)
Pás	Ellipse 155*105(±5)
Cabo	2000±100



Composição

Gel condutor, camada de metal condutiva, papel antiaderente, folha PET, adesivo acrílico.

Diâmetro externo do cabo: $\phi 3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

Papel removível: $\approx 176\text{ cm}^2$ (16 cm x 11 cm)

Dimensão do suporte de espuma: 15cm X 11cm

Área do apoio de espuma $\approx 165\text{ cm}^2$

Área de folha metálica condutora única $\approx 71\text{ cm}^2$

Área condutiva $\approx 86\text{ cm}^2$

Especificações e características técnicas do produto

Área ativa do eletrodo: A área ativa mínima (gel) $\geq 50\text{ cm}^2$ de cada pá para adultos. Está em conformidade com o requisito da EN 60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.7

Adesão de eletrodo: A resistência à remoção das pás adesivas de desfibrilação é forte o suficiente para garantir um grau de contato seguro sob as condições de uso esperadas. As pás passam no teste de tração, tempo de presa, resposta à transpiração, efeito da temperatura sobre essas características de acordo com EN 60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.8 adesão do eletrodo e contato com o paciente.

Impedância de sinal AC pequeno: A impedância de 10 Hz para as pás conectadas gel a gel, em um nível de corrente impressa que não excede 100 microamperes (μA) pico a pico, impedância $\leq 3\text{ K}\Omega$. A impedância $< 5\Omega$ a 30 kHz. Está em conformidade com o requisito da EN60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.1 * Impedância de sinal pequeno AC.

Grande impedância de sinal AC: Conectado um par de eletrodos gel a gel, em série com carga de 50Ω e medido na energia nominal máxima do Desfibrilador, a impedância $\leq 3\Omega$. Está em conformidade com o requisito da EN60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.2 * Impedância de sinal grande CA.

Instabilidade de deslocamento combinada e ruído interno

A voltagem $\leq 100\mu\text{V}$ ponto a ponto na banda de passagem de 0,5 Hz a 40 Hz por um período de 5 min após o período de estabilização com os eletrodos conectados gel a gel. Está em conformidade com o requisito da EN 60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.2 * Impedância de sinal grande CA.

Recuperação de desfibrilação



Instrução de uso

A voltagem $\leq 400\text{mV}$ a 4s e $\leq 300\text{ mV}$ a 60s enquanto as pás se conectavam gel a gel em série com um resistor de 50Ω e submetidas a três choques a 360J ou energia máxima em intervalos de 1min. Está em conformidade com o requisito da norma EN 60601-2-4: 2010, cláusula 201.108.1.4 * Recuperação de desfibrilação.

Tensão DC offset: A tensão de compensação $\leq 100\text{ mV}$ de acordo com o requisito da EN 60601-2-4: 2010 cláusula 201.108.1.6 * Tensão de compensação DC.

Resistência de isolamento: A resistência de isolamento $\leq 500\text{M}\Omega$, que poderia suportar uma tensão de teste DC de 1,5 vezes a maior TENSÃO DE PICO DE TRABALHO U que ocorre entre as partes envolvidas durante a descarga em qualquer modo de operação normal. Está em conformidade com o requisito de EN60601-2-4: 2010 Cláusula 201.8.8.3 Rigidez dielétrica.

Teste derivado de sinal de ECG: Configure o desfibrilador (não objeto desse registro) como um período máximo de 10 s, após os pulsos de desfibrilação, o ECG deve ser visível no monitor e a amplitude pico a pico do sinal exibido não deve se desviar da amplitude original em mais de 50%. Está em conformidade com o requisito de EN60601-2-4: 2010 Cláusula 201.105.3 Rigidez dielétrica.

Resposta biológica: Testado de acordo com EN ISO10993-5 e EN ISO10993-10 e em conformidade com o requisito de EN60601-2-4: 2010, cláusula 201.108.1.5 * Resposta biológica. Os resultados dos testes constam no Anexo “Annex-08-Biocompatibility test report for gel- No. RZ16008010” para detalhes.

Indicações, finalidade ou uso a que se destina o produto médico

O Eletrodo para Desfibrilador são denominados Pás de eletrodos multifuncionais, que são acessórios para dispositivos desfibriladores (não objetos desse registro). É aplicado no tórax do paciente e será usado para administrar choque de desfibrilação cardíaca (desfibrilação e cardioversão), monitoramento e estimulação quando clinicamente indicado. Possui tamanhos para crianças em idade pré-escolar até adultos com peso acima de 25kgs.

Advertências

- Não esmague, dobre ou dobre os eletrodos, nem os armazene sob objetos pesados.
- Mantenha o Eletrodo para Desfibrilador aplicado longe de quaisquer outros eletrodos ou peças de metal em contato com o paciente. Evite a colocação de eletrodos acima de um marca-passo interno.



Instrução de uso

- Não use gel adicional nos eletrodos.
- Não sobreponha os eletrodos de desfibrilação.

ATENÇÃO:

O Eletrodo para Desfibrilador deve ser usado apenas por cirurgiões/profissionais de saúde com conhecimento de técnicas de desfibrilação e segurança.

Avisos

- O não cumprimento dessas instruções ou qualquer outro uso ou aplicação incorreto de qualquer eletrodo pode resultar em queimaduras no paciente ou terapia ineficaz. (Observação: vermelhidão da pele é normal.)
- Use esses eletrodos apenas com dispositivos desfibriladores compatíveis, conforme listado nas instruções de uso (“Tabela de modelos comerciais”). O uso deste produto com qualquer dispositivo não listado pode resultar em conexão potencialmente perigosa.
- Perigo de estrangulamento: direcione os cabos e tubos longe da garganta do paciente.
- A estimulação não invasiva pode causar irritação na pele ou queimaduras. A estimulação extensa pode causar bolhas de ar. Para garantir um contato ideal, alise as bolhas manualmente.
- O dispositivo deve ser mantido bem afastado de outros eletrodos ou partes metálicas em contato com o paciente.
- O operador deve ser avisado que outro dispositivo que não tenha partes aplicadas à prova de desfibrilação deve ser desconectado do paciente durante a desfibrilação.
- As mulheres grávidas ou amamentando devem usar o dispositivo sob orientação do pessoal médico.

Precauções

- Não use se o produto estiver vencido.
- Não esmague, dobre ou dobre os eletrodos, nem os armazene sob objetos pesados.
- Certifique-se de que o tórax do paciente está limpo e seco.
- Não abra a bolsa até que esteja pronto para uso.
- Inspeccione a bolsa, o eletrodo, o cabo, o conector e a limitação de armazenamento ambiental do dispositivo antes do uso. Não use, se comprometido.
- Use os eletrodos dentro de 1 dia após a abertura da bolsa.
- Não use, se o gel estiver seco.



Instrução de uso

- Mantenha o dispositivo aplicado longe de quaisquer outros eletrodos ou peças de metal em contato com o paciente. Evite a colocação de eletrodos acima de um marca-passo interno.
- Não use gel adicional nos eletrodos.
- Não sobreponha os eletrodos de desfibrilação.
- Evite a colocação de eletrodos acima de um marca-passo interno.
- Não reposicione os eletrodos e não toque no paciente durante a desfibrilação.
- Não descarregue as pás manuais através desses eletrodos.
- Não reutilize os eletrodos de desfibrilação. Se reutilizadas, as propriedades elétricas podem ser insuficientes, o que pode causar ferimentos / riscos ao paciente.
- A reutilização resulta em risco de infecção cruzada de um paciente para outro.
- Use com monitor de desfibrilador tipo CF.
- Sempre mantenha uma segunda embalagem de eletrodos de desfibrilação com o desfibrilador.
- Não use eletrodos multifuncionais, bem como eletrodos multifuncionais rádios transparentes para procedimentos de imagem por ressonância magnética (MRI).
- Os operadores devem evitar o contato entre partes do corpo do paciente, como pele exposta da cabeça ou membros, fluidos condutores, como gel, sangue ou solução salina e objetos de metal, como uma estrutura de cama ou uma maca, que podem fornecer caminhos indesejados para a corrente de desfibrilação.
- Para uso apenas crianças em idade pré-escolar até adultos com peso acima de 25kgs.
- O fabricante recomenda o uso único. A reutilização por unidade pode diminuir a função condutiva e aumentar o risco de queimaduras.
- Substitua por outro conjunto de eletrodos após a conexão do mesmo paciente:
 - 50 choques de desfibrilação;
 - a estimulação atinge 8 horas em: duração de pulso de 100mA / 80bpM / 40ms;
 - 24 horas na pele.

Efeitos colaterais

Vermelhidão da pele ou queimação em caso de uso impróprio.


Instruções de Uso

1) Selecione os locais de colocação no corpo do paciente de acordo com as instruções de operação do fabricante do desfibrilador para a colocação do eletrodo anterior-anterior (1a).




Instrução de uso

anterior-anterior

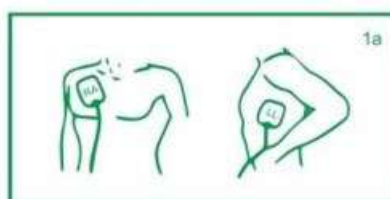


2) Colocação anterior-posterior do eletrodo para crianças em idade pré-escolar, se adequado.

3) Certifique-se de que o local da pele esteja limpo (2b), seco e sem pelos. Remova os pelos, se necessário (2a).

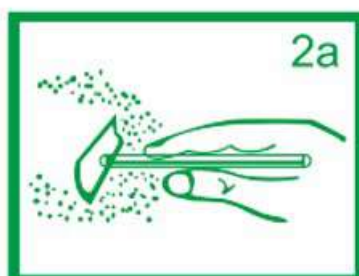

4) Remova os eletrodos da embalagem (3a) e, em seguida, remova a tampa protetora dos eletrodos (3b).

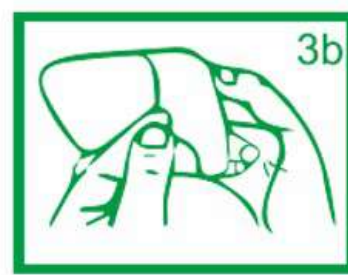


5) Aplicar ao paciente de acordo com o protocolo. Pressione firmemente para garantir um bom contato de toda a superfície adesiva com a pele (4).



6) Conecte os eletrodos ao desfibrilador (5).



Instrução de uso

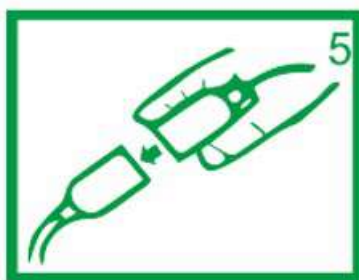

7) Prosiga com a desfibrilação/estimulação de acordo com o manual de operação do fabricante do desfibrilador.

8) Desconecte o conector do eletrodo do desfibrilador.

9) Remova os eletrodos lentamente o eletrodo da pele do paciente. Descarte os eletrodos usados de acordo com as diretrizes federais locais.

Para os pacientes que precisam de procedimento de desfibrilação, adultos ou crianças em idade pré-escolar com peso acima de 25kgs. As mulheres grávidas ou amamentando devem usar o dispositivo sob a orientação do pessoal médico.

O eletrodo de desfibrilação não é estéril e para uso em um único paciente.

Compatibilidade

As marcas de desfibriladores recomendadas, não objetos deste registro, devem ser escolhidos pelo cirurgião, conforme modelos compatíveis especificados na Tabela 1 – Modelos Comerciais.

Prazo de Validade: 3 anos.

Descarte

O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos nacional, estadual ou municipal destinado ao descarte de detritos biologicamente perigosos por clínicas e hospitais.

Armazenamento, conservação e transporte

A faixa de temperatura ambiente de armazenamento/transporte deve ser de 15 °C - 35 °C.

Temperatura de operação de 15 °C ~ 35 °C

Umidade relativa do ambiente $\leq 80\%$

Faixa de pressão atmosférica ambiente de 50Kpa a 106Kpa.

1.4. Formas de apresentação do produto



Instrução de uso

O Eletrodo para Desfibrilador – marca BluePad é embalado individualmente em polietileno. As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de papelão de 80 unidades.

Simbologia



Ler Instruções de uso



Equipamento tipo CF



Aviso de Perigo de choque



Usar até



Precaução



Sem látex




Não reutilize

N Não dobre para usar

Certifique-se de que a embalagem esteja integra antes

de usar



0123 marcação CE



Usar em até 24 h após abrir a embalagem

Manter protegido da luz solar



Manter em local seco



Limites de temperatura



Marca da BAISHENG MEDICAL CO.,LTD

**Frágil****Descrição da eficácia e segurança do produto médico em conformidade com a regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Eficácia e Segurança de Produtos Médicos (RDC nº 56/01)**

Conforme os fatores de risco, referidos no Anexo V do manual do usuário da Resolução RDC nº 185/01, e correspondentes requisitos essenciais de segurança e eficácia, descritos na Resolução RDC nº 56, tem-se que:

Os fatores de risco aplicáveis ao produto que devem ser considerados na sua avaliação de risco são **toxicidade** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 7.1 (a)), **flamabilidade** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 7.1 (a) e 9.3), **contaminantes residuais** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 7.2), **incompatibilidade com outros materiais, substâncias ou gases** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 7.3), **infecção e contaminação microbiana** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 8.1), **incompatibilidade de combinação ou conexão com outros produtos** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 9.1 e 12.7.4), **Propriedades Relativas a Fabricação e ao Meio Ambiente** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 9), **instabilidade e limitações de características físicas e ergonômicas** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 9.2 (a) e 12.7.5), **interferência recíproca com outros produtos** (requisitos essenciais de eficácia e segurança de nº 9.2 (c)), **impossibilidade de calibração e manutenção** (requisitos essenciais de eficácia e segurança de nº 9.2 (d)), **inteligibilidade das informações aos usuários** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 12.9.1), **inadequação de alarmes para alerta** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 12.3), **Proteção contra riscos elétricos** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 12.6.1), **Proteção contra riscos mecânicos e térmicos** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 12.7.1, 12.7.3, 12.7.4 e 12.7.5), **Proteção contra riscos que podem apresentar para o paciente as fontes de energia ou administração de substâncias** (requisito essencial de eficácia e segurança de nº 12.8).

Fabricante: Baisheng Medical Co.,Ltd. - No.11, Fusheng Road, Xinhui District, Jiangmen, Guangdong, China. **Detentor do registro:** DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – CNPJ: 07.295.190/0001-60 - Rua Coronel Lisboa, 412 - Vila Mariana - São Paulo – SP - 04020-040 - Tel.: (11) 3845-0433 - www.dbimedical.com.br. **Responsável Técnico:** Anny Caroline Camargo - CRF/SP: 38146.

Registro ANVISA nº: 80722800022.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DBI - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.295.190/0001-60
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.228-0
Nome do Dispositivo Médico	Eletrodo para Desfibrilador – marca BluePad
Nome Técnico do Dispositivo Médico	CABO/ELETRODO PARA DESFIBRILADOR
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80722800022
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351071925202208
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: BAISHENG MEDICAL CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C008749 - Endereço: N. 11, FUSHENG ROAD, XINHUI DISTRICT, JIANGMEN, GUANGDONG
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11/04/2022
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11/04/2032

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	06. Dossiê Técnico - Capítulo 5 - Instruções de Uso rev. 06.pdf	1530921244 - 06/11/2024 15:51:40

Modelo Produto Médico
DE-MT
DE-NK1
DE-PH
DE-PH2
DE-PR1
DE-PR2
DE-NK2
DE-CU1
DE-CU2
DE-MP
DE-SC1
DE-SC2

DE-ME
DE-ZL1
DE-ZL2

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDIX BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.268.780/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.04.955-1
Nome do Dispositivo Médico	Medix Brasil Sonda Nasogástrica Descartável
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Sondas
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80495519043
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351042874202207
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C002771 - Endereço: UNIT 93, BUILDING 12, NO. 818, QIMING ROAD, YINZHOU, NINGBO, ZHEJIANG 315105, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03/02/2022
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ficha Técnica - Sonda Nasogástrica 80495519043- Rev 3 - Medix Brasil.pdf	0501987266 - 22/05/2026 09:31:21

Modelo Produto Médico
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 4FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 5FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 6FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 8FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 10FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 12FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 14FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 16FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 18FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 20FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 22FR

MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL CURTA 24FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 4FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 5FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 6FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 8FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 10FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 12FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 14FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 16FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 18FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 20FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 22FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LONGA 24 FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 4FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 6FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 8FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 10FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 12FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 14FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 16FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 18FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 20FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 22FR
MEDIX BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL LEVINE 24FR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02.400.787/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.783-3
Nome do Dispositivo Médico	NYLON MONOFILAMENTO PRETO TECHNOFIO SUT – FIO DE SUTURA
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Fio de Sutura
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10378330022
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351489381200871
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C015557 - Endereço: NO. 2 FACTORY BUILDING, NO.106, CHAOYANG WEST ROAD, QINGJIANGPU DISTRICT, 223003, HUAI'AN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/09/2008
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	NYLON MONOFILAMENTO PRETO TECHNOFIO SUT - FIO DE SUTURA.pdf	0339218266 - 08/04/2026 15:30:45

Modelo Produto Médico
NY04CT20
NY04CT30
NY04CT40
NY24CT20
NY24CT25
NY24CT30
NY24CT40
NY24MT20
NY24MT25
NY24MT30

NY34CT20
NY34CT24
NY34CT30
NY34CT40
NY34MT15
NY34MT20
NY34MT25
NY34MT30
NY44CT20
NY44CT24
NY44CT30
NY44MT15
NY44MT20
NY44MT25
NY54CT16
NY54CT20
NY54MT15
NY54MT25
NY64CT16
NY64CT20
NY64MT15

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	59.309.302/0001-99
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.01.606-1
Nome do Dispositivo Médico	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - INJEX
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Equipos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10160610129
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351512361202340
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SHANGHAI HEALTH MEDICAL CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C002563 - Endereço: NO.143 NORTH QINGYANG ROAD, TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/08/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - 10160610129.pdf	1019510242 - 25/07/2024 15:22:00

Modelo Produto Médico
IJ01
IJ02
IJ03
IJ04
IJ05
IJ06
IJ07
IJ08
IJ09
IJ10
IJ11

IJ12
IJ13
IJ14
IJ15
IJ16
IJ17
IJ18
IJ19
IJ20
IJ21
IJ22
IJ23
IJ24
IJ25
IJ26
IJ27
IJ28
IJ29
IJ30
IJ31
IJ32



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.875.336/0001-97
Razão Social: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/06/2026
Receita Municipal	Validade:	06/09/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **49.875.336/0001-97**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:38:56 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mLdJxYrJ3kzhbDeVrK7R

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PATRIQUE SCHREINER**

CPF/CNPJ: **046.182.509-09**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:39:22 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Tr1B3mmIGV69z4EI33wE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EDITAL DE PREGÃO Nº 033/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1237/2026

ANEXO II
PROPOSTA

A empresa L&P LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Rua Manoel Lopes de Oliveira, nº 2759, Sala 01, Bairro Votorões, Município de Cândói, Estado do Paraná, CEP 85140-000, telefone (42) 98871-4616, e-mail leplife01@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 49.875.336/0001-97, neste ato representada por Patrique Schreiner, Sócio Administrador, portador do RG nº 7.222.654-2 e CPF nº 046.182.509-09, residente na Rua Corvo Branco, s/n, Bairro Corvo Branco, Município de Cândói, Estado do Paraná, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2026, conforme abaixo discriminado:

LOTE	DESCRIÇÃO	UNID	QDADE	MARCA	UNIT	TOTAL	ANVISA
13	APARELHO DE BARBEAR Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material lâmina aço dupla, material cabo de plástico emborrachado, anatômico, com fita lubrificante.	Unidade	300	MAXICOR /VITAL	R\$ 1,09	R\$ 327,00	ISENTO
20	BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa para colostomia ileostomia, 1 peça- placa e bolsa acoplada, drenável, 01 clip para cada 10 bolsas, transparente, adesivo microporoso, base de karaya, pré cortada até 65MM.	Unidade	200	KANGLI	R\$ 11,25	R\$ 2.250,00	80691910003
34	COLETOR DE URINA Coletor tipo saco, com barbante, sistema aberto, capacidade: 2 litros. Não estéril. Pacote com 100 unidades.	Pacote	220	LETOMED	R\$ 38,00	R\$ 8.360,00	82241440001
45	DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA SVD TIPO "H" - MODELO SEM GRAMPO (ADESIVO DE ABAS) Dispositivo adesivo para fixação de sonda vesical tipo "H", composto por base de sustentação cutânea e abas de fixação integradas em material flexível (tecido não tecido ou laminado plástico). Fixação por Contato: A fixação da sonda é feita através do envolvimento das abas adesivas em torno do cateter, proporcionando estabilidade sem a necessidade de travas rígidas. Adesivo de Grau Médico: Hipoalergênico, de longa permanência (mínimo de 7 dias), permitindo a transpiração da pele para evitar maceração. Perfil Baixo: Design plano que evita pontos de pressão excessiva sobre a coxa do paciente. Remoção: Deve permitir a retirada sem deixar resíduos de cola na	Unidade	500	HELP/MED	R\$ 6,88	R\$ 3.440,00	10158910008

	sonda ou na pele. Apresentação: Embalado individualmente. Certificação: Registro na ANVISA.						
68	FIXADOR DE Sonda NASOENTERAL Dispositivo adesivo para fixação de sondas nasoenterais e nasogástricas, composto por dorso de tecido não tecido (rayon e poliéster), macio, flexível e conformável aos contornos do nariz. Composição do Adesivo: Adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível à pressão, que garante fixação segura sem causar danos ou irritações à pele, mesmo em uso prolongado. Formato Anatômico: Design em formato de "calça" ou tiras pré-cortadas que permitem a aplicação rápida e padronizada. Barreira AntiUmidade: Material respirável que permite a transpiração da pele, reduzindo o risco de maceração e proliferação bacteriana sob o adesivo. Fita de Sinalização/Monitoramento: Deve possuir uma aba ou área específica que permita a escrita (data e nome do profissional) para controle da troca do curativo. Livre de Látex: Produto Latex-free para segurança total do paciente e profissionais. Remoção Limpa: Não deve deixar resíduos adesivos na pele ou no corpo da sonda após a retirada. Apresentação: Embalagem individual, garantindo a proteção e integridade de cada unidade. Certificações: Registro obrigatório na ANVISA, indicação de lote e validade na embalagem.	Unidade	400	SKINU	R\$ 3,99	R\$ 1.596,00	82307460018

85	LUVA NITRÍLICA M Luva produzida em nitrilo, livre de látex, ambidestra, e sem pó bioabsorvível, recomendada para profissionais com alergia ao látex. Caixa com 100 unidades, não estéril e de uso único.	Caixa	80	MEDIX/GL OMED	R\$ 20,09	R\$ 1.607,20	80495510020
133	SONDA NASOENTERAL Nº 12 Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o ph do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação.	Unidade	200	SOLUMED	R\$ 8,85	R\$ 1.770,00	80019160013
134	SONDA NASOENTERAL Nº 8 Estéril, confeccionada em poliuretano e silicone; Flexível, maleável e durável; Não sofre alteração em contato com o ph do estômago; ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação.	Unidade	5	SOLUMED	R\$ 8,85	R\$ 44,25	80019160013
169	TALA DE IMOBILIZAÇÃO – G Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 70cm. Pacote com 10 unidades	Pacote	20	RESGATE	R\$ 22,80	R\$ 456,00	ISENTO
170	TALA DE IMOBILIZAÇÃO – M Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura Dimensões: largura 20cm, comprimento 50cm. Pacote com 10 unidades	Pacote	20	RESGATE	R\$ 17,63	R\$ 352,60	ISENTO
171	TALA DE IMOBILIZAÇÃO – P Composta de papelão; Utilizada para imobilização de membros, possui marcação para dobras e furos passantes para atadura. Dimensões: largura 20cm, comprimento 30cm. Pacote com 10 unidades	Pacote	20	RESGATE	R\$ 14,35	R\$ 287,00	ISENTO
174	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente	Unidade	5	TERA/ME DIX	R\$ 3,26	R\$ 16,30	80495510045

	preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).						
175	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).	Unidade	5	TERA/ME DIX	R\$ 3,29	R\$ 16,45	80495510045
176	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM C/BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).	Unidade	5	TERA/ME DIX	R\$ 3,28	R\$ 16,40	80495510045
177	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).	Unidade	5	TERA/ME DIX	R\$ 3,28	R\$ 16,40	80495510045
						R\$ 20.555,60	

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Patrique Schreiner
- CPF: 046.182.509-09
- Endereço: Rua Corvo Branco, s/n, Bairro Corvo Branco, Candói/PR
- Telefone: (42) 98871-4616
- E-mail: leplife01@gmail.com

Agência e Conta para pagamento:

Banco do Brasil
Agência: 4095-9
Conta Corrente: 27257-4

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeleiro -PR, 12 de junho de 2026



L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 49.875.336/0001-97
PATRIQUE SCHEINER
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF 046.182.509-09

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	40.678.514/0001-15
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.23.074-6
Nome do Dispositivo Médico	FIXADOR PARA CANULA - SKINUPPER
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Fixador Para Canula
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82307460018
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351652039202271
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: PHARMAPLAST S.A.E - EGITO - CNPJ / Código Único: C005616 - Endereço: AMRIA FREE ZONE, 23512, ALEXANDRIA, 31611 – EGITO
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/01/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	manual de uso fixador canula.pdf	0012881236 - 05/01/2023 14:00:33

Modelo Produto Médico
Fixador orotraqueal, Fixador para cateter e cateter e sonda vesical, Fixador para dreno de tórax, Fixador para sonda nasal.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	AMP PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	55.864.086/0001-92
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.01.589-1
Nome do Dispositivo Médico	HELPMFIX
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Fixador Para Canula
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10158910008
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351048050201127
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: AMP PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 55864086000192 - Endereço: RUA CESÁRIO RAMALHO 615 CAMBUCI 01521000
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/10/2011
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Família Helpfix.pdf	0205440231 - 01/03/2023 15:51:03

Modelo Produto Médico
Fixador orotraqueal
Fixador para cateter e cateter e sonda vesical
Fixador para dreno de tórax
Fixador para sonda nasal

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10.545.970/0001-26
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.06.919-1
Nome do Dispositivo Médico	Bolsa para Colostomia Kangli Care
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Bolsa para Colostomia
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80691910003
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351329893201414
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: Zhejiang Kanglidi Medical Articles Co., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/08/2014
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ficha Técnica KANGLI CARE Bolsa Intestinal 2 peças.pdf	4283092215 - 29/10/2021 10:33:09

Modelo Produto Médico
MODELOS: Códigos para o sistema de fechamento Twist (Bolsa Colostomica): 4020-A 4021-A 4022-A 4016-A 4017-A Códigos para o sistema de fechamento Velcro (Bolsa Colostomica): 4020-B 4021-B 4022-B 4016-B 4017-B Códigos para o sistema de fechamento Clamp (Bolsa Colostomica): 4020-C

4021-C
4022-C
4016-C
4017-C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Impresso em: 14/11/2025 às 17:04:10

A anotação de Responsabilidade Técnica foi registrada pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ com a Resolução Cofen 782/2025, de acordo com os dados abaixo:

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nr. do Registro: 2025007997

Data do Registro: 14/11/2025 17:01

Data do Vencimento: 14/11/2026

Classificação da Área de Gestão: GESTÃO TÉCNICA

Nomenclatura da ART: Única

DADOS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE

Razão Social: L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO

CNPJ: 49.875.336/0001-97

Natureza Jurídica:

Endereço: R RUA MANOEL LOPES DE OLIVEIRA, 2759. sala 01 A SALA 01 - Candió - PR

Horário de Funcionamento: até

DADOS DO(A) ENFERMEIRO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)

Nome Completo: LAURINDO GASPAR STEFANES

Inscrição Coren: 327188

Se Setorizada especificar o setor: GESTÃO ÁREA TÉCNICA

Se Territorializada especificar a área de abrangência:

Jornada de Trabalho: 17:30 às 21:30

Carga Horária Total Semanal (horas): 20,00

Certidão N°: 14112.02505.04102.17155.81

Confirme a autenticidade através do QRCode ou link abaixo.



<https://sig1.corenpr.gov.br/pgsprocesso/ExibirCertidao.aspx?pNumeroCertidao=14112.02505.04102.17155.81>

Esta **certidão de responsabilidade técnica** é expedida gratuitamente.

MUNICIPIO DE CANDOI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



LICENÇA SANITÁRIA Nº 20260010000017

VENCIMENTO: 17 / 04 / 2027

Razão Social: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
CNPJ: 49.875.336/0001-97
Endereço: Manoel Lopes De Oliveira, 2759 - Sala 01 - Votoroes - Candi/PR - 85140-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8650-0/01 - Atividades de enfermagem
8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Av.Santa Clara ,s/n , Bairro: Santa Clara .
(42)3638-8057 /3638-8056
Email:vsanitaria@candoi.pr.gov.br

MUNICIPIO DE CANDOI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



OBSERVAÇÃO: Esta licença é válida enquanto satisfizer as exigências sanitárias do local.

LOCAL E DATA: Candi, 17 de Abril de 2026

SOLANGE DE FATIMA SIRIGALLI
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 91B84CA04356881D042D5C0DF6BE89EA

Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

Av.Santa Clara ,s/n , Bairro: Santa Clara .
(42)3638-8057 /3638-8056
Email:vsanitaria@candi.pr.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/03/2024 | Edição: 55 | Seção: 1 | Página: 120

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.075, DE 19 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0484-00

25351.095933/2024-01 / 5081501

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0301789240

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0515-41

25351.095228/2024-04 / 5081406

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0301058245

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0459-08

25351.095972/2024-09 / 5081514

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL



DROGARIA SAO BENTO RIO PRETO LTDA / 45.791.363/0001-20

25351.095451/2024-43 / 5081441

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE /
PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0301288241

Alpha Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda / 49.947.881/0001-41

25351.103024/2024-46 / 4067243

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EMBALAR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

FABRICAR: COSMÉTICOS

FRACIONAR: COSMÉTICOS

REEMBALAR: COSMÉTICOS

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - FABRICAR
(SOMENTE MATRIZ) / 0316128244

BIO ESSENCIALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 00.524.133/0004-00

25351.096118/2024-51 / 5081545



COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE /
PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0301987246

L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA / 49.875.336/0001-97

25351.106792/2024-51 / 8289062

ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0323135242

GNR BRASIL LTDA / 29.268.037/0001-87

25351.102597/2024-52 / 8289136

ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)



RESOLUÇÃO COFEN Nº 727 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023

Institui os procedimentos necessários para concessão, renovação e cancelamento do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Serviço de Enfermagem, e define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico (ERT).

O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, e:

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Cofen vigente que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem a baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO o art. 11, I, alíneas “a”, “b”, “c” e “h”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que definem atividades privativas do enfermeiro;

CONSIDERANDO a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Em seu artigo 107, determina que as cooperativas, para seu funcionamento, devem se registrar na Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB);

CONSIDERANDO a Lei nº 6.839/1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.782/1990, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.853/2019, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 0564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ou outra que lhe sobrevir;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 0617/2019, que aprova o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, ou outra que lhe sobrevir;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 658/2021, que estabelece normas e padrões para fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, ou outra que lhe sobrevir;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 0685/2022, que institui a concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica nos Serviços de Enfermagem prestados de forma autônoma e/ou liberal, ou

outra que lhe sobrevir;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 0546/2019, sob a ementa: “Interessado: Coren-PI. Assunto OE 16. Parecer Técnico Anotação de Responsabilidade Técnica”;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 556ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2023 e tudo o mais que consta no PAD SEI COFEN Nº 00196.000769/2022-00,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir os procedimentos necessários a concessão, renovação e cancelamento do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Serviço de Enfermagem, e definir as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico (ERT).

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, considera-se:

I - Serviço de Enfermagem: parte integrante da arquitetura organizacional e formal da instituição, dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos e indiretos de enfermagem ao indivíduo, família ou coletividade, em todos os pontos de atenção à saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e Ensino/Formação ou outra área que sobrevir de atos regulatórios do Cofen;

II - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): ato administrativo concedido pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren), a partir do preenchimento de requisitos previstos nesta norma, que licencia o ERT para atuar na referência e relação entre o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição/organização e o Coren;

III - Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Coren, pelo qual se materializa o ato administrativo de ART pelo Serviço de Enfermagem;

IV - Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional Enfermeiro, que exerce as atividades de enfermagem dispostas nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, bem como as atribuições previstas nos atos regulatórios do exercício da profissão de enfermagem e nesta resolução, a quem é concedida, pelo Coren, a ART;

V - Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal: profissional Enfermeiro que realiza ações técnicas e de enfermagem dispostas nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, bem como as atribuições previstas nos atos regulatórios do exercício da profissão de enfermagem e das ações tipificadas na gestão de área técnica previstas na Resolução Cofen Nº 685/2022, ou outra que lhe sobrevir, a quem é concedida, pelo Coren, a ART;

VI – Enfermeiro Responsável Técnico Interino: profissional Enfermeiro, que exerce as atividades de enfermagem dispostas nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, bem como as atribuições previstas nos atos regulatórios do exercício da profissão de enfermagem e nesta resolução, o qual exercerá a função de RT no período de 31 a 120 dias de afastamento temporário do ERT, ou excepcionalmente durante o afastamento temporário da ERT por licença maternidade.

Art. 3º É obrigatório que toda empresa/instituição/organização pública, privada, beneficente ou filantrópica onde houver serviços e/ou ensino de Enfermagem, tenha pelo menos um ERT e apresente a respectiva CRT, devendo ser afixada em suas dependências, em local visível e de acesso público.

§ 1º A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovada após este período para o respectivo ERT, mantendo a motivação anterior da ART, ou concedida nova ART e CRT.

§ 2º Havendo apresentação de comprovação de vínculo empregatício inferior a 12 (doze) meses, a CRT somente deverá ser emitida com validade compatível ao tempo de contratação, podendo ser renovada após este período para o respectivo ERT ou concedida nova ART e CRT.

Art. 4º A ART do Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Coren pelo Enfermeiro designado para a função de Enfermeiro Responsável Técnico (ERT).

§ 1º Fica estabelecido no máximo 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja coincidência de horário de suas atividades como ERT e outras atribuições, mediante apresentação de Declaração de Não Coincidência de Horário.

§ 2º O número de concessões de ART nos serviços de Enfermagem prestados de forma autônoma e/ou liberal, seguirá as determinações da Resolução Cofen Nº 685/2022, ou outra que lhe sobrevir.

I - As atividades desenvolvidas pelo Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal estarão vinculadas ao contrato de prestação de serviço com a empresa/instituição/organização.

II - A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovada após este período para o respectivo Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal.

III - Havendo apresentação de contrato de prestação de serviço inferior a 12 (doze) meses, a CRT somente deverá ser emitida com validade compatível ao tempo de contratação, podendo ser renovada após este período para o respectivo Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal.

§ 3º O ERT deverá exercer as atividades da ART de forma exclusiva conforme carga horária da CRT, observado o disposto no caput deste artigo.

I - A jornada de trabalho para ART não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais na empresa/instituição/organização como ERT, salvo quando horário de funcionamento do serviço de Enfermagem for inferior a 20 (vinte) horas semanais, neste caso a CRT será emitida de acordo com o total de horas apresentado.

II - O ERT poderá exercer outras atividades na empresa/instituição/organização, desde que seja em carga horária distinta da CRT, ou seja, não podendo exercer as duas atividades concomitantemente.

Art. 5º O requerimento de ART ao Coren deverá conter os seguintes dados:

§ 1º Da Empresa/Instituição/Organização: razão social, nome fantasia, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), se houver, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), natureza jurídica, horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico.

§ 2º Do ERT: nome completo, número de inscrição no Coren, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico, denominação do local/setor/unidade onde exerce a função de ERT, horário de trabalho para ERT e carga horária semanal para ERT. Outros vínculos profissionais com razão social, nome fantasia, horário de trabalho e carga horária semanal, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo ou assinatura eletrônica.

§ 3º Do Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal pessoa física: nome completo, número de inscrição no Coren, cadastro de pessoa física (CPF), endereço completo, contatos telefônicos, endereço eletrônico e denominação da área técnica. Devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo ou assinatura eletrônica.

§ 4º Do Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal pessoa jurídica: razão social, nome fantasia, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço completo, contatos telefônicos, endereço eletrônico e denominação da área técnica. Devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo ou assinatura eletrônica.

§ 5º Do Representante Legal da Empresa/Instituição/Organização: nome completo e cargo, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo ou assinatura eletrônica.

§ 6º Da Motivação da ART: gestão assistencial, gestão de área técnica e gestão de ensino/formação.

Art. 6º O formulário de requerimento para concessão da ART, deverá vir acompanhando dos documentos conforme manual anexo desta resolução.

Art. 7º Considera-se para renovação da ART, mediante solicitação do ERT:

§ 1º O prazo de 30 dias antecedentes até, impreterivelmente, 30 (trinta) dias posteriores a vigência da CRT;

§ 2º O formulário de requerimento para renovação da ART deverá vir acompanhado dos documentos conforme manual anexo desta resolução.

Art. 8º O formulário de requerimento de ART para o Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal deverá vir acompanhando dos documentos citados na Resolução Cofen Nº 685/2022, no artigo 4º, ou outra que lhe sobrevir.

Art. 9º Para concessão ou renovação de ART e emissão da CRT, o Coren deverá analisar o preenchimento dos seguintes requisitos:

§ 1º O formulário de requerimento de ART devidamente preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação;

§ 2º A quitação da obrigação eleitoral do Enfermeiro requerente junto ao Coren, bem como das suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito, e ter antecedentes éticos que permitam o exercício profissional;

§ 3º Vigência da Carteira de Identidade Profissional (CIP) do Enfermeiro requerente;

§ 4º Comprovação da isenção da taxa de ART para as empresas/instituições/organizações públicas, beneficentes e filantrópicas;

§ 5º Comprovação do recolhimento da taxa de ART para empresas/instituições privadas, cujo valor deverá ser fixado pelo Coren, observando o disposto em ato normativo do Cofen, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem os valores das anuidades, taxas e serviços para o exercício da Enfermagem;

§ 6º A não coincidência de horário de trabalho do ERT nas empresas/instituições/organizações, as quais estejam vinculados;

§ 7º Comprovação da existência e vigência do contrato de prestação de serviço entre a empresa/instituição/organização e o Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal;

§ 8º Relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem da empresa/instituição/organização e que estão sob a supervisão do Enfermeiro requerente;

I - O Coren deverá verificar a vigência da CIP dos profissionais de enfermagem atuantes na instituição e o exercício ilegal da profissão, o que não impedirá a concessão de ART e emissão da CRT para o Enfermeiro requerente;

§ 9º Caso seja identificada qualquer não conformidade durante a análise dos documentos pelo Coren, o enfermeiro requerente deverá ser comunicado formalmente pelo regional para regularização, ficando suspensa a concessão de ART e emissão da CRT até a apresentação das novas evidências;

§ 10 Para renovação de ART, deverá ser entregue o Planejamento e a Programação de Enfermagem com o quantitativo necessário de pessoal de Enfermagem para prestar uma assistência segura e de qualidade.

Art. 10 Quanto à motivação, a ART é classificada em:

§ 1º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao indivíduo, família e/ou coletividade em todos os pontos de atenção à saúde, devendo ser especificada na CRT;

§ 2º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos médico-hospitalares, Consultoria;

§ 3º A gestão de ensino/formação refere-se ao ato educativo supervisionado de Enfermagem, desenvolvido em cenários de prática de trabalho que visa a preparação do futuro profissional que esteja frequentando o ensino regular em todos os níveis de formação.

Art. 11 A ART poderá ser organizada nos Serviços de Enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde, de acordo com a quantidade de ERT:

I - ART única - exercida por um ERT;

II - ART setorizada, regionalizada ou territorializada - exercida por mais de um ERT, de forma hierarquizada;

a) Quando exercida por mais de um ERT, dentro de um mesmo serviço de saúde, ART setorizada, de uma mesma região, ART regionalizada, de um mesmo território, ART territorializada, devem estar subordinados a um ERT (Coordenador de Enfermagem), atuando para garantir a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e para que outras diretrizes sejam uniformemente seguidas no âmbito do serviço de saúde.

b) Para unidades especiais que são reguladas por norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e que obriga o ERT possuir título de especialista na área fim, ele deverá ter a especialidade registrada junto ao regional.

Art. 12 Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART.

Parágrafo único. O ERT poderá atuar nas três áreas de gestão e o Enfermeiro Responsável Técnico autônomo e/ou liberal somente na gestão de área técnica.

Art. 13 Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de ERT.

Parágrafo único. As empresas/instituições/organizações públicas, beneficentes e filantrópicas, nas quais o Enfermeiro requerente ou ERT esteja vinculado, poderão requerer ao Coren a isenção do recolhimento das taxas de ART, mediante a comprovação de sua natureza jurídica.

Art. 14 O enfermeiro que deixar de exercer a atividade de ERT da empresa/instituição/organização, deverá comunicar seu desligamento da função de ERT ao Coren, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar de seu desligamento para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Parágrafo Único. O Coren deverá comunicar formalmente o cancelamento da ART para o enfermeiro requerente e a empresa/instituição/organização, mediante o Termo de Cancelamento.

Art. 15 No caso da empresa/instituição/organização, substituir definitivamente o ERT, esta deverá encaminhar ao Coren, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do ato, o comunicado de substituição acompanhado de todos os documentos arrolados no manual desta Resolução para que se proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes, se houver.

Art. 16 São atribuições do ERT:

I – Fazer o Planejamento e a Programação de Enfermagem com o quantitativo necessário de pessoal de Enfermagem para prestar uma assistência segura e de qualidade, informando de ofício ao representante legal da empresa/instituição/organização e ao Coren, devendo fornecê-lo anualmente ou no ato da renovação de ART, e sempre quando lhe for solicitado pelo Coren;

II – Organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de Enfermagem sob sua responsabilidade;

III - Manter-se atualizado, cumprir e fazer cumprir os atos regulatórios do exercício da profissão de enfermagem;

IV - Manter junto a empresa/instituição/organização os dados atualizados de todos os profissionais de Enfermagem onde atuam, com as seguintes informações: nome completo, CPF, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho devendo fornecê-la no ato da solicitação de concessão e renovação de ART, e quando lhe for solicitado, pelo Coren;

V - Verificar a inscrição dos profissionais de Enfermagem da empresa/instituição/organização quanto a suspensão ou cancelamento, e a validade da CIP;

VI - Afastar, de imediato, das atividades de assistência de Enfermagem os profissionais que não estão legalmente habilitados e inscritos para realização dos serviços de Enfermagem, bem como informar ao Representante Legal da empresa/instituição/organização e ao Coren;

VII - Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/organização e ao Coren situações de suposta infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência e/ou inexistência de enfermeiro nos locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante o período de funcionamento do serviço de Enfermagem da empresa/instituição/organização;

b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/organização sem inscrição, inscrição suspensa ou inscrição cancelada, ou com CIP vencida;

c) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na empresa/instituição/organização;

d) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional de Enfermagem e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE);

VIII - Intermediar, junto ao Coren, a implantação e funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem, de acordo com as normas vigentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

IX - Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Coren, bem como fazer cumprir, no prazo estabelecido, todas as notificações, citações, convocações e intimações que lhes forem demandadas pela Autarquia;

X - Manter a CRT em local visível ao público afixada em suas dependências e de acesso público, observando o prazo de validade;

XI - Responsabilizar-se pela implantação e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) conjuntamente com os profissionais de Enfermagem, conforme legislação vigente;

XII - Organizar o Serviço de Enfermagem com base na SAE, utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão, Processo de Enfermagem, escala e outros;

XIII - Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar escala, regimento interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos operacionais padrão, protocolos, Processo de Enfermagem e demais instrumentos administrativos de Enfermagem, podendo ser realizados com apoio dos profissionais de Enfermagem;

XIV - Colaborar e/ou participar das atividades das comissões, programas, núcleos e grupos de trabalho instituídos na empresa/instituição/organização. Na ausência, designar profissional de Enfermagem que o represente e ainda indicar profissionais de Enfermagem para compor os respectivos coletivos;

XV - Contribuir na promoção da qualidade e desenvolvimento da assistência de Enfermagem com práticas seguras para a sociedade, profissionais de Enfermagem e instituições de saúde, em seus aspectos técnicos e éticos;

XVI - Observar as Normas Regulamentadoras (NR), as Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC), portarias ministeriais e demais atos normativos de órgãos sanitários e de saúde, com a finalidade de mitigar os riscos à saúde da equipe de Enfermagem, do indivíduo, da família ou da coletividade;

XVII - Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, sob supervisão, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87, e demais dispositivos legais;

XVIII - Garantir que os registros de todas as ações assistenciais, ensino/formação e administrativos de Enfermagem sejam realizados conforme normas vigentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XIX - Comunicar formalmente ao Coren, sempre que existir, atos que impeçam o cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, da legislação do Exercício Profissional, dos atos regulatórios do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, assim como os demais profissionais de Enfermagem da empresa/instituição/organização, comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os responsáveis pelo impedimento;

XX - Requerer que os profissionais de Enfermagem da empresa/instituição/organização portem a CIP para o exercício das atividades profissionais de Enfermagem;

XXI - Certificar que as estratégias educacionais práticas: estágio curricular, aulas práticas e visitas técnicas sejam realizadas sob supervisão do Enfermeiro professor orientador, preceptor, da instituição proponente e/ou profissional Enfermeiro da instituição concedente, respeitando a legislação vigente;

XXII - Participar do processo de seleção de pessoal, na instituição pública, privada, beneficente ou filantrópica, certificando-se que está de acordo com o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e demais normas vigentes. Na ausência, designar profissional Enfermeiro que o represente;

XXIII – Participar da avaliação de desempenho da equipe de Enfermagem de forma periódica, utilizando ferramentas validadas e definidas pela empresa/instituição/organização;

XXIV - Promover, estimular e proporcionar, direta ou indiretamente, proposta política pedagógica que favoreça ao profissional de Enfermagem o processo de ensino/aprendizagem com fulcro no aprimoramento, atualização e capacitação de conhecimento técnico, científico e legal;

XXV - Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de ferramenta de Análise Situacional para fundamentar Plano de Ação e posterior avaliação dos resultados a ser apresentado à empresa/instituição/organização e ao Coren, sempre que lhe for solicitado;

XXVI - Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da empresa/instituição/organização em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem;

XXVII - Promover e/ou facilitar junto à empresa/instituição/organização a educação permanente dos profissionais de Enfermagem.

Art. 17 É facultado ao ERT criar, quando necessário, comissões, grupos de trabalhos e/ou núcleos para apoiar na promoção das atividades previstas nessa resolução, coordenadas por ele.

Art. 18 O ERT que descumprir as atribuições previstas nesta Resolução, poderá ser notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a processo ético/disciplinar na Autarquia.

Art. 19 O ERT poderá fazer jus de retribuição pecuniária atribuída ao exercício profissional com valor fixo acrescido ao seu vencimento ou utilizar a Resolução Cofen nº 673/2021, anexo II, 1) Atividades Administrativas, 1.10 Responsabilidade Técnica, ou outra que lhe sobrevir.

Art. 20 O ERT deverá comunicar formalmente ao Coren nos casos de afastamentos temporários por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nos casos em que o período de afastamento temporário for de 31 (trinta e um) a 120 (cento e vinte) dias, a empresa/instituição/organização deverá designar o ERT interino, por meio de ato normativo, e informar ao Coren o nome completo do profissional e período o qual exercerá as atividades de ERT;

§ 2º Nos casos em que o período de afastamento do ERT for superior a 121 (cento e vinte e um) dias, caberá a empresa/instituição/organização ou ERT requerer cancelamento da ART, e seguir os trâmites previstos no artigo 8º desta resolução;

§ 3º Excepcionalmente, em caso de licença maternidade, a ERT poderá ser substituída pelo ERT interino durante o período de afastamento;

§ 4º O ERT interino deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Coren, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito, e ter antecedentes éticos que permitam o exercício profissional.

Art. 21 Fica discricionário ao Coren, o uso de meios digitais para a organização administrativa de interação, a fim de viabilizar os procedimentos necessários para concessão do registro, cancelamento e renovação de ART.

Art. 22 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 23 Esta Resolução entrará em vigor após sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 509/2016.

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente

SILVIA MARIA NERI PIEDADE

Coren-RO 92.597-ENF

Primeira-Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Coren-RO 92.597-ENF, Primeira-Secretária**, em 29/09/2023, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Coren-PB 42.725-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 29/09/2023, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0164308** e o código CRC **59123A60**.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.519.741/0001-20 DUNS®: 928334188
Razão Social: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/10/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/11/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.519.741/0001-20 DUNS®: 928334188
Razão Social: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 926756 - EPR-CONSÓRCIO PUB. INT. SAÚDE NORT.PIONEIRO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 19/09/2025
Data Aplicação: 19/09/2025
Número do Processo: 068/2024 Número do Contrato: 410/2024
Descrição/Justificativa: Falhas na execução do objeto, como a não entrega dos produtos dentro do prazo, conforme artigo 156, I da Lei nº 14.133/2021.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II
UASG Sancionadora: 926756 - EPR-CONSÓRCIO PUB. INT. SAÚDE NORT.PIONEIRO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 19/09/2025
Data Aplicação: 19/09/2025 Valor da Multa: R\$ 516,00
Número do Processo: 068/2024 Número do Contrato: 410/2024
Descrição/Justificativa: Falhas na execução do objeto, como a não entrega dos produtos dentro do prazo, conforme artigo 156, II, § 3ª da Lei nº 14.133/2021.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 102122 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 08/10/2025
Data Aplicação: 08/10/2025
Número do Processo: 15400000388202570
Descrição/Justificativa: Conforme documento SEI nº 0085379972 da Faculdade de Odontologia de Bauru, aplica-se a sanção de advertência em razão do descumprimento parcial do prazo de entrega contratual, ainda que justificado por fatores alheios à contratada, por ausência de pedido tempestivo de prorrogação.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 17/09/2024
Data Aplicação: 17/09/2024
Número do Processo: 23537.024465/2024 Número do Contrato: 200/2023
Descrição/Justificativa: Conforme Decisão - SEI 105 (42455825) da Alta Gestão do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh aplica-se sanção de multa , no valor de R\$ 268,00 (duzentos e sessenta e dois reais), por descumprimento contratual em relação ao item 4.1 - do Termo de Referência da Ata de de Dispensa de Licitação DL nº 200/2023, do fornecedor Odontoshow Produtos Odontológicos LTDA , conforme processo administrativo de nº23537.023604/2023-76.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 17/09/2024
Data Aplicação: 17/09/2024
Número do Processo: 23537024465202489 Número do Contrato: DL 200/2023
Descrição/Justificativa: Conforme Decisão - SEI 106 (42455825) da Alta Gestão do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh aplica-se sanção de multa , no valor de R\$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), por descumprimento contratual em relação ao item 4.1 - do Termo de Referência da Ata de da Dispensa de Licitação DL nº 200/2023, do fornecedor Odontoshow Produtos Odontológicos LTDA, conforme processo administrativo de nº23537.023604/2023-76.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.519.741/0001-20 DUNS®: 928334188
Razão Social: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ comum: 051.763.829-03	Vínculo com 36.519.741/0001-20: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.	Vínculo com 06.194.440/0001-03: Dirigente inativo (10/10/2022 07:43) e Sócio/Admin inativo (10/10/2022 07:43).
896.860.049-04	Responsável Legal inativo (07/10/2025 07:11).	Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo Inicial:	15/07/2025	Prazo Final:	15/07/2027
Tipo da Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo Inicial:	09/12/2025	Prazo Final:	09/12/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.519.741/0001-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:41:54 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: EPraNVr8Oc4VqDoHChlj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA**

CPF/CNPJ: **051.763.829-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:42:18 do dia 12/06/2026 , com validade até o dia 12/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: x5gcX20lhbPPy5SbKfQ2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900332026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
19	BALANÇA PESAR PESSOAS - BALANÇA PESAR PESSOAS - BALANÇA PESAR PESSOAS CAPACIDADE: 150KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, MODELO: DIGITAL CORPORAL DE BIOPEDÂNCIA, CONECTIVIDADE: CARTÃO SD, CAPACIDADE MEDIÇÃO: PERCENTUAL DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, GORDURA VIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE LEITURA DE DADOS MARCA: SUPERMEDY MODELO/VERSÃO: SUPERMEDY	Unidade	30,00	50,00	1.500,00
29	CATETER PERIFÉRICO - CATETER PERIFÉRICO - CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: BIOSANI MODELO/VERSÃO: BIOSANI	Unidade	100,00	0,87	87,00
160	SONDA TRATO URINÁRIO - Sonda Trato Urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR	Unidade	100,00	1,92	192,00
178	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: GLOMED MODELO/VERSÃO: GLOMED	Unidade	10,00	3,20	32,00
179	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: GLOMED MODELO/VERSÃO: GLOMED	Unidade	10,00	3,20	32,00
180	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: SILICONE, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: GLOMED MODELO/VERSÃO: GLOMED	Unidade	10,00	3,20	32,00
181	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	Unidade	5,00	3,00	15,00

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR				
182	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR	Unidade	20,00	3,00	60,00
183	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR	Unidade	20,00	3,00	60,00
184	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR	Unidade	10,00	3,00	30,00
185	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO MARCA: SOLIDOR MODELO/VERSÃO: SOLIDOR	Unidade	10,00	3,00	30,00
				Valor total da proposta:	2.070,00

O valor total dessa proposta é de R\$2.070,00 (dois mil e setenta reais)

Dados Comerciais:

Dados Comerciais:

Banco: 756 - SICOOB**Conta: 41491-3****Agencia: 4342****Validade da proposta: 60 dias****Prazo de entrega: 20 dias****Prazo para pagamento: 30 dias****Prazo de garantia: 30 dias****Observações:**

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortúnica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

O proponente declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação

- A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico. A apresentação desta proposta implica na plena concordância e aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos.

- Nomeamos e constituímos a Sra. Sarah Carolina Guimarães da Rosa], portadora do CPF/MF nº 051.763.829-03, como responsável para acompanhar a execução do contrato referente ao Pregão Eletrônico, bem como todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento convocatório, seus anexos e no Contrato.

- Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- Comprometo-me a informar qualquer alteração nos dados de e-mail ou telefone por meio de protocolo junto ao Sistema de Protocolo deste Município. Na ausência de tal comunicação, consideram-se válidas as intimações realizadas nos contatos previamente fornecidos.

- Declaramos, para os devidos fins, que nenhum sócio desta empresa exerce cargo ou função pública que seja impeditivo ao estabelecimento de relacionamento comercial com a Administração Pública. Além disso, esta empresa se compromete a não contratar empregados que apresentem incompatibilidade com as autoridades contratantes ou com ocupantes de cargos de direção ou assessoramento, até o terceiro grau de parentesco, em conformidade com o disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).

FLOR DA SERRA DO SUL, 16 de Junho de 2026

Representante Legal**SARAH CAROLINA GUIMARÃES DA ROSA****RG: 8210567-0****CPF: 051.763.829-03**

DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0944084222 -----
-- GODOI E CASSIOLI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 04.005.370/0005-04 25351.097503/2022-54 / 7885511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653754225 -----
----- DROGARIA MOTA E FERREIRA LTDA / 40.980.459/0001-13 25351.097486/2022-55 / 7885451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653703221 -----
ECOMASCARAS FABRICAÇÃO DE EPI E PROTEÇÃO RESPIRATORIA LTDA / 37.118.469/0001-30 25351.110398/2022-56 / 8243934 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0716059223 -----
----- ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 / 19.026.964/0001-37 25351.097302/2022-57 / 8243812 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0652622224 -----
----- Eliziane Mallane Rosa de Sa / 44.060.162/0001-90 25351.088248/2022-59 / 7884927 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597114224 ---
----- GIMENES & GIMENES FARMACIA LTDA ME / 10.402.946/0002-19 25351.101872/2022-59 / 7884594 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674691228 ---
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0023-65 25351.101870/2022-60 / 7884529 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674685223 ---
----- NEO4ME PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 42.226.828/0001-02 25351.097318/2022-60 / 4043556 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0652725228 -----
----- Drogeria Sol de Piratininga LTDA / 06.253.776/0002-80 25351.137557/2022-60 / 7885234 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884821221 -----
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0026-08 25351.101888/2022-61 / 7884490 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674739226 -----
----- VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA / 10.247.643/0001-98 25351.125773/2022-62 / 4043664 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811401227 -----
----- DROGADIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 43.682.727/0001-09 25351.101912/2022-62 / 7884438 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674812221 -----
----- MEGAFARMA DROGARIAS EIRELI / 40.004.063/0001-30 25351.106420/2022-63 / 7885265 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698048221 -----
----- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2898-01 25351.100813/2022-63 / 7884699 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672063223 -----
----- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS CAVALCANTI LTDA / 37.932.128/0004-46 25351.101895/2022-63 / 7884411 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674760224 -----
----- **juliana paula guimaraes / 36.519.741/0001-20 25351.110406/2022-64 / 8244195 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0716112221** -----
----- WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA / 37.430.252/0001-60 25351.106131/2022-64 / 3111859 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0696151227 -----
----- DROGARIA COSTA VERDE CAMORIM LTDA / 38.045.049/0001-33 25351.097477/2022-64 / 7885416 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653676220 -----
----- CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.282.585/0001-55 25351.110389/2022-65 / 8243948 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0716017229 -----
----- DROGARIA A & J LTDA / 40.223.180/0002-76 25351.088278/2022-65 / 7884867 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597205221 -----
----- Karina Correa de Paula / 44.626.892/0001-06 25351.097484/2022-66 / 7885541 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653697222 -----
----- NL Gontijo Drogeria e Perfumaria Ltda / 44.657.599/0001-06 25351.106445/2022-67 / 7885325 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698243223 -----
----- PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA / 33.961.969/0001-88 25351.125741/2022-67 / 3111880 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811226221 -----
----- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 34.180.445/0001-12 25351.097235/2022-71 / 1271191 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0652278221 -----
----- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2905-67 25351.137555/2022-71 / 7885217 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884815227 -----

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 07/10/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional	
Razão Social ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ 36.519.741/0001-20
Nome Fantasia ODONTOSHOW	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RODOVIA BR 280, KM 288,6 100, SALA 01 - INTERIOR CEP: 85.618-000	Cidade/UF FLOR DA SERRA DO SUL/PR
Responsável Técnico MAIRA CRISTINA VIEIRA	Responsável Legal MAIRA CRISTINA VIEIRA

Dados do Cadastro		
Nº da Autorização 8.24419-5 (631203XH8W98)	Data da Autorização 17/03/2022	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.110406/2022-64</u>	Autorização Dispositivos Médicos	
Atividades / Classes		
Armazenar		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Distribuir		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Expedir		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4954457220

JOSE HOMERO DE SOUZA FILHO / 09.520.508/0006-08
25351.102028/2023-26 / 7969321
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0164849238

ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA / 23.359.559/0001-08
25351.097199/2023-26 / 4054422
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156548232

RS DE VARGAS COSMÉTICOS LTDA / 24.022.254/0001-79
25351.099439/2023-27 / 4054436
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161042236

VILSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR / 04.279.223/0001-90
25351.107347/2023-28 / 7968175
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173464238

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595357/2022-28 / 3118600
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980292224

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0738-08
25351.102770/2023-31 / 7968711
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166912239

M J DIAGNOSTICO LTDA / 27.488.259/0001-80
25351.099613/2023-31 / 8265497
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0161228232

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 16.589.779/0001-62
25351.587061/2022-33 / 8265986
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4965739221

cooperativa dos transportadores de cargas do norte / 03.368.702/0001-10
25351.622746/2022-33 / 1288775
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5028634220

FARMACIA RAFAEL LTDA / 11.055.990/0001-81
25351.099500/2023-36 / 7969093
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161109233

SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. / 04.298.106/0032-70
25351.111225/2023-36 / 8265742
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0180073231

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 36.519.741/0001-20
25351.425472/2022-36 / 1288758
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4782476221

WBFARMA SHOPPING BEBEDOURO LTDA / 49.167.045/0001-44
25351.099998/2023-37 / 7969261
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161674232

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595806/2022-38 / 1284588
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980177221

FARMACIA FARMALIVE LTDA / 49.233.118/0001-59
25351.107183/2023-39 / 7968100
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173284230

WENSING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 49.368.209/0001-00
25351.100179/2023-40 / 7969304
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161879233

MARCOS PAULO DA SILVA DROGARIA LTDA / 42.816.740/0001-40
25351.099280/2023-41 / 7968999
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160864232

Atacadó Maringá Industria e Comércio de Alimentos LTDA / 72.272.149/0001-30
25351.577910/2022-41 / 4051929
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4951702223

DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA / 33.760.101/0001-10
25351.096931/2023-41 / 3120266
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156266237

MONIQUE HELLEN SOUSA LIMA / 47.595.312/0001-59
25351.107079/2023-44 / 7968040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173171231

FARMACIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA / 33.490.478/0002-87
25351.102828/2023-47 / 7968738
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166973238

SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA / 09.580.548/0033-00
25351.099805/2023-48 / 7969136
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161457231

WJ RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA / 45.512.842/0001-60
25351.025108/2023-51 / 7969352
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0038566231

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / 01.137.526/0001-80
25351.036664/2023-52 / 8266046
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0057639230

VITAL MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA / 81.393.423/0001-10
25351.097034/2023-54 / 8265449
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0156379236

FARMAKEMEL LTDA / 04.531.598/0002-87
25351.102801/2023-54 / 7968724

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166945234

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0633-30
25351.107366/2023-54 / 7968192
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173488234

FARMA 80 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 39.379.611/0001-28
25351.100145/2023-55 / 7969292
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161835236

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3166-20
25351.100064/2023-55 / 7969289
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161746233

TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.409.405/0001-77
25351.099419/2023-56 / 7969080
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161020232

BARBARA E FAGUNDES LTDA / 45.448.030/0001-01
25351.107246/2023-57 / 7968131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173357237

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595760/2022-57 / 8260776
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4980173225

H DE P SILVA / 46.674.895/0001-40
25351.099930/2023-58 / 7969244
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161596231

STERNA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 16.964.054/0001-07
25351.586561/2022-58 / 1284418
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4965208226

P R BERNARDO OXIGENIO LTDA / 20.323.482/0001-28
25351.021907/2023-58 / 1288789
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0033655235

joyka comercio e importacao ltda / 43.679.986/0001-80
25351.029799/2023-61 / 8265711
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0046155236

cristian cacildo streck / 48.754.218/0001-68
25351.102768/2023-62 / 7968707
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166910236

M R M DROGARIA LTDA / 48.191.631/0001-61
25351.099907/2023-63 / 7969231
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161570232

M.A.B DE MARCO / 39.923.088/0001-59
25351.099671/2023-65 / 3120309
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161293239

FARMACIA ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA LTDA / 46.338.858/0001-61
25351.099833/2023-65 / 7969213
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161486231

MSC DROGARIA LTDA / 48.504.509/0001-06
25351.099382/2023-66 / 7969031
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160981239

FARMACIA CUNHAU LTDA / 48.079.045/0001-20
25351.102863/2023-66 / 7968741
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167012231

M L CURSINO / 49.560.280/0001-81
25351.100016/2023-67 / 7969275
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161695230

VIEIRA E PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.394.665/0001-00
25351.107406/2023-68 / 7968616
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173531237

G J COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.170.675/0001-78
25351.107387/2023-70 / 7968218
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173509231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0056-12
25351.107034/2023-70 / 7968036
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173125239

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0456-96
25351.107122/2023-71 / 7968098
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173214231

DISTALMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / 47.158.280/0001-24
25351.099133/2023-71 / 1288471
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0160699231

drogaria farmacriss LTDA / 48.255.524/0001-50
25351.074075/2023-72 / 7969349
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0118600231

MASTERLIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 36.163.854/0001-36
25351.581009/2022-73 / 8265990
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4954841224

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0068-50
25351.107193/2023-74 / 7968113
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173295231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0055-31
25351.107228/2023-75 / 7968127
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173337236

JULIANA DIAS CHAVES / 47.793.238/0001-85
25351.056865/2023-76 / 7966845
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo / 0239906233

MONICA F BITTENCOURT / 14.993.365/0001-79
25351.099768/2023-78 / 8265483



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 07/10/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional	
Razão Social ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ 36.519.741/0001-20
Nome Fantasia ODONTOSHOW	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RODOVIA BR 280, KM 288,6 100, SALA 01 - INTERIOR CEP: 85.618-000	Cidade/UF FLOR DA SERRA DO SUL/PR
Responsável Técnico SARAH CAROLINA GUIMARAES	Responsável Legal ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

Dados do Cadastro		
Nº da Autorização 1.28875-8	Data da Autorização 28/03/2023	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.425472/2022-36</u>	Autorização Medicamento	
Atividades / Classes		
Armazenar		
• Medicamento		
Distribuir		
• Medicamento		
Expedir		
• Medicamento		

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0944084222 -----
-- GODOI E CASSIOLI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 04.005.370/0005-04 25351.097503/2022-54 / 7885511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653754225 -----
----- DROGARIA MOTA E FERREIRA LTDA / 40.980.459/0001-13 25351.097486/2022-55 / 7885451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653703221 -----
ECOMASCARAS FABRICAÇÃO DE EPI E PROTEÇÃO RESPIRATORIA LTDA / 37.118.469/0001-30 25351.110398/2022-56 / 8243934 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0716059223 -----
----- ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 / 19.026.964/0001-37 25351.097302/2022-57 / 8243812 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0652622224 -----
----- Eliziane Mallane Rosa de Sa / 44.060.162/0001-90 25351.088248/2022-59 / 7884927 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597114224 ---
----- GIMENES & GIMENES FARMACIA LTDA ME / 10.402.946/0002-19 25351.101872/2022-59 / 7884594 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674691228 ---
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0023-65 25351.101870/2022-60 / 7884529 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674685223 ---
----- NEO4ME PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 42.226.828/0001-02 25351.097318/2022-60 / 4043556 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0652725228 -----
----- Drogeria Sol de Piratininga LTDA / 06.253.776/0002-80 25351.137557/2022-60 / 7885234 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884821221 -----
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0026-08 25351.101888/2022-61 / 7884490 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674739226 -----
----- VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA / 10.247.643/0001-98 25351.125773/2022-62 / 4043664 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811401227 -----
----- DROGADIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 43.682.727/0001-09 25351.101912/2022-62 / 7884438 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674812221 -----
----- MEGAFARMA DROGARIAS EIRELI / 40.004.063/0001-30 25351.106420/2022-63 / 7885265 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698048221 -----
----- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2898-01 25351.100813/2022-63 / 7884699 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672063223 -----
----- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS CAVALCANTI LTDA / 37.932.128/0004-46 25351.101895/2022-63 / 7884411 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674760224 -----
----- **juliana paula guimaraes / 36.519.741/0001-20 25351.110406/2022-64 / 8244195 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0716112221** -----
----- WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA / 37.430.252/0001-60 25351.106131/2022-64 / 3111859 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0696151227 -----
----- DROGARIA COSTA VERDE CAMORIM LTDA / 38.045.049/0001-33 25351.097477/2022-64 / 7885416 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653676220 -----
----- CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.282.585/0001-55 25351.110389/2022-65 / 8243948 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0716017229 -----
----- DROGARIA A & J LTDA / 40.223.180/0002-76 25351.088278/2022-65 / 7884867 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597205221 -----
----- Karina Correa de Paula / 44.626.892/0001-06 25351.097484/2022-66 / 7885541 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653697222 -----
----- NL Gontijo Drogeria e Perfumaria Ltda / 44.657.599/0001-06 25351.106445/2022-67 / 7885325 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698243223 -----
----- PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA / 33.961.969/0001-88 25351.125741/2022-67 / 3111880 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811226221 -----
----- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 34.180.445/0001-12 25351.097235/2022-71 / 1271191 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0652278221 -----
----- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2905-67 25351.137555/2022-71 / 7885217 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884815227 -----

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ

36.519.741/0001-20

Nome Fantasia

ODONTOSHOW

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

AV FRANCISCO PERONDI, 435 SALA 2 - CENTRO CEP: 85.618-000

Cidade/UF

FLOR DA SERRA DO SUL/PR

Responsável Técnico

MAIRA CRISTINA VIEIRA

Responsável Legal

MAIRA CRISTINA VIEIRA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.24419-5 (631203XH8W98)

Data da Autorização

17/03/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.110406/2022-64**Autorização**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4954457220

JOSE HOMERO DE SOUZA FILHO / 09.520.508/0006-08
25351.102028/2023-26 / 7969321
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0164849238

ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA / 23.359.559/0001-08
25351.097199/2023-26 / 4054422
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156548232

RS DE VARGAS COSMÉTICOS LTDA / 24.022.254/0001-79
25351.099439/2023-27 / 4054436
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161042236

VILSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR / 04.279.223/0001-90
25351.107347/2023-28 / 7968175
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173464238

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595357/2022-28 / 3118600
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980292224

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0738-08
25351.102770/2023-31 / 7968711
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166912239

M J DIAGNOSTICO LTDA / 27.488.259/0001-80
25351.099613/2023-31 / 8265497
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0161228232

HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 16.589.779/0001-62
25351.587061/2022-33 / 8265986
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4965739221

cooperativa dos transportadores de cargas do norte / 03.368.702/0001-10
25351.622746/2022-33 / 1288775
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5028634220

FARMACIA RAFAEL LTDA / 11.055.990/0001-81
25351.099500/2023-36 / 7969093
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161109233

SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. / 04.298.106/0032-70
25351.111225/2023-36 / 8265742
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0180073231

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 36.519.741/0001-20
25351.425472/2022-36 / 1288758
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4782476221

WBFARMA SHOPPING BEBEDOURO LTDA / 49.167.045/0001-44
25351.099998/2023-37 / 7969261
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161674232

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595806/2022-38 / 1284588
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4980177221

FARMACIA FARMALIVE LTDA / 49.233.118/0001-59
25351.107183/2023-39 / 7968100
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173284230

WENSING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 49.368.209/0001-00
25351.100179/2023-40 / 7969304
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161879233

MARCOS PAULO DA SILVA DROGARIA LTDA / 42.816.740/0001-40
25351.099280/2023-41 / 7968999
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160864232

Atacadó Maringá Industria e Comércio de Alimentos LTDA / 72.272.149/0001-30
25351.577910/2022-41 / 4051929
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4951702223

DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA / 33.760.101/0001-10
25351.096931/2023-41 / 3120266
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0156266237

MONIQUE HELLEN SOUSA LIMA / 47.595.312/0001-59
25351.107079/2023-44 / 7968040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173171231

FARMACIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA / 33.490.478/0002-87
25351.102828/2023-47 / 7968738
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166973238

SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA / 09.580.548/0033-00
25351.099805/2023-48 / 7969136
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161457231

WJ RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA / 45.512.842/0001-60
25351.025108/2023-51 / 7969352
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0038566231

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / 01.137.526/0001-80
25351.036664/2023-52 / 8266046
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0057639230

VITAL MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA / 81.393.423/0001-10
25351.097034/2023-54 / 8265449
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0156379236

FARMAKEMEL LTDA / 04.531.598/0002-87
25351.102801/2023-54 / 7968724

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166945234

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0633-30
25351.107366/2023-54 / 7968192
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173488234

FARMA 80 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 39.379.611/0001-28
25351.100145/2023-55 / 7969292
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161835236

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3166-20
25351.100064/2023-55 / 7969289
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161746233

TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.409.405/0001-77
25351.099419/2023-56 / 7969080
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161020232

BARBARA E FAGUNDES LTDA / 45.448.030/0001-01
25351.107246/2023-57 / 7968131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173357237

GUELTE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.853.302/0001-03
25351.595760/2022-57 / 8260776
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4980173225

H DE P SILVA / 46.674.895/0001-40
25351.099930/2023-58 / 7969244
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161596231

STERNA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 16.964.054/0001-07
25351.586561/2022-58 / 1284418
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4965208226

P R BERNARDO OXIGENIO LTDA / 20.323.482/0001-28
25351.021907/2023-58 / 1288789
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0033655235

joyka comercio e importacao ltda / 43.679.986/0001-80
25351.029799/2023-61 / 8265711
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0046155236

cristian cacildo streck / 48.754.218/0001-68
25351.102768/2023-62 / 7968707
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0166910236

M R M DROGARIA LTDA / 48.191.631/0001-61
25351.099907/2023-63 / 7969231
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161570232

M.A.B DE MARCO / 39.923.088/0001-59
25351.099671/2023-65 / 3120309
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0161293239

FARMACIA ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA LTDA / 46.338.858/0001-61
25351.099833/2023-65 / 7969213
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161486231

MSC DROGARIA LTDA / 48.504.509/0001-06
25351.099382/2023-66 / 7969031
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0160981239

FARMACIA CUNHAU LTDA / 48.079.045/0001-20
25351.102863/2023-66 / 7968741
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167012231

M L CURSINO / 49.560.280/0001-81
25351.100016/2023-67 / 7969275
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0161695230

VIEIRA E PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.394.665/0001-00
25351.107406/2023-68 / 7968616
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173531237

G J COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.170.675/0001-78
25351.107387/2023-70 / 7968218
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173509231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0056-12
25351.107034/2023-70 / 7968036
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173125239

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0456-96
25351.107122/2023-71 / 7968098
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173214231

DISTALMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA / 47.158.280/0001-24
25351.099133/2023-71 / 1288471
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0160699231

drogaria farmacriss LTDA / 48.255.524/0001-50
25351.074075/2023-72 / 7969349
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0118600231

MASTERLIMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 36.163.854/0001-36
25351.581009/2022-73 / 8265990
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4954841224

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0068-50
25351.107193/2023-74 / 7968113
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173295231

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0055-31
25351.107228/2023-75 / 7968127
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0173337236

JULIANA DIAS CHAVES / 47.793.238/0001-85
25351.056865/2023-76 / 7966845
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo / 0239906233

MONICA F BITTENCOURT / 14.993.365/0001-79
25351.099768/2023-78 / 8265483



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ

36.519.741/0001-20

Nome Fantasia

ODONTOSHOW

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

AV FRANCISCO PERONDI, 435 SALA 2 - CENTRO CEP: 85.618-000

Cidade/UF

FLOR DA SERRA DO SUL/PR

Responsável Técnico

DAIANA LILIAN PASTRE BARBIERI

Responsável Legal

MARIA FERNANDA GUIMARÃES

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.28875-8

Data da Autorização

28/03/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.425472/2022-36**Autorização**

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Diretoria de Cadastro e Tributação

3026
Página 1 / 1

Nº 9/2026

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
E/OU FUNCIONAMENTO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de: 800

NOME / RAZÃO SOCIAL

Contribuinte: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 36.519.741/0001-20 **Inscrição Municipal:** 800 **Inscrição Estadual:**
Nome Fantasia:


ENDEREÇO

Logradouro: Acesso Local RODOVIA BR 280, KM 288,6
Complemento:
Bairro: INTERIOR
Cidade: Flor da Serra do Sul
Número: 100
CEP: 85618-000
UF: PR

ATIVIDADES

- 4645103** - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4645101** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4789008** - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7420002** - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7420004** - Filmagem de festas e eventos
- 8230001** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Flor da Serra do Sul (PR), Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026


Prefeito Municipal


Pref. Mun. de Flor da Serra do Sul
Gilceia Aparecida Damasceno
Diretor de Cadastro e Tributação
Setor Tributário

VÁLIDO ATÉ 27/01/2027
FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



Dautin Blockchain
 Rua Dagoberto Nogueira, 100
 Ed. Torre Azul - 11º Andar
 Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 28/04/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0841948dc26b783745cc6d60a78641d78bc1e7054416d2e98d56f48a9f7fde98** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **305320** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA ODONTOSHOW 2026**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA ODONTOSHOW 2026**", faz prova de que em **28/01/2026 15:51:31**, o responsável **Odontoshow Produtos Odontológicos Ltda (36.519.741/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontoshow Produtos Odontológicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/01/2026 15:53:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x32ecd68100169410395824da363b7035862249eab7cd677c3e612785b10a82dc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Responsável Técnico
MAIRA CRISTINA VIEIRA

COREN-PR N°
510109

ANOTAÇÃO
2025003348

Data de Expedição
27/05/2025

Turno
07:30 ÀS 17:00

Administrador(a)

Instituição: **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Unidade: **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**

Gestão: **GESTÃO TÉCNICA**

Endereço: **ROD BR 280, KM 288,6, 100 - INTERIOR**

Cidade: **Flor da Serra do Sul**

Validade: **27/05/2026**

Situação: **Ativa/Aprovada**

Curitiba, 27 de maio de 2025 .

Ethelly Feitosa Rodrigues Santos
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
Presidente

Certidão N°: 27052.02512.35471.86597.74

Confirme a autenticidade através do QRCode ou link abaixo.



<https://sig1.corenpr.gov.br/pgsprocesso/ExibirCertidao.aspx?pNumeroCertidao=27052.02512.35471.86597.74>

Este documento deverá ser afixado em local visível ao público.

Relatório de Licença Sanitária

**LICENÇA SANITÁRIA Nº 202500010000122****VENCIMENTO: 27 / 10 / 2026**

Razão Social: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Nome Fantasia: odontoshow
CNPJ: 36.519.741/0001-20
Endereço: Br 280, Km 288,6, 100 - Sala 01 - Interior - Flor Da Serra Do Sul/PR - 85618-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

LOCAL E DATA: Francisco Beltrão, 27 de Outubro de 2025

Nádia Aparecida Zanella Vissoto
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 91B4ECD07F6F861C627D44223C1AD047
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>