



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.203
VÁLIDO

Validade: 13/09/2027

Nº. do Processo: 19964.113516/2022-77

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico (Policloreto de Vinila), lisa, ambidestra, não estéril, isenta de pó. Marca: Medix Brasil. Fabricante: Shanghai Intco Electrode Manufacturing Co.Ltd. (CHINA).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Marcação do CA: No punho e/ou embalagem

Referências: Luva para procedimento não cirúrgico de vinil sem pó

Tamanhos: P, M, G e GG

Cores: Transparente.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-2:2013

Laudos:

Nº. Laudo: LV11302112/22

Laboratório: CBTEI - Centro Brasileiro de Tecnologia Ltda ME

Empresa: MEDIX BRASIL LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO

CEP: 85812010

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	78.742.491/0001-33
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.02.969-0
Nome do Dispositivo Médico	KIT PARA NEBULIZAÇÃO VITALGOLD
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Mascaras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10296900071
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351479950201274
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: HANGZHOU FORMED MEDICAL DEVICES CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C002693 - Endereço: BUILDING3,NO.292 GONGHE NORTH ROAD, XINDENG TOWN FUYANG DISTRICT,311404,HANGZHOU, ZHEJIANG
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/10/2012
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	KIT PARA NEBULIZAÇÃO VITALGOLD.pdf	3914849215 - 04/10/2021 16:01:22

Modelo Produto Médico

Modelos: PAOGOS - KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGÊNIO PEDIÁTRICO
PAOGOS AR - KIT PARA NEBULIZAÇÃO AR COMPRIMIDO PEDIÁTRICO
PA06O4 - KIT PARA NEBULIZAGAO OXIGENIO ALONGADO PEDIATRICO
AR KIT PARA NEBULIZAGAO AR COMPRIMIDO ALONGADO PEDIATRICO
PAOGO1 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGÊNIO ADULTO
PAOBO1 AR - KIT PARA NEBULIZAÇÃO AR COMPRIMIDO ADULTO
PAOBO2 - KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGÊNIO ALONGADO ADULTO
PAOGO2 AR- KIT PARA NEBULIZAÇÃO AR COMPRIMIDO ALONGADO ADULTO

Acessórios:

Mascaras - P - M - G - GG

Bocal para inalação oral

Frasco Nebulizador - 6 ml - 8 ml - 10 ml - 12 ml

Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido- 3/4" - extensão de 1,50m

Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido- 3/4" - extensão de 1,60m

Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido- 3/4" - extensão de 2,10m

Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido - 3/4" - extensão de 2,80m

Mangueira/extensão p/ Oxigênio - 3/4" - extensão de 1,50m

Mangueira/extensão p/ Oxigênio - 3/4" - extensão de 1,60m

Mangueira/extensão p/ Oxigênio - 3/4" - extensão de 2,10m

Mangueira/extensão p/ Oxigênio - 3/4" - extensão de 2,80m

Mangueira/extensão p/ Nebulização - extensão de 1,50m.

Mangueira/extensão p/ Nebulização - extensão de 1,60m.

Mangueira/extensão p/ Nebulização - extensão de 2,10m.

Mangueira/extensão p/ Nebulização - extensão de 2,80m.



JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A.

KIT PARA NEBULIZAÇÃO VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900071

INSTRUÇÕES DE USO

1. Girar a tampa do reservatório e retirar a tampa superior.
2. Adicionar o medicamento líquido de acordo com a prescrição medica.
3. Colocar a tampa e girar para fecha-la. Conectar a máscara ao reservatório.
4. Colocar a máscara no rosto do paciente com a elástico abaixo das orelhas, e ao redor do pescoço. Puxar suavemente as extremidades do elástico, até que a máscara esteja segura. Formar a tira de metal na máscara para ajustar o nariz.
5. Conectar o extensor ao fornecimento de oxigênio ou ar comprimido.
6. Fazer a inalação da névoa conforme orientação médica.
7. Finalizada a emissão de névoa, desconectar a extensão.
8. Limpar todos os acessórios.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto não esterilizado

Importante: Certificar-se cuidadosamente para que o Kit Nebulizador e todos os seus acessórios estejam limpos, antes de utilizar/reutilizar o Kit Nebulizador.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Leia as instruções antes de usar.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO



Lanceta de Segurança

Caixa com 4.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

Descrição

- ▶ Lanceta de segurança descartável Maxicor.
- ▶ Tamanho disponível:
28g - 1,8mm

O que é a Lanceta de Segurança?

É um pequeno dispositivo médico de auxílio na coleta de amostra de sangue.

Qual o uso da Lanceta de Segurança?

Ela é utilizada para a perfuração superficial da pele, a fim colher amostra de sangue capilar para diversos testes. Seu funcionamento baseia-se na punção por ação física, contra o local desejado.

Características da Lanceta de Segurança

Fabricada em plástico polietileno, com a agulha de aço inoxidável e esterilizada a raio gama, descartável de uso único.



▶ Código EAN:



Aparelho de Barbear

Caixa com 1.000 unidades | Pacote com 5 unidades

Descrição

- ▶ Possui cabo em plástico
- ▶ Lâmina dupla
- ▶ Com capa protetora
- ▶ Cada embalagem contém cinco aparelhos de barbear descartáveis.



▶ Código EAN:



O que é o aparelho de barbear?

O aparelho de barbear tem como o objetivo principal a remoção dos pelos faciais, mas pode ser usado em diversas partes do corpo como removedor de pelos. É vendido em cartucho com 5 unidades. O aparelho possui 2 lâminas paralelas protegidas por uma capa, e possui cabo plástico. Leve e de fácil manuseio. É muito usado em procedimentos cirúrgicos, onde houver a necessidade de remoção de pelos no local.

Produto não regulado pela CGTPS / ANVISA

FICHA TÉCNICA

Produto: Bolsa Coletor de Urina e Secreção Tipo Saco 2L

Marca: Letomed

Código do Produto: 12543

Registro ANVISA: 82241440001

Apresentação: Pacote com 100 unidades

Descrição do Produto

O Coletor de Urina Tipo Saco Adulto Letomed é indicado para a coleta e armazenamento de urina em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais e domiciliares. Possui capacidade de até 2 litros, oferecendo praticidade no manuseio, segurança durante o uso e conforto ao paciente.

Características Técnicas

Capacidade: 2 litros

Material: PVC atóxico, resistente e transparente

Tipo: Saco ADL para coleta de urina

Uso: Produto descartável, de uso único

Esterilização: Produto não estéril

Indicação: Coleta e armazenamento de urina

Embalagem: Pacote contendo 100 unidades



Finalidade de Uso

Produto destinado à coleta, acondicionamento e armazenamento temporário de urina, auxiliando profissionais da saúde em procedimentos de assistência, monitoramento e cuidados ao paciente.

Benefícios do Produto

Fabricado em material resistente e transparente, permitindo melhor visualização do conteúdo coletado. Produto prático, descartável e de uso único, contribuindo para a higiene e segurança nos atendimentos.

Modo de Uso

Utilizar conforme orientação do profissional de saúde e protocolo da instituição. Após o uso, descartar o produto em local apropriado, seguindo as normas de biossegurança e descarte de resíduos de serviços de saúde.

Condições de Armazenamento

Manter em local limpo, seco, arejado, protegido da luz solar direta, umidade e calor excessivo. Conservar na embalagem original até o momento do uso.

Precauções

Produto de uso único. Não reutilizar.

Produto não estéril.

Não utilizar caso a embalagem esteja violada, danificada ou fora do prazo de validade.

Utilizar somente para a finalidade indicada.

Classificação

Produto médico-hospitalar descartável para coleta de urina.

Fonte das informações técnicas: Supermédica Distribuidora Hospitalar — produto Bolsa Coletor de Urina e Secreção Tipo Saco 2L Letomed.

Posso também transformar essa ficha em **modelo mais formal para licitação**, com campos de fabricante, procedência, validade e assinatura da empresa.

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRIL**Anvisa nº:**

80495510020 (CA MTE 40093) / 80495510131 (CA MTE 47207)

Modelos

PP, P, M, G;

Indicação de uso

As Luvas de procedimento não cirúrgico 100% Nitrilo, sem pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.

Especificação técnica

Fabricada em 100% borracha sintética (nitrilo)

Não estéril

Sem pó

Ambidestra

Texturizada

Punho com bainha

Espessura: 0,08mm

Cor: **Rosa**

Disponível nos tamanhos: PP/ P/ M/ G

Comprimento: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G)

Descartável e de uso único

Validade 3 anos após a data de fabricação

Apresentação

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos.

Orientações de Uso

Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas.

Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.

Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC 825/2023

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652370861 - PP

7898652370830 - P

7898652370847 - M

7898652370854 - G

EAN14

17898652370868

17898652370837

17898652370844

17898652370851

Detentor da Notificação:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR Nº 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 04 de 13/11/2025

Imagens meramente ilustrativas:



Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

 SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA Estrada da Graciosa, 5711, Canguiri - CEP 83.412-460. Colombo PR	
INSTRUÇÕES DE USO – IU.SNE.2026.01	
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
PRODUTO	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
Nome Técnico	Sonda
Registro Anvisa	80019160013
Classificação de risco	Classe II
TAMANHO (diâmetro em FR e comprimento em cm)	6 FR x 60 cm. 8 FR x 60 cm e 100 cm 10 FR, 12 e 14 FR x 120 cm
Radiopacidade	Totalmente radiopaca com marcações (tamanhos 6 e 8 FR) e com marcação numérica (tamanhos 10, 12 e 14 FR)
Esterilidade	Estéril. Esterilizada a óxido de etileno
Uso	Uso único, somente por recomendação médica
Armazenamento	Armazenar em local limpo, seco, ao abrigo da luz solar e fontes de radiação
Prazo máximo de utilização	30 dias - Uso de curto prazo

APRESENTAÇÃO

A Sonda de Nutrição Enteral Solumed é confeccionada em material atóxico e biocompatível, composto por tubo flexível em poliuretano. O peso distal é formado por ogiva em PVC preenchida com esferas de aço inox. Conector proximal em forma de Y em PVC na extremidade com duas entradas distintas, sendo uma para a dieta alimentar e outra para medicamentos. Contém internamente um fio guia feito em aço inox lubrificado. Esterilizada a óxido de etileno e embalada em papel grau cirúrgico.

INDICAÇÃO/FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para a Terapia de Nutrição Enteral como dispositivo de acesso ao estômago ou duodeno com finalidade de oferecer suporte nutricional e/ou medicamentoso a pacientes com trato gastrointestinal que funcione, mas apresente dificuldades para ingestão. Podem ser administrados alimentos e medicamentos líquidos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Ler atentamente todas as advertências e precauções antes de abrir a embalagem do produto e fazer sua colocação.

Após uso o produto deve ser destruído e descartado conforme procedimentos da instituição de saúde.

Verifique o prazo de validade impresso na embalagem antes de uso. Caso a validade esteja vencida, NÃO utilizar o produto.

Antes do uso, verificar atentamente as condições da embalagem. Caso existam sinais de violação ou quaisquer outros que ponham em dúvida sua integridade, o produto não deve ser utilizado.

Só abra a embalagem no momento em o produto estiver prestes a ser utilizado e todos os procedimentos técnicos de preparo e assepsia tiverem sido tomados.

A colocação do produto no paciente deve obrigatoriamente ser realizada por médico ou enfermeiro devidamente habilitado e capacitado, seguindo rigorosamente procedimentos técnicos específicos aprovados por equipe multidisciplinar conforme as boas práticas vigentes na instituição. Esses procedimentos devem estar documentados nos procedimentos operacionais da instituição de saúde.

Certifique-se de que todo o material necessário para colocação da sonda no paciente esteja devidamente preparado e disponível no local e no momento da colocação.

Antes de iniciar a colocação da sonda no paciente, teste o deslize do fio guia enrolando a sonda em torno da mão, formando um círculo de aproximadamente 15 cm de diâmetro. Puxe-o suavemente com movimentos rotacionais, retire e reinsira cerca de 15 cm do mesmo e atestando o deslize satisfatório. Caso não deslize, realize o teste com outra sonda e só inicie a colocação no paciente após atestar o deslize do cabo guia.

NÃO dobre nenhuma parte da sonda para sua inserção e colocação no paciente.

NÃO utilize nenhum outro instrumento para auxiliar a inserção e colocação da sonda no paciente.

NÃO coloque a sonda no paciente se o mesmo estiver fazendo uso de quaisquer outros dispositivos inseridos nas vias por onde a sonda passará.

CONTRA INDICAÇÕES

Pacientes que apresentem anomalias ou que tenham doenças no nariz, garganta e/ou esôfago e/ou apresentem alergia a algum componente.

Pacientes que usam dispositivo endotraqueal necessitam de maiores cuidados durante a colocação da sonda, pois o mesmo pode guiá-la para a traquéia.

Para realização de exames de ressonância magnética a sonda deverá ser retirada do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO

1 - Explicar ao paciente consciente o procedimento que será realizado. O mesmo deve ser mantido calmo e tranquilo. No caso de pacientes comatosos, semi comatosos ou não colaborativos, a colocação da sonda deverá ser feita sob fluoroscopia.

2 - Posicionar o paciente sentado ou semi sentado, sem inclinar sua cabeça para frente. A cabeceira do leito deverá estar a 45 graus de inclinação.

3 - Para calcular a profundidade da inserção, colocar a ponta distal (ogiva) da sonda na ponta do nariz, estendendo o tubo até o lóbulo da orelha e daí até o apêndice xifóide, caso deseje posicionar no estômago. Acrescente a essa marca mais 25 a 35 cm para posicionamento na 2ª ou 3ª porção do duodeno ou no início do jejuno.

4 - Escolha a narina adequada para inserção da sonda.

5 - Lubrificar a sonda externamente com geléia anestésica.

6 - Iniciar a inserção da sonda. Quando a mesma atingir a orofaringe, incentivar o paciente a engolir. Caso necessário, podem ser dados alguns goles de água em temperatura ambiente para ajudar na passagem da sonda.

7 - Continuar até a ponta da sonda atingir o ponto desejado.

VERIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO

1 – A confirmação do posicionamento é obrigatória antes de iniciar qualquer infusão e pode ser realizada radiografia abdominal e/ou endoscopia. Antes da realização da radiografia abdominal podem ser realizadas previamente técnicas de confirmação da posição como: avaliação da presença de tosse, asfixia e dispneia, que podem estar associadas à posição da sonda em trato respiratório; capnografia ou colorimetria, a fim de investigar a presença de dióxido de carbono, o que sugere o posicionamento em trato respiratório; c) aspiração do conteúdo gástrico para avaliação da aparência, que pode ser límpido e incolor, verde ou marrom e mensuração do pH, que pode variar entre 5 ou menos.

2 - Para verificar o posicionamento da sonda por radiografia abdominal, certifique-se que o aparelho de raio X esteja ajustado com a frequência e intensidade suficientes para reflexão da região radiopaca e da ponta distal da sonda, bem como quaisquer outros que se façam necessários. Para uma melhor visualização, recomenda-se que a verificação via raio X seja realizada ainda com o cabo guia inserido na sonda.

3 - Retirar cuidadosamente o fio guia. Puxá-lo delicadamente, devagar, com movimentos leves e rotacionais. CASO O CABO GUIA NÃO DESLIZE SUAVEMENTE, NÃO FORCE. Retire toda a sonda, descarte-a e com uma nova, reinicie todo o processo.

4 - Após retirada do fio guia, fixar a sonda no paciente no dorso do nariz ou na face.

5 - Monitoramento Periódico: Verificar a marca de fixação (rima) e o comprimento externo da sonda a cada 4 horas e antes de cada administração.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1 - Os medicamentos devem ser administrados individualmente, realizando lavagem do dispositivo antes, entre e após cada fármaco. Lave o dispositivo com, pelo menos, 20 ml de água (mineral ou filtrada), antes de administrar a medicação. Administre o medicamento usando uma seringa limpa e específica para acesso enteral. Após o término da administração do medicamento, lave novamente com, pelo menos, 20 ml de água.

2 – No caso de dietas intermitentes ou em bolus, a lavagem deve ser realizada antes e após a administração com, no mínimo, 20 ml de água. No caso de dietas cíclicas ou contínuas a quantidade de água recomendada para lavagem é de, no mínimo, 20 ml e a frequência sugerida é de 4/4 horas até 8/8 horas, a depender também da frequência de administração de medicamentos durante a infusão da dieta e percepção de resistência pelo profissional durante as lavagens.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido dentro de sua embalagem original em ambiente seco, limpo, protegido da ação da luz solar e da umidade, isento da presença de insetos e roedores.

VALIDADE

O prazo de validade do produto é de 36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

EFEITOS ADVERSOS

O produto não causa efeitos adversos desde que seguidas todas as instruções de uso, seja manipulado por profissionais capacitados, sob procedimentos técnicos e apenas para o fim a que se destina.



	SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Estrada da Graciosa, 5711, Canguiri - CEP 83.412-460; Colombo PR SAC (41) 3663 7235 sac@solumed.ind.br
---	---	---

Ficha Técnica — Talas de Papelão (Resgate SP)	
Indicação de uso	Imobilização provisória de membros superiores e inferiores em resgate e transporte de pacientes.
Benefícios principais	Evita agravamento de fraturas e lesões; fácil e rápida montagem; moldável; descartável, uso único.
Características	- Moldável - Marcado para dobras - Compatível com fita crepe, gaze ou bandagem - Uso único e descartável - Produzida em papelão
Tamanhos disponíveis	PP: 30 x 20 cm P: 50 x 20 cm M: 70 x 20 cm G: 90 x 20 Cm
Embalagem	Pacote contendo 10 talas
Registro ANVISA	Isento
Validade	Indeterminada



90x20



30x20



70x20



50x20

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF

Anvisa nº:

80495510045

Modelos

2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0

Indicação de uso

O Tubo Endotraqueal Com Cuff é indicado para suporte ventilatório artificial, em situações onde o paciente está impossibilitado de respirar naturalmente, em função de efeitos anestésicos ou pela diminuição da capacidade pulmonar

Especificação técnica

Fabricado em PVC grau Médico translúcido - termossensível

Estéril – óxido de etileno

Para intubação oral e nasal

Válvula unidirecional

Balão de controle

Ponta chanfrada arredondada suave e atraumática

Válvula de conexão luer slip e luer lock

O manguito de baixa pressão e alto volume fornece uma vedação eficaz de baixa pressão

Olho de Murphy

Curva de Magill que reduz o trauma durante a intubação

Linha radiopaca

Siliconizado

Marcas de profundidade precisas

Conector ISO padrão de 15mm

Isento de látex

Descartável e de uso único

Validade 3 anos após data de esterilização

Modelos:

Cuff	Comprimento (mm)	Diâmetro de descanso do Cuff (forma cilíndrica)	Diâmetro de descanso do Cuff (forma olivar)
2.0	130mm	/	/
2.5	140mm	/	9.0±15%
3.0	160mm	12.0 ±15%	12.0 ±15%
3.5	180mm	12.0 ±15%	12.0 ±15%
4.0	200mm	14.0 ±15%	14.0 ±15%
4.5	220mm	14.0 ±15%	14.0 ±15%
5.0	240mm	17.0 ± 15%	17.0 ± 15%
5.5	270mm	14.0 ± 15%	14.0 ± 15%
6.0	280mm	20.0 ± 15%	19.0 ± 15%
6.5	290mm	20.0 ± 15%	19.0 ± 15%
7.0	300mm	25.0 ± 15%	22.0 ± 15%
7.5	310mm	25.0 ± 15%	22.0 ± 15%
8.0	320mm	26.0 ± 15%	24.0 ± 15%
8.5	320mm	26.0 ± 15%	24.0 ± 15%

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

9.0	320mm	28.0 ± 15%	27.0 ± 15%
9.5	320mm	28.0 ± 15%	27.0 ± 15%
10.0	320mm	28.0 ± 15%	27.0 ± 15%

Apresentação

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária: caixas de papelão contendo 200 unidades de Tubo Endotraqueal (8 caixas com 25 unidades cada).

Orientações de Uso

1. De um modo geral, antes de introduzir o tubo endotraqueal o paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, deve-se remover dentaduras e todas as próteses removíveis que ele esteja usando.
2. Selecionar um tubo de diâmetro adequado, fazer hiperextensão da cabeça do paciente e uma peça bucal deve ser colocada para estabilizar o tubo e impedir que o paciente o morda.
3. O procedimento deve ser realizado por duas pessoas, uma que realize o procedimento e outra que deve manter a estabilização manual da cabeça e da coluna cervical, a qual deve estar protegida também por um colar cervical.
4. Com o paciente sedado ou anestesiado, o médico passa através do seu nariz ou da sua boca, com a ajuda de um laringoscópio, um tubo que vai até a traqueia.
5. O laringoscópio é um aparelho normalmente utilizado para visualizar a laringe, mas que na intubação endotraqueal serve para facilitar a introdução do tubo endotraqueal, que será usado para ventilar mecanicamente o paciente.
6. Depois de realizada a intubação, o tubo traqueal deve ser ajustado à traqueia por meio de um balonete inflável e o paciente é ligado ao respirador, que promove a aeração adequada e onde são misturados três gases: ar, oxigênio e óxido nitroso, de maneira a manter a anestesia pelo tempo necessário.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Usar o produto somente durante prazo de validade.

Produto de uso único, não repetir sob hipótese alguma a utilização.

Contra Indicação:

Contraindicado o uso em pacientes que sofrem de edema de laringe, edema de garganta, séria hemorragia e ferimento de vértebra cervical, peito (tórax) oprimindo a traqueia, traqueia inflamada.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 02 de maio de 2022

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898652376788 – 2.5	17898652376785
7898652373121 – 3.0	17898652373128
7898652373138 – 3.5	17898652373135
7898652373145 – 4.0	17898652373142
7898652373152 – 4.5	17898652373159
7898652371073 – 5.0	17898652371070
7898652371080 – 5.5	17898652371087
7898652371097 – 6.0	17898652371094
7898652371103 – 6.5	17898652371100
7898652371110 – 7.0	17898652371117
7898652371127 – 7.5	17898652371124
7898652371134 – 8.0	17898652371131
7898652373169 – 8.5	17898652373166
7898652371141 – 9.0	17898652371148
7908966300826 – 9.5	17908966300823
7898652371158 – 10.0	17898652371155

Detentor da Notificação:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR Nº 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidorsac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 07 de 25/09/2025

Imagens meramente ilustrativas:

**Sede Administrativa**

 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
 (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
 (47) 3432-8741

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

FINALIDADE:

Utilizado para coleta de urina em pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Incontinência com ou sem extensão Não estéril

XP	P	M	G	XG	Número
3	4	5	6	7	
23	25	28	32	34	Largura
140 a 160 mm					Comprimento
Extensão					
Tubo n° 20 com 1 metro de comprimento					

A incontinência não estéril com extensão é embalada individualmente em embalagem de polietileno branco leitoso, vedado por termoselagem.

A incontinência não estéril sem extensão pode ser embalada em duas formas.

1º modelo de embalagem: Embalagem com formato de caixinha, cartucho em papelão tríplice 250g/m², nos tamanhos XP, P, M, G, XG com duas unidades.

2º modelo de embalagem: Polietileno branco leitoso, vedado por termoselagem nos tamanhos XP, P, M, G, XG com 1, 2, ou 4 unidades vedado por termoselagem.

MODO DE USO:

- Abrir a embalagem e retirar o dispositivo assepticamente;
- Ajustar o preservativo no pênis do paciente;
- Colocar a extremidade da extensão num recipiente para coleta da urina.
- Substituir o dispositivo, no mínimo, a cada 24 horas.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- Verificar se a embalagem esta perfeitamente fechada sem furos, rasgos, falhas de selagem e com umidade;
- Verificar se as informações contidas na embalagem estão de acordo com o código de defesa do consumidor como: prazo de validade, número de registro do produto no Ministério da Saúde, número do lote de fabricação, responsável técnico, dados do fornecedor ou fabricante e etc.;
- Podem ocorrer reações alérgicas a quem tem sensibilidade a borracha de látex natural.
- Produto a base de borracha natural, não deve ter contato com produtos derivados de petróleo.
- Armazenar em local seco e arejado longe do contato do solo e da luz solar.
- Se o produto apresentar manchas, impurezas, rasgos ou furos, não utilizar o produto e comunicar o fabricante;

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

REGISTRO ANVISA/MS Nº
8.02860.0.0036
I - BAIXO RISCO
Responsável Técnico:
SONIVAN FELIX DE ABREU
CRQ: IX 09.301988 -PR

FABRICADO POR:
Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.
Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin.
CEP 84.990-000 - Arapoti – PR
Email: sac@biosani.net.br
Telefone: (0xx43) 3557 – 4814
CNPJ: 06.143.681/0001-23

Lote:
Fabricação:
Validade:



Manual de instruções



Umidificadores para redes de oxigênio e ar comprimido
RMS: 80677040012



Considerações iniciais

Para garantir o melhor entendimento deste manual recomenda-se que algumas noções básicas sejam levadas em consideração, estas noções incluem nomenclaturas e símbolos específicos deste manual, e informações referentes à preservação do bom estado do equipamento.



Antes de operar o Umidificador certifique-se de que você esteja devidamente qualificado para operá-lo e que leu as instruções deste manual em sua totalidade. Quaisquer danos causados ao produto por operação indevida significarão uma violação dos termos de garantia do mesmo e a Ventcare Indústria e Comércio LTDA não se responsabiliza por quaisquer danos causados aos equipamentos médico-hospitalares e ao circuito causados por operação indevida.



Considera-se, para fins de devida higiene, que toda superfície de trabalho e equipamento médico-hospitalar estejam devidamente limpos, desinfetados e/ou esterilizados de acordo com as recomendações deste manual e/ou do devido setor/profissional devidamente qualificado para realizar este procedimento.



O símbolo ao lado indica que este produto **não é vendido esterilizado**, portanto, deve ser esterilizado antes do uso.

Sumário

Considerações Iniciais	2
Sumário	3
Conteúdos da embalagem	4
Preparos iniciais	5
Montagem	6
Preparação para limpeza	7
Processo de limpeza	8
Processo de Desinfecção/Esterilização	9
Adendos	10
Informações técnicas do produto – VENT68	13 à 16
Informações do fabricante	17 à 22
Informações do fabricante	22



Conteúdos da embalagem

ID	Imagem	Item	Qtde
A		Frasco Umidificador de Oxigênio ou Ar comprimido 250ml ¹	1 Un.
B		Extensão de oxigênio/Ar comprimido em PVC 1500mm ¹	1 Un.
C		Máscara plástica para umidificador ¹	1 Un.



Preparos iniciais

Prepare uma superfície de trabalho devidamente limpa e certifique-se de que está nas devidas condições para proceder com a abertura da embalagem, feito isto, siga os procedimentos:

1. Verifique se o lacre e/ou a embalagem principal não está violado e/ou adulterado, em caso de embalagem e/ou lacre danificado alerte seu centro de esterilização;
2. Rompa o lacre da embalagem principal do circuito respiratório;
3. Retire as demais embalagens lacradas dentro da embalagem principal e rompa os lacres;
4. Em uma superfície devidamente limpa e nivelada disponha os componentes do umidificador da forma que for mais conveniente;



Montagem

Com as mãos, superfície de trabalho e equipamento devidamente limpos siga as instruções abaixo para a devida montagem do circuito:

1. Afrouxe a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido anti-horário;
2. Levando em consideração os níveis mínimo e máximo indicados no frasco, coloque a quantidade de água e/ou medicação indicada pelo devido profissional qualificado;
3. Aperte a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido horário até que a tampa fique firmemente posicionada em seu lugar;
4. Certifique-se que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no produto e conecte o Frasco Umidificador ao fluxo de gás;
5. Gire a válvula de controle de fluxo do fluxômetro no qual o Frasco Umidificador está conectado no sentido anti-horário até que seja obtida a leitura desejada;
6. Para diminuir o fluxo do fluxômetro gire a válvula de controle de fluxo no sentido horário;
7. Conecte a extremidade da Extensão de Oxigênio/Ar comprimido à saída do Frasco Umidificador;
8. Conecte a extremidade restante da Extensão de Oxigênio/Ar comprimido à entrada de ar da Máscara Plástica para Umidificador;
9. Leve a máscara à face do paciente e siga os protocolos institucionais para o tratamento, certifique-se de que não há vazamentos ou detritos no equipamento.



Preparação para limpeza

⚠ Cuidado:

- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE o Frasco Umidificador, e DESINFECTE / ESTERILIZE;

Para realizar a limpeza do Frasco Umidificador, é necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo utilizado. A desconexão é realizada desencaixando a extensão da saída do Frasco Umidificador, fechando o fluxo girando a válvula de controle de fluxo do Fluxômetro no sentido horário e por fim, afrouxando a rosca do Frasco Umidificador girando-a no sentido anti-horário da saída do fluxômetro.

⚠ Importante!

O ato de puxar deve ser realizado segurando a extensão pelos bocais. Jamais puxar os itens segurando-os por partes flexíveis.

Processo de limpeza

Cuidado:

- Antes da primeira utilização e após cada utilização se necessário, LIMPE o Frasco Umidificador, DESINFECTE / ESTERILIZE.

- As partes externas do Frasco Umidificador devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o resíduo do produto de limpeza não se acumule nas espiras do produto;

Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de

esterilização e/ou desinfecção, obedecendo as condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

Para rotina de limpeza podem ser utilizados:

- Ácido Peracético
- Orthophthalaldeído

Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.



Processo de Desinfecção/Esterilização

Ácido Peracético:

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

- Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Óxido de Etileno (C₂H₄O)

A esterilização utilizando o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).

- Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

- Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.

Autoclave



Cuidado:

Este produto não deve ser inserido em equipamento Autoclave pois o mesmo irá irreversivelmente danificar sua integridade estrutura.

Adendos

1. Este produto está disponível em versão completa, assim como em suas partes individuais, para mais informação consulte:



<https://www.ventcare.com.br/atendimento>



Informações técnicas do produto – VENT68

Imagem do produto	Códigos do produto
	VENT68, VENT68M
	Descritivo
	VENT68 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO ROSCA PLÁSTICA - FRASCO 250 ML (RMS 80677040012) VENT68M UMIDIFICADOR DE OXIGENIO ROSCA METÁLICA - FRASCO 250 ML (RMS 80677040012)

Descrição e indicações do produto

O Umidificador é um produto para uso em gasoterapia médico-hospitalar projetado para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Foi desenvolvido para as atividades de Umidificação, gerada pela passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, que arrasta a água/solução fisiológica colocada no recipiente e são carregadas para as vias aéreas. Faz-se necessária a utilização de uma fonte gás (oxigênio ou ar comprimido medicinal) para seu funcionamento, utilizando a pressão de rede de gases de 3,5 Kgf/cm² e controlando a vazão com fluxômetro de acordo com procedimento clínico.

• Princípios de Funcionamento

O Umidificador deve ser conectado ao fluxômetro (Recomendado a pressão de trabalho de 3,5 a 6,0 kgf/cm² (bar), onde há necessidade de controle e regulação de fluxo de gás para arraste do líquido para umidificação.

Especificações técnicas

Nome técnico	Umidificador		
Nome comercial	Frasco Umidificador 250ml		
Registro na ANVISA	80677040012 (Cadastro por família - componente)		
Classificação de risco	II – Médio risco		
Pressão de trabalho	3,5 a 6,0 Kgf/cm2		
Padrão de Conexões	ABNT NBR – 11906		
Esterilização compatível	 Compatível com esterilização por Ácido Peracético		
Frasco Umidificador			
Material	Polietileno de Alta Densidade Atóxico (PEAD)		
Cor do frasco	Branco		
Peso do frasco	~16g (± 2g)		
Volumes	Volume útil	Volume total	
	250 ml	275ml	
Altura	Altura do frasco	Altura do frasco com tampa	
	~ 129 mm (± 2mm)	~131 mm (±2 mm)	
Diâmetro	Diâmetro total	Interno gargalo	Externo gargalo
	59,5 mm	21 mm	28 mm
Informações técnicas do material	GF 4950 – Petroquímica Ipiranga B 4002 N – Solvay BS 002 – OPP QUÍMICA HB 0454 – OPP QUÍMICA		

Versão 22.10

Ventcare Indústria e Comércio LTDA®
Página 11 de 22



Tampa	
Material	Polipropileno (PP)
Manípulo VENT68 (Rosca Plástica)	Polipropileno (PP)
Manípulo VENT68M (Rosca Metálica)	Polipropileno (PP) e inserto em Alumínio (Al)
Borbulhador & Tubo sucador	
Borbulhador	Polipropileno (PP)
Tubo Sucador	Polipropileno (PP) e Policloreto de Vinila (PVC)
Extensão	
Mangueira	Policloreto de Vinila (PVC)
Comprimento	De 1500 à 2000 mm
Máscara	
Materiais	Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) e Policloreto de Vinila (PVC)

Informações técnicas do produto – VENT68

Procedimento simplificado de operação

1. Antes de utilizar o Umidificador, certifique-se:
 - a) De que está limpo adequadamente;
 - b) Dá correta utilização do Fluxômetro;
 - c) Dá correta utilização da Extensão de oxigênio/ar comprimido;
 - d) Dos cuidados conforme o manual.

2. Procedimento para a realização do teste de verificação funcional do Umidificador e ações recomendadas para a solução de eventuais falhas encontradas no teste. O Umidificador deve ser testado nas seguintes situações:
 - Antes de sua primeira utilização;

3. Procedimento de operação:

Com as mãos, superfície de trabalho e equipamento devidamente limpos siga as instruções abaixo para a devida montagem do circuito:

1. Afrouxe a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido anti-horário;
2. Levando em consideração os níveis mínimo e máximo indicados no frasco, coloque a quantidade de água e/ou medicação indicada pelo devido profissional qualificado;
3. Aperte a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido horário até que a mesa fique firmemente posicionada em seu lugar;
4. Certifique-se que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no produto e conecte o Frasco Umidificador ao fluxo de gás;
5. Gire a válvula de controle de fluxo do fluxômetro no qual o Frasco Umidificador está conectado no sentido anti-horário até que seja obtida a leitura desejada;
6. Para diminuir o fluxo do fluxômetro gire a válvula de controle de fluxo no sentido horário;
7. Conecte a extremidade da Extensão de Oxigênio/ar comprimido à saída do Frasco Umidificador;
8. Conecte a extremidade restante da Extensão de Oxigênio/ar comprimido à entrada de ar da Máscara Plástica para Umidificador;
9. Leve a máscara à face do paciente e siga os protocolos institucionais para o tratamento, certifique-se de que não há vazamentos ou detritos no equipamento.

Informações técnicas do produto – VENT68

Preparação para limpeza



Cuidado:

- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE o Circuito, e DESINFECTE / ESTERILIZE;

Para realizar a limpeza do Circuito respiratório universal adulto, é necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo utilizado, por exemplo, respiradores, umidificadores e aparelhos de anestesia. A desconexão é realizada puxando-o no sentido contrário do local onde ele estiver acoplado. A desmontagem do Circuito Respiratório do local onde estiver sendo utilizado deve ser realizada desencaixando uns itens dos outros.



Importante!

- O ato de puxar deve ser realizado segurando o item por partes dos conectores / rígidas. Jamais puxar os itens segurando-os por partes flexíveis.



Importante!

- O Frasco Umidificador não deve ser inserido em um equipamento Autoclave, esterilizá-lo usando este método causará danos irreversíveis a integridade estrutural do produto



Informações técnicas do produto – VENT68

Limpeza



Cuidado:

• Antes da primeira utilização e após cada utilização se necessário, LIMPE o Circuito Respiratório, DESINFECTE / ESTERILIZE.

• As partes externas do circuito respiratório devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o resíduo do produto de limpeza não se acumule nas espiras do produto; Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo as condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

Para rotina de limpeza podem ser utilizados:

- Ácido Peracético
- Orthophtaldeído

Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

Desinfecção e/ou Esterilização

Ácido Peracético:

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

• Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Óxido de Etileno (C₂H₄O)

A esterilização utilizando o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).



Atenção:

• Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

• Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.



Informações técnicas do produto – VENT68

Autoclave

**Importante!**

- O Frasco Umidificador não deve ser inserido em um equipamento Autoclave, esterilizá-lo usando este método causará danos irreversíveis a integridade estrutural do produto

Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
- Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.



Manual de instruções – Umidificadores para rede de oxigênio e ar comprimido – RMS:80677040012

Informações técnicas do produto – VENT69

Imagem do produto	Códigos do produto
	VENT69
	Descritivo
	VENT69 UMIDIFICADOR DE AR COMPRIMIDO METÁLICA - FRASCO 250 ML (RMS 80677040012)

Descrição e indicações do produto

O Umidificador é um produto para uso em gasoterapia médico-hospitalar projetado para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Foi desenvolvido para as atividades de Umidificação, gerada pela passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, que arrasta a água/solução fisiológica colocada no recipiente e são carregadas para as vias aéreas. Faz-se necessária a utilização de uma fonte gás (oxigênio ou ar comprimido medicinal) para seu funcionamento, utilizando a pressão de rede de gases de 3,5 Kg/cm² e controlando a vazão com fluxômetro de acordo com procedimento clínico.

• Princípios de Funcionamento

O Umidificador deve ser conectado ao fluxômetro (Recomendado a pressão de trabalho de 3,5 a 6,0 kgf/cm² (bar), onde há necessidade de controle e regulagem de fluxo de gás para arraste do líquido para umidificação.

Especificações técnicas

Nome técnico	Umidificador		
Nome comercial	Frasco Umidificador 250ml		
Registro na ANVISA	80677040012 (Cadastro por família - componente)		
Classificação de risco	II – Médio risco		
Pressão de trabalho	3,5 a 6,0 Kgf/cm2		
Padrão de Conexões	ABNT NBR – 11906		
Esterilização compatível	 Compatível com esterilização por Ácido Peracético		
Frasco Umidificador			
Material	Polietileno de Alta Densidade Atóxico (PEAD)		
Cor do frasco	Branco		
Peso do frasco	~16g (± 2g)		
Volumes	Volume útil	Volume total	
	250 ml	275ml	
Altura	Altura do frasco	Altura do frasco com tampa	
	~ 129 mm (± 2mm)	~131 mm (±2 mm)	
Diâmetro	Diâmetro total	Interno gargalo	Externo gargalo
	59,5 mm	21 mm	28 mm
Informações técnicas do material	GF 4950 – Petroquímica Ipiranga B 4002 N – Solvay BS 002 – OPP QUÍMICA HB 0454 – OPP QUÍMICA		

Versão 22.10

Ventcare Indústria e Comércio LTDA®
Página 17 de 22



Informações técnicas do produto – VENT69

Tampa	
Material	Polipropileno (PP)
Manípulo VENT68 (Rosca Plástica)	Polipropileno (PP)
Manípulo VENT68M (Rosca Metálica)	Polipropileno (PP) e inserto em Alumínio (Al)
Borbulhador & Tubo sucador	
Borbulhador	Polipropileno (PP)
Tubo Sucador	Polipropileno (PP) e Policloreto de Vinila (PVC)
Extensão	
Mangueira	Policloreto de Vinila (PVC)
Comprimento	De 1500 à 2000 mm
Máscara	
Materiais	Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) e Policloreto de Vinila (PVC)



Informações técnicas do produto – VENT69

Procedimento simplificado de operação

1. Antes de utilizar o Umidificador, certifique-se:
 - a) De que está limpo adequadamente;
 - b) Dá correta utilização do Fluxômetro;
 - c) Dá correta utilização da Extensão de oxigênio/ar comprimido;
 - d) Dos cuidados conforme o manual.
2. Procedimento para a realização do teste de verificação funcional do Umidificador e ações recomendadas para a solução de eventuais falhas encontradas no teste. O Umidificador deve ser testado nas seguintes situações:
 - Antes de sua primeira utilização;

3. Procedimento de operação:

Com as mãos, superfície de trabalho e equipamento devidamente limpos siga as instruções abaixo para a devida montagem do circuito:

1. Afrouxe a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido anti-horário;
2. Levando em consideração os níveis mínimo e máximo indicados no frasco, coloque a quantidade de água e/ou medicação indicada pelo devido profissional qualificado;
3. Aperte a tampa do Frasco Umidificador girando-a no sentido horário até que a mesa fique firmemente posicionada em seu lugar;
4. Certifique-se que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no produto e conecte o Frasco Umidificador ao fluxo de gás;
5. Gire a válvula de controle de fluxo do fluxômetro no qual o Frasco Umidificador está conectado no sentido anti-horário até que seja obtida a leitura desejada;
6. Para diminuir o fluxo do fluxômetro gire a válvula de controle de fluxo no sentido horário;
7. Conecte a extremidade da Extensão de Oxigênio/ar comprimido à saída do Frasco Umidificador;
8. Conecte a extremidade restante da Extensão de Oxigênio/ar comprimido à entrada de ar da Máscara Plástica para Umidificador;
9. Leve a máscara à face do paciente e siga os protocolos institucionais para o tratamento, certifique-se de que não há vazamentos ou detritos no equipamento.



Informações técnicas do produto – VENT69

Preparação para limpeza



Cuidado:

- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE o Circuito, e DESINFECTE / ESTERILIZE;

Para realizar a limpeza do Circuito respiratório universal adulto, é necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo utilizado, por exemplo, respiradores, umidificadores e aparelhos de anestesia. A desconexão é realizada puxando-o no sentido contrário do local onde ele estiver acoplado. A desmontagem do Circuito Respiratório do local onde estiver sendo utilizado deve ser realizada desencaixando uns itens dos outros.



Importante!

- O ato de puxar deve ser realizado segurando o item por partes dos conectores / rígidas. Jamais puxar os itens segurando-os por partes flexíveis.



Importante!

- O Frasco Umidificador não deve ser inserido em um equipamento Autoclave, esterilizá-lo usando este método causará danos irreversíveis a integridade estrutural do produto



Informações técnicas do produto – VENT69

Limpeza



Cuidado:

• Antes da primeira utilização e após cada utilização se necessário, LIMPE o Circuito Respiratório, DESINFECTE / ESTERILIZE.

• As partes externas do circuito respiratório devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o resíduo do produto de limpeza não se acumule nas espiras do produto; Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo as condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

Para rotina de limpeza podem ser utilizados:

- Ácido Peracético
- Orthophtalaldeído

Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

Desinfecção e/ou Esterilização

Ácido Peracético:

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

• Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Óxido de Etileno (C₂H₄O)

A esterilização utilizando o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).



Atenção:

• Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

• Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.



Informações técnicas do produto – VENT69

Autoclave

**Importante!**

- O Frasco Umidificador não deve ser inserido em um equipamento Autoclave, esterilizá-lo usando este método causará danos irreversíveis a integridade estrutural do produto

Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
- Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

Fabricante / Distribuidor

Ventcare Industria e Comércio LTDA

CNPJ: 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: ventcare@ventcare.com.br | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: [@ventcare_br](https://www.instagram.com/ventcare_br)

Todos os direitos reservados © 2009-2022

	FICHA TÉCNICA Coletor de urina sistema fechado sem filtro - GLOMED	REG. Nº.: 220-04 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138
---	---	---

NOME TÉCNICO: BOLSAS COLETORAS

NOME COMERCIAL: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO - GLOMED

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450050

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480/ sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD.

712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBHA ROAD, NEW DELHI- 110001 INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O coletor de urina sistema fechado sem filtro – GLOMED é composto de um tubo 100cm de PVC ligado a bolsa coletora em PVC graduada, com capacidade de 500 a 2000ml e válvula antirrefluxo de PVC na parte inferior, dependendo do modelo pode apresentar configurações diferentes. O produto é livre de látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

COD. INTERNO	MODELO	CAPACIDADE	COMPRIMENTO DO TUBO	PONTO DE COLETA	VÁLVULA ANT-REFLUXO	MATERIAL
100381	SEM FILTRO	500 a 2000 ML	100 cm	APRESENTA	APRESENTA	PVC

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS UNITÁRIA	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS TRANSPORTE CX 100 UNDS
SEM FILTRO	10,30	0,370	0,350	0,540	0606529140588	x	20606529140582


FICHA TÉCNICA

Coletor de urina sistema fechado sem filtro - GLOMED

REG. N.º: 220-04

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

IMAGEM GRÁFICA:

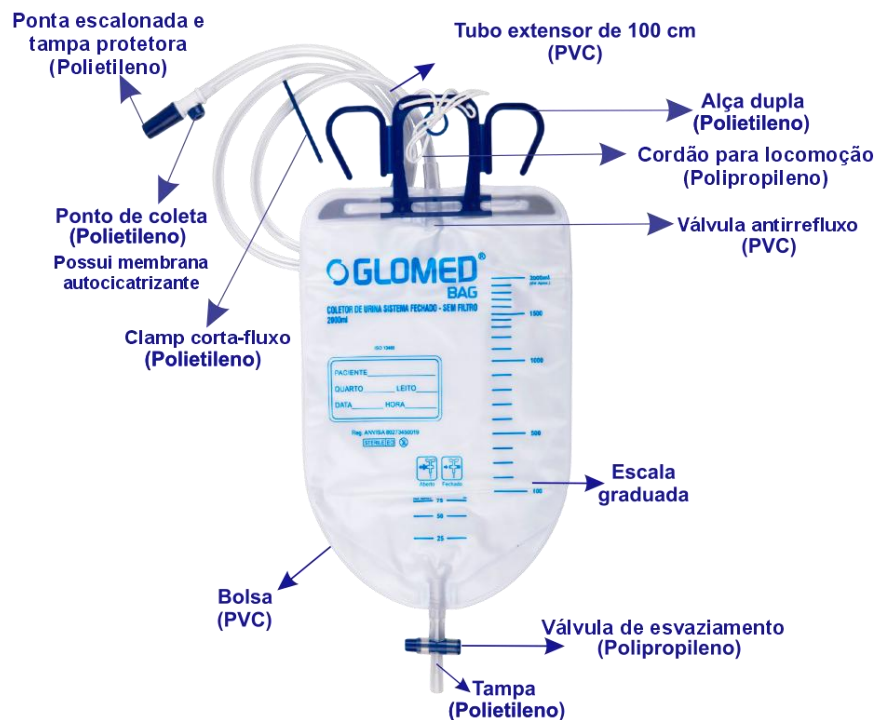

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

É indicado para drenagem, coleta e mensuração de diurese em pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente estes pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas necessidade de controle hídrico diário. Reduzindo o risco de contaminação através de seu sistema fechado.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente (polietileno/Poliamida) e/ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022. Cada embalagem contém 1(uma) unidade de coletor de urina e 1 (uma instrução de uso). As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de transporte contendo 100 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

 OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE Material Hospitalar	FICHA TÉCNICA Coletor de urina sistema fechado sem filtro - GLOMED	REG. Nº.: 220-04 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138
---	--	--

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Feche a válvula de saída da bolsa coletora;
- Remova a tampa de proteção do conector adaptador e introduza ao cateter previamente preparado;
- A urina fluirá para dentro da bolsa através do cateter urinário;
- Para esvaziar a bolsa, retirar o tubo de drenagem do encaixe e posicione a um recipiente adequado que receberá a urina, em seguida abra a saída da válvula para drenagem;
- Após o esvaziamento, fechar a válvula e recolocar no encaixe.
- O dispositivo apresenta ponto de coleta de urina com membrana autocicatrizante para inserção da agulha.
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico, Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

O coletor de urina sistema fechado sem filtro é contraindicado para pacientes com alergia aos materiais que compõem o dispositivo, para aqueles com obstrução urinária, para pacientes que necessitem de monitoramento rigoroso e preciso da diurese, bem como em casos de infecções urinárias graves. Também deve ser evitado em situações em que exista risco de dano ou violação do sistema fechado. Nessas circunstâncias, é essencial considerar alternativas apropriadas.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03.033.589/0001-12
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.734-5
Nome do Dispositivo Médico	Coletor de Urina Sistema Fechado Sem filtro - GLOMED
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Bolsas Coletoras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80273450050
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351652054202210
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD. - ÍNDIA - CNPJ / Código Único: C010641 - Endereço: 712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI- 110001
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02/01/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220-03 - Ficha Técnica - Coletor de urina sistema fechado - WELLMED.pdf	0180601261 - 24/02/2026 16:30:01

Modelo Produto Médico
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO COM COLDRE – OLIFLEX
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO DE PERNA STANDARD - OLIFLEX
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO DE PERNA – OLIFLEX
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO – OLIFLEX

ESTILETE PARA INTRODUÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS – WELL LEAD

Registro MS: 10150470324



DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Guia

Matéria Prima: Vareta de alumínio e revestimento de PVC (Cloro de Polivinila)

Método de Esterilização: **Óxido de**

Etileno Produto Estéril: (X)Sim ()

Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Guia Para Introdução de Sondas Endotraqueais Well Lead é destinado para facilitar a intubação oral da traqueia, utilizado em conjunto com o tubo endotraqueal.

Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de PVC.

INDICAÇÃO DE USO

O Guia Para Introdução de Sondas Endotraqueais Well Lead deve ser usado em combinação com o tubo endotraqueal permitindo que a tubo seja modelado antes da utilização, fornecendo um auxílio positivo para intubação oral da traqueia.

INSTRUÇÃO DE USO

- Verificar a numeração adequada para o procedimento;
- Abrir a embalagem com técnica asséptica;
- Lubrificar o estilete com gel hidrossolúvel e introduzir no lumen da sonda endotraqueal;
- Adequar ao formato da cânula;
- Realizar o procedimento da intubação;
- Ao término retirar o estilete;
- Descartar em local apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



* Produto isento de Látex

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SONDA	COMPR
261.10.600	Guia de Intubação 6 Fr	2,5 a 5,5 mm	272 mm
261.11.000	Guia de Intubação 10 Fr	4,0 a 7,5 mm	346 mm
261.11.400	Guia de Intubação 14 Fr	5,5 a 10,0 mm	365 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, arejado e abrigado da luz solar.

PRECAUÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Atenção na lubrificação do estilete: o uso excessivo do lubrificante pode obstruir o lumen interno da sonda;
- Estéril a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada;
- Não usar se a embalagem estiver danificada;
- Usar imediatamente após abrir a embalagem;
- Descartar após o uso.



CURATIVO FILME TRANSPARENTE COM OU SEM FENESTRA ESTÉRIL VITAL DERME



O **Curativo Filme Transparente com Fenestra Estéril** é indicado para a proteção de inserções de cateteres intravenosos periféricos, sondas e outros curativos, atuando como barreira eficaz contra bactérias, vírus e água, ao mesmo tempo em que permite que a pele respire normalmente.

Além disso, sua composição em poliuretano transparente facilita a inspeção visual da pele, sem necessidade de remoção do curativo, tornando o acompanhamento da ferida mais seguro e prático.

Ainda assim, o curativo transparente com fenestra também pode ser utilizado para prevenir rupturas da pele em áreas sensíveis ou fragilizadas, oferecendo conforto e proteção prolongada.

Sobretudo, possui excelente aderência e fixação, mesmo em regiões de movimentação constante, contribuindo para uma cicatrização eficiente e protegida.

Portanto, é uma solução completa para profissionais da saúde que buscam segurança, praticidade e alto desempenho no cuidado com a pele e feridas.

Assim como, o produto é estéril e descartável, podendo permanecer no local por até 7 dias, conforme orientação clínica.

Ou seja, é um curativo altamente versátil, compatível com a maioria dos procedimentos clínicos e que proporciona excelente custo-benefício para uso hospitalar ou domiciliar.



Logo, seu uso se estende para diferentes situações, desde a fixação de sondas até a proteção de feridas pós-operatórias, sendo um aliado essencial na rotina de cuidados. Como resultado, sua composição em **poliuretano** e **politereftalato de etileno (PET)** assegura durabilidade, proteção e conforto ao paciente. Afinal, o Curativo Filme com Fenestra Estéril da Vital Derme é sinônimo de cuidado inteligente e confiável.

CARACTERÍSTICAS DO CURATIVO FILME COM FENESTRA – VITAL DERME:

- Inserção de cateteres intravenosos periféricos;
- Fixação de sondas;
- Feridas pós-operatórias;
- Proteção bacteriana da pele;
- Prevenção de ruptura cutânea;
- Áreas sensíveis em processo de cicatrização.

DIMENSÕES DO CURATIVO FILME TRANSPARENTE COM FENESTRA:

- 06 cm x 07 cm
- 10 cm x 12 cm

VANTAGENS:

- Produto estéril e descartável;
- Aplicação confortável e remoção indolor;
- Visualização constante do local da ferida;
- Barreira contra vírus, bactérias e líquidos;
- Alta permeabilidade ao vapor – permite a respiração da pele;
- Excelente aderência e fixação prolongada;
- Uso seguro e compatível com diferentes tipos de curativos.

MODO DE USAR:

- Higienize as mãos antes do manuseio;
- Retire o curativo anterior, se houver;
- Posicione o novo curativo sobre a área desejada;
- Certifique-se de que a fenestra esteja centralizada corretamente.

ADVERTÊNCIAS:

- Uso único – não reprocessar;
- Conservar em local seco, limpo e arejado;
- Produto de uso externo;
- Não utilizar em áreas com hipersensibilidade conhecida aos componentes.



Coletor para Material Perfurocortante Descarpac

DESCRIÇÃO

O **Coletor para Material Perfurocortante Descarpac** desenvolvido para o descarte de materiais perfurocortantes, contém em sua composição sacola plástica, impermeabilizando os materiais descartados e papelão rígido, conhecido como papelão couro o que lhe confere maior segurança e resistência. Disponível em diferentes modelos, na cor amarela, possui alças que facilitam o manuseio, bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança, garantindo a integridade até o destino final. O coletor de 1,5L conta com desconector de agulha.

O **Coletor para Material Perfurocortante Descarpac** é identificado com o símbolo de materiais infectantes, assim como limite de enchimento.

PRODUTO



Coletor para Material Perfurocortante Descarpac

Cadastro Anvisa: 81187220001

Fabricante: Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor para Material Perfurocortante Descarpac** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde são

gerados resíduos perfurocortantes infectados atendendo as recomendações da RDC 306/2004 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor para Material Perfurocortante Descarpack** é disponível nos modelos: 1,5L, 3,0L, 7,0L, 13,0L e 20,0L.

COMPOSIÇÃO

Coletor para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,5L

- ❖ **Coletor:** Papelão ondulado;
- ❖ **Alças:** Papelão ondulado;
- ❖ **Sacola de Revestimento:** Polietileno;
- ❖ **Fundo:** Papelão couro;
- ❖ **Cinta Interna:** Papelão couro;
- ❖ **Bandeja Interna:** Papelão ondulado;
- ❖ **Desconector de Agulha:** Polipropileno;

Coletor para Materiais Perfurocortantes Descarpack 3,0L, 7,0L, 13,0L e 20,0L

- ❖ **Coletor:** Papelão ondulado;
- ❖ **Alças:** Papelão ondulado;
- ❖ **Sacola de Revestimento:** Polietileno;
- ❖ **Fundo:** Papelão couro;
- ❖ **Cinta Interna:** Papelão rígido;
- ❖ **Bandeja Interna:** Papelão ondulado;

VALIDADE

Indeterminada.

CAPACIDADE

Capacidade Total	Capacidade Útil
1,5L	1,1L
3,0L	2,3L
7,0L	5,3L
13,0L	10,0L
20,0L	18,0L

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. Caixa Master
1,5L	0160501	20 unidades
3,0L	0160101	20 unidades
7,0L	0160201	20 unidades
13,0L	0160301	20 unidades
20,0L	0160401	20 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Preencher somente até a linha pontilhada;
- ❖ Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
- ❖ Utilize o desconectador para descartar a agulha no coletor, introduzindo a agulha no orifício até que ele fique presa e gire para desconectar;
- ❖ Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas alças, afastado do corpo;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor. Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- ❖ A ausência de qualquer parte deste produto compromete sua eficácia;
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único;


- ❖ Manuseie exclusivamente pelas alças;
- ❖ Dever ser utilizado exclusivamente para descarte de resíduos sólidos;
- ❖ Após o enchimento descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

ANEXO

Instruções de uso de como fechar o produto Coletor para Material Perfurocortante Descarpack

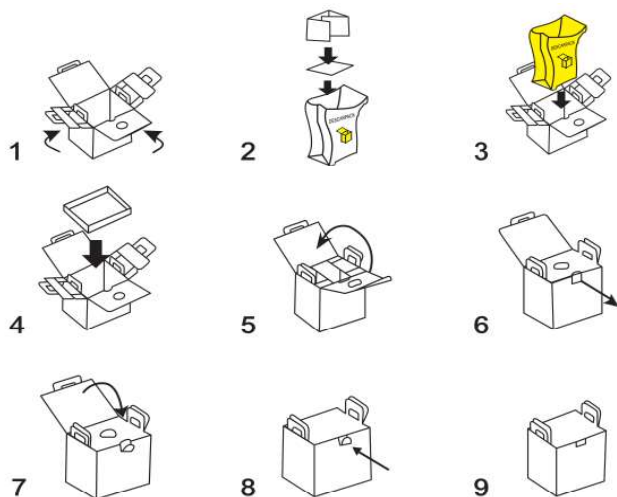

1. Tire o coletor da sacola e abra conforme a figura;
2. Abra o plástico, coloque o fundo rígido dentro do saco plástico e introduza a cinta interna posicionando-a em forma de triângulo sobre o fundo rígido;
3. Coloque a sacola plástica já com o fundo rígido e a cinta dentro do coletor, encoste a cinta nas paredes internas. Coloque as sobras do saco plástico dentro do coletor;
4. Introduza a bandeja impermeável sobre o saco plástico até o fundo;
5. Complete a montagem com o fechamento da tampa do bocal;

6. Pronto! Seu coletor está pronto para o uso;
7. Para descartar feche a tampa externa;
8. Fecha a trava de segurança;
9. O coletor está pronto para ser descartado;



FICHA TÉCNICA

PIELSANA SACHET

DESCRIÇÃO:

- Gaze de Rayon embebida em PielSana Óleo à base de AGE (ácidos graxos essenciais), vitaminas A e E, com óleos de copaíba e melaleuca que revitalizam a pele e auxiliam a acelerar o processo de cicatrização de feridas.
- PielSana Sachet previne e trata feridas agudas e crônicas mesmo com a perda de tecido superficial parcial ou total.

CONTEÚDO:

- Cartelas contendo 24 sachets nas medidas: 7,5cm x 7,5cm ; 7,5cm x 15cm; 7,5cm x 40cm

INDICAÇÃO:

- Hidratar e manter a integridade da pele;
- Prevenção e tratamento de úlceras de pressão;
- Feridas agudas, crônicas e com perda de tecido;
- Queimaduras de 1º e 2º grau;
- Dermatite amoniacal (assaduras), peri-gastrotomias e peri-lesões;
- Traqueostomias e drenos;
- Escoriações e abrasões;
- Auxilia no desbridamento autolítico (pouca fibrina ou esfacelos) e na absorção de exsudatos;
- Feridas com pouco tecido desvitalizado;
- Proeminências ósseas e tendões.

PRECAUÇÕES:

Uso Externo / Uso Tópico

Manter fora do alcance das crianças. Evitar contato com os olhos.

Em caso de irritação, descontinue ou suspenda o uso.

Conservar o produto à temperatura ambiente, protegendo-o da luz e umidade.

Manter a embalagem fechada após o uso.

Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

**MODO DE USAR:**

- Após a limpeza da pele com Pielvana Polihexanida Solução Aquosa, aplique o produto sobre a região lesionada.

COMPOSIÇÃO:

-Lecitina de Soja, Óleo de Girassol, Triglicerídeos de Cadeia Média, Óleo de Melaleuca, Óleo de Copaíba, Vitamina A e Vitamina E

Número processo ANVISA Nº:80175820002 Validade: 02 anos

Fabricado por: DBS Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Ramos Guimarães nº 57 – Centro
Bom Jesus dos Perdões – SP
CEP: 12955-000
Atendimento ao Consumidor: 08007737337
CNPJ: 05.210.556/0001-26
Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Bráulio Hargreaves Carvalho Tymburiba – CRF/SP 35.487

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.210.556/0001-26	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.758-2
Nome do Dispositivo Médico	PIELSANA SACHET		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Compressas		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80175820002		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.477631/2009-28</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05.210.556/0001-26 - Endereço: RUA JOSÉ RAMOS GUIMARÃES, Nº 57 CENTRO 12955000		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/06/2010		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/06/2035		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Pielsana Sachet - Instruções de uso.pdf	0325972/25-7 - 11/03/2025 - 08:42

Modelo Produto Médico

PIELSANA SACHET 7,5 X 15

PIELSANA SACHET 7,5 X 40

PIELSANA SACHET 7,5 X 7,5

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Item 08 álcool gel 500ml super vale



O **Álcool em Gel 500ml Super Vale (70° INPM)** é um antisséptico para mãos com ação bactericida comprovada, eliminando 99,9% dos germes e bactérias

Item 10 álcool 70 1l super vale



Álcool Líquido Super Vale 70°.

O Álcool Líquido Super Vale 70° - 1L oferece uma solução prática e confiável para a limpeza, desinfecção e higienização de diferentes ambientes e superfícies. Com sua alta concentração de álcool e poder germicida, é uma opção eficaz para manter a higiene e a segurança em diversas situações do dia a dia.

Apresentação:

- O Álcool Líquido Super Vale 70° - 1L é um produto amplamente utilizado em diversas situações que requerem limpeza, desinfecção e higienização eficazes.
- Trata-se de um álcool líquido altamente concentrado, com graduação de 70° INPM (Índice de Peróxidos de Metila), o que indica sua alta pureza e poder desinfetante.

Modo de usar:

- **Para desinfecção de superfícies fixas:**
 - Lavar, enxaguar e secar a superfícies. Friccionar o produto puro, deixando a superfície umedecida por 10 minutos. Não é preciso enxaguar.
- **Para desinfecção de artigos não críticos:**
 - Lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar o produto puro, deixando os artigos umedecidos por 10 minutos. Não é preciso enxaguar. Não deve ser utilizado em superfícies sensíveis ao álcool. Não derramar sobre o fogo;
 - Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir.
- **Recomendações para armazenamento da embalagem:**
 - Manter afastado do fogo e do calor;
 - Conservar a embalagem bem fechada após o uso.

CUIDADO:

- Irritante para os olhos, pele e mucosas;
- Não misturar com outros produtos;

- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Manter o produto em sua embalagem original;
- Não reutilizar as embalagens;
- Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente;
- Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

Álcool Gel 70° INPM Gel Antisséptico – para a Fricção Higiênica das Mãos

1. Identificação

- 1.1 Nome do produto: Álcool Gel 70° INPM – Gel Antisséptico para as Mãos
- 1.2 Código de identificação: Álcool Gel 70° INPM para Fricção Higiênica das mãos – 450 g
Álcool Gel 70° INPM para Fricção Higiênica das mãos – 900 g
Álcool Gel 70° INPM para Fricção Higiênica das mãos – 4,250 kg
- 1.3 Uso recomendado: Higienização e antissepsia das mãos. Uso externo.
- 1.4 Restrições de uso: Não aplicar sobre pele lesionada ou próxima aos olhos.
- 1.5 Empresa: Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA
- 1.6 Endereço: Estrada Flor da Serra S/N, Bairro Margarida Galvan, Dois Vizinhos – PR
- 1.7 Telefone: (46) 3536 – 1144
- 1.8 Responsável técnico: Marisa B. Ramuski – CRQ 09200511
- 1.9 Telefone de emergência: CEATOX – Hospital das Clínicas: 0800 722 6001

2. Identificação de perigos

2.1 Classificação GHS:

- Líquido inflamável – Categoria 2 (Flam. Liq. 2)
- Irritação ocular – Categoria 2A (Eye Irrit. 2A)
- Toxicidade por exposição única – Categoria 3 (STOT SE 3 – narcótico)

2.2 Elementos de rotulagem:

Pictogramas de risco GHS:



GHS02



GHS07

2.3 Palavra de advertência: Perigo

2.4 Frases de perigo (H):

- H225 – Líquido e vapores altamente inflamáveis
- H319 – Provoca irritação ocular grave
- H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem

2.5 Frases de precaução (P):

- P210 – Manter afastado de calor, faíscas, chamas e superfícies quentes
- P280 – Usar proteção ocular
- P305+P351+P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos
- P403+P235 – Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura composta por:

- Etanol – CAS: 64-17-5 – Concentração: 70% (INPM) – Classificação GHS: Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2A; STOT SE 3
- Água purificada – CAS: 7732-18-5 – q.s.p. 100% – Não classificada
- Outros componentes não perigosos: agente espessante, neutralizante, desnaturante.

4. Medidas de primeiros socorros

4.1 Inalação: Remover a vítima para local arejado. Procurar assistência médica em caso de sintomas como tontura, sonolência ou irritação respiratória.

4.2 Contato com a pele: Lavar com água e sabão. Procurar atendimento médico se houver irritação persistente.

4.3 Contato com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água por no mínimo 15 minutos. Procurar atendimento médico.

4.4 Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca com água. Procurar assistência médica imediatamente.

4.5 Sintomas mais importantes: Irritação ocular, tontura, náuseas, sonolência.

5. Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção apropriados: Pó químico seco, dióxido de carbono (CO₂), espuma resistente ao álcool.

5.2 Meios inadequados: Jato de água direto.

5.3 Perigos específicos: Vapores inflamáveis podem formar misturas explosivas com o ar.

5.4 Equipamentos de proteção dos bombeiros: Usar equipamento de proteção completo e aparelho de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- 6.1 Precauções pessoais: Remover fontes de ignição. Usar EPI adequado. Ventilar a área.
- 6.2 Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja redes de esgoto ou corpos d'água.
- 6.3 Métodos de limpeza: Absorver com material inerte. Recolher o material em recipiente adequado para descarte. Lavar a área com água em abundância.

7. Manuseio e armazenamento

- 7.1 Manuseio seguro: Utilizar em locais bem ventilados. Evitar contato com os olhos. Manter afastado de fontes de ignição.
- 7.2 Armazenamento: Armazenar em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo da luz solar direta. Manter os recipientes bem fechados.

8. Controle de exposição e proteção individual

- 8.1 Limites de exposição: Etanol – 1000 ppm (ACGIH TLV-TWA)
- 8.2 Medidas de engenharia: Manter ventilação adequada no local de uso.
- 8.3 Equipamentos de proteção individual:
- Respiratória: Não necessária em condições normais, usar máscara com filtro para vapores orgânicos em ambientes fechados.
 - Mãos: Luvas impermeáveis em manuseio prolongado.
 - Olhos: Óculos de proteção.
 - Corpo: Avental em ambientes industriais.
- 8.4 Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante o uso. Lavar as mãos após o manuseio.

9. Propriedades Físicas e Químicas

Estado físico: Gel

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH: 6,0 – 8,0

Densidade: 0,84 – 0,92 g/mL

Solubilidade: Totalmente solúvel em água

Ponto de fulgor: 21 – 24 °C

Ponto de ebulição do componente ativo (etanol): ~78 °C

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Estabilidade: Estável em condições normais de uso e armazenamento.

10.2 Condições a evitar: Calor excessivo, faíscas e chamas abertas.

10.3 Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

10.4 Produtos perigosos da decomposição: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

11. Informações toxicológicas

11.1 Vias de exposição: Inalação, contato com a pele, olhos e ingestão.

11.2 Efeitos potenciais:

- Inalação: Pode causar tontura, dor de cabeça e sonolência.
- Contato com os olhos: Pode causar irritação grave.
- Pele: Uso frequente pode causar ressecamento.
- Ingestão: Pode causar náusea, vômito e efeitos narcóticos.

12. Informações ecológicas

Produto biodegradável. Evitar lançamento em corpos d'água em grandes quantidades. Pode ser tóxico para organismos aquáticos em concentrações elevadas.

13. Considerações sobre destinação final

Resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental vigente. Embalagens devem ser destinadas a empresas licenciadas para tratamento ou reciclagem.

14. Informações sobre transporte

Produto classificado como perigoso para transporte conforme Resolução ANTT nº 5.947/2021.

- Nome apropriado para embarque: Etanol
- Número ONU: 1170
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: II
- Número de risco: 33

15. Informações sobre Regulamentações

Produto Registrado na ANVISA nº 209830001

FDS elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023.

16. Outras informações

ÁLCOOL GEL 70º INPM GEL ANTISSEPTICO - SUPERVALE, foi submetido a testes laboratoriais realizados pela empresa ECOLYZER, o qual não apresentou processo de irritação ou sensibilização a exposição do produto, portanto, pode ser considerado dermatologicamente testado e aprovado, sendo considerado seguro, conforme guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos da ANVISA, 2012.

As informações apresentadas baseiam-se no conhecimento atual sobre o produto e destinam-se exclusivamente a orientar seu uso seguro. O uso fora das condições recomendadas é de responsabilidade do usuário.

Álcool Etílico Hidratado 70° INPM Líquido de uso Hospitalar

1. Identificação

1.1 Nome do produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM líquido hospitalar.

1.2 Código Interno de Identificação: San Álcool Hidratado 70° INPM Líq. Hosp.- Supervale 1 L

San Álcool Hidratado 70° INPM Líq. Hosp.- Supervale 5 L

San Álcool Hidratado 70° INPM Líq. Hosp.- Supervale 500 ml

1.3 Recomendações de uso: Produto antisséptico e desinfetante de superfícies em ambientes hospitalares e domésticos.

1.4 Armazenamento: Conservar em local fresco, seco e ventilado, longe de calor e fontes de ignição.

1.5 Empresa: Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA

1.6 Endereço: Estrada Flor da Serra S/N. Bairro Margarida Galvan. Dois Vizinhos – PR

1.7 Telefone: (46) 3536-1144

1.8 Responsável técnico: Marisa B. Ramuski – CRQ Nº 09200511

1.9 Telefone de emergência: CEATOX – Hospital das Clínicas: 0800 722 6001

2. Identificação de perigos

2.1 Classificação GHS:

- Flam. Liq. 2 – Líquido inflamável categoria 2
- STOT SE 3 – Toxicidade a órgão-alvo específico – exposição única (efeitos narcóticos)

2.2 Pictograma de risco:



GHS02-IN

2.3 Palavra de advertência: Perigo

2.4 Frases de perigo (H):

- H225 – Líquido e vapores altamente inflamáveis
- H336 – Pode provocar sonolência ou vertigem

2.5 Frases de precaução (P):

- P210 – Mantenha afastado do calor/faíscas/chamas abertas

- P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado
- P241 – Utilizar equipamentos elétricos, de ventilação e de iluminação à prova de explosão
- P280 – Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular
- P304+P340 – Em caso de inalação: remover a pessoa para local ventilado
- P403+P235 – Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco
- P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente conforme legislação local

2.6 Outros perigos: O produto é altamente inflamável. Pode formar misturas explosivas com o ar.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura de substâncias:

- Etanol | CAS: 64-17-5 | Concentração: 70% | Classificação GHS: Flam. Liq. 2; STOT SE 3
- Água | CAS: 7732-18-5 | Concentração: q.s.p. 100% | Não classificada

4. Medidas de primeiros socorros

4.1 Inalação: Levar a pessoa para local ventilado. Procurar atendimento médico se houver sintomas como tontura ou dor de cabeça.

4.2 Contato com a pele: Lavar com água e sabão. Retirar roupas contaminadas.

4.3 Contato com os olhos: Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar oftalmologista.

4.4 Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca com água. Procurar atendimento médico imediatamente.

4.5 Sintomas principais: Irritação ocular, tontura, sonolência, dor de cabeça, náusea.

5. Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção apropriados: Pó químico seco, CO₂, espuma resistente ao álcool.

5.2 Meios inadequados: Jato de água direto.

5.3 Perigos específicos: Vapores inflamáveis podem formar misturas explosivas com o ar.

5.4 Proteção dos bombeiros: Utilizar EPI completo com proteção respiratória autônoma.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauções pessoais: Eliminar fontes de ignição. Isolar a área. Usar EPI adequado.

6.2 Precauções ambientais: Evitar que o produto atinja corpos d'água ou redes de esgoto.

6.3 Métodos de limpeza: Absorver com material inerte. Coletar em recipientes fechados e identificar para descarte.

7. Manuseio e armazenamento

7.1 Manuseio: Evitar inalação de vapores. Manusear longe de fontes de ignição.

7.2 Armazenamento: Armazenar em local ventilado, fresco, seco e longe de chamas.

8. Controle de exposição e proteção individual

8.1 Proteção respiratória: Máscara com filtro para vapores orgânicos em ambientes fechados.

8.2 Proteção das mãos: Luvas de borracha ou PVC.

8.3 Proteção ocular: Óculos de segurança contra respingos.

8.4 Proteção da pele: Avental impermeável e calçados fechados.

8.5 Higiene: Lavar as mãos após o uso. Evitar fumar, comer ou beber durante o manuseio.

9. Propriedades Físicas e Químicas

Estado físico: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH: 6,0 – 7,0

Densidade: 0,8649 – 0,0,8733 g/mL

Ponto de ebulição: ~78 °C

Ponto de fulgor: 15 °C

Solubilidade: Totalmente solúvel em água

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Estável sob condições normais.

10.2 Incompatível com agentes oxidantes fortes.

10.3 Vapores inflamáveis. Evitar calor, faíscas, chamas e contato com superfícies quentes.

11. Informações toxicológicas

Produto pode causar irritação ocular e das vias respiratórias. Exposição prolongada pode causar sonolência, dor de cabeça, náusea. Ingestão pode causar irritação gastrointestinal.

12. Informações ecológicas

Produto biodegradável. Pode causar efeitos adversos se lançado em grandes volumes no meio ambiente aquático. Não bioacumulativo.

13. Considerações sobre disposição final

Não reutilizar embalagem. Resíduos devem ser encaminhados para empresa licenciada conforme legislação ambiental vigente.

14. Informações sobre transporte

Classificado como produto perigoso conforme Resolução ANTT nº 5.947/2021.

Nome apropriado: Etanol

ONU: 1170

Classe: 3

Número de risco: 33

Grupo de embalagem: II

15. Informações sobre Regulamentações

Produto Registrado na ANVISA N° 329520013

Elaborado conforme ABNT NBR 14725:2023.

16. Outras informações

Esta FDS foi elaborada com base nos conhecimentos disponíveis. Aplicável ao produto na forma fornecida. O uso inadequado é de responsabilidade do usuário.